

INSTRUÇÕES

IPLEX NX

ENDOSCÓPIO INDUSTRIAL

IV9000N

IV9435N

IV9450N

IV9635N

IV9635X1N

IV9650N

IV9675N

Endoscópio industrial



Índice

Introdução.....	1
Utilização prevista.....	1
Manual de instruções.....	1
Configuração do produto.....	1
Precauções de segurança.....	2
Placa de classificação/cuidado.....	12
1 Desembalar.....	15
1-1 Desembalar.....	15
1 Armazenar na caixa do adaptador ótico.....	15
2 Opções.....	16
2 Nomenclatura.....	17
2-1 Nomenclatura.....	17
2-2 Nomenclatura da extremidade distal/adaptador ótico.....	20
2-3 Nomenclatura do monitor LCD.....	21
3 Preparação e inspeção prévias à operação.....	24
3-1 Deslocar a mala de transporte.....	24
3-2 Colocar o instrumento.....	25
1 Remover componentes da mala de transporte.....	25
2 Colocar a unidade principal numa superfície plana.....	25
3 Ajustar a altura e a direção da unidade LCD.....	26
4 Colocar a unidade LCD.....	26
3-3 Preparar a fonte de alimentação.....	29
1 Utilizar a bateria.....	29
2 Utilizar o adaptador de CA.....	31
3-4 Retirar o tubo de inserção.....	32
3-5 Colocar e remover o adaptador ótico.....	33

3-6	Remover a unidade endoscópica.....	34
3-7	Ligar a unidade de controlo remoto à unidade principal.....	35
3-8	Ligar o cartão SDHC/dispositivo de memória USB.....	37
3-9	Colocar/remover a alça para o ombro.....	38
3-10	Encaixar o conjunto do gancho.....	39
3-11	Substituir o gancho.....	40
3-12	Substituir a tampa de segurança.....	41
3-13	Utilizar o suporte da pega.....	41
3-14	Utilizar a pega da abertura do canal e o grampo de cinto.....	42
3-15	Ligar e remover o adaptador LAN sem fios USB.....	45
3-16	Inspeções prévias/posteriores à operação.....	46

4 Operações básicas.....49

4-1	LIGAR a alimentação.....	49
	1 LIGAR a alimentação.....	49
4-2	LIGAR a luz.....	49
	1 Verificar a luz da iluminação na extremidade distal do tubo de inserção.....	49
4-3	Operar o instrumento.....	50
4-4	Observar o objeto a inspecionar.....	52
4-5	Retirar a unidade endoscópica.....	53
4-6	Ajustar a apresentação da imagem.....	54
	1 Imagem fixa (Fixação).....	54
	2 Ampliar a imagem (Zoom).....	54
	3 Ajustar o brilho.....	54
4-7	Alterar a pasta no ecrã em tempo real.....	55

4-8	Gravar imagens.....	56
1	Preparar gravação de imagens.....	56
2	Gravar a imagem fixa.....	58
3	Gravar o filme.....	60
4	Juntar o filme.....	61
4-9	Reproduzir a imagem.....	62
1	Reproduzir a imagem numa visualização de ecrã inteiro (ecrã de visualização).....	63
2	Ver o ecrã de miniaturas e selecionar a imagem a reproduzir.....	63
3	Som anexado à imagem fixa.....	64
4	Reproduzir e colocar em pausa o filme.....	64
4-10	Apresentar imagens ao vivo no monitor externo....	65
4-11	Utilizar as imagens gravadas num PC.....	65

5 Operações de menu e funções..... 66

5-1	Operações do menu.....	66
5-2	Utilizar o ecrã ao vivo/ecrã de fixação.....	68
1	Menu de definições iniciais.....	68
2	Introduzir um título.....	71
3	Registar uma cadeia de texto como título predefinido.....	73
4	Ajustar a nitidez da imagem.....	74
5	Ajustar a saturação da imagem.....	74
6	Definir data e hora.....	75
7	IDIOMA.....	75
8	VELOCIDADE DO MODO PRECISO.....	76
5-3	Utilizar os ecrãs de miniaturas/visualização.....	77
1	Menu de operações em ficheiros/pastas.....	77

6 Função de medição estéreo.....	79
6-1 Fluxo de medições.....	80
6-2 Colocar o adaptador ótico estéreo.....	81
6-3 Verificar os valores de medição.....	82
6-4 Observar a área de medição.....	84
1 Observar a área de medição no ecrã ao vivo.....	84
2 Medir a distância para a área de medição através da extensão do ponto.....	85
6-5 Medição.....	87
1 Medição.....	87
2 Ecrã de medição.....	88
3 Tipos de método de medição.....	90
4 Especificação dos pontos de medição.....	92
5 <3D OPTION>.....	94
7 Função de medição de escala.....	96
7-1 Fluxo de medições.....	96
7-2 Colocar o adaptador ótico.....	97
7-3 Observar a área de medição.....	97
7-4 Medição.....	98
8 Função de rede.....	100
8-1 Ligar à LAN sem fios.....	100
1 Ligar o adaptador LAN sem fios USB.....	100
2 Configurar a LAN sem fios.....	100
3 Ligar à LAN sem fios.....	102
8-2 Autenticação de dispositivo.....	102
8-3 Atualização do software.....	103

8-4 Carregar a imagem.....	104
1 Transferir como gravação.....	104
2 Transferência de lote	105
8-5 Inicializar as informações de rede.....	106
9 Resolução de problemas.....	107
9-1 Guia de resolução de problemas.....	107
1 Mensagens de erro.....	107
2 Problemas comuns.....	109
9-2 Solicitar a reparação deste produto.....	111
10 Armazenamento e manutenção	112
10-1 Substituir a bateria.....	112
10-2 Substituir o anel de vedação.....	112
10-3 Limpar os componentes.....	112
1 Limpar o tubo de inserção	112
2 Limpar a extremidade distal.....	113
3 Limpar o adaptador ótico.....	113
4 Limpar o conjunto do gancho.....	114
5 Limpar o monitor LCD.....	114
6 Limpar outras unidades.....	114
10-4 Precauções de armazenamento.....	115
1 Armazenar o instrumento na mala de transporte.....	115
2 Armazenar o conjunto do gancho	116
11 Especificações.....	117
11-1 Ambiente de funcionamento.....	117
11-2 Outras especificações.....	118
1 Outras especificações.....	118
2 Norma de aplicação externa.....	122

3	Informações sobre a licença de software.....	122
4	Utilizar software de código aberto.....	123
5	Licença da carteira de patentes AVC.....	123
11-3	Especificações do adaptador ótico.....	124
1	Para o modelo de 4 mm do tubo de inserção.....	124
2	Para o modelo de 6 mm do tubo de inserção.....	124
3	Para o modelo de 6,2 mm do tubo de inserção.....	125
Anexo	126
Quadro do sistema	126

Introdução

Utilização prevista

Este instrumento destina-se à inspeção e observação do interior de máquinas, equipamentos, materiais e outros objetos, sem danificar o objeto a inspecionar.

Manual de instruções

Este manual de instruções contém informações que ajudam a compreender as operações e o método de manuseamento deste instrumento, bem como o seu modo de utilização de forma segura.

Antes de utilizar o instrumento, leia cuidadosamente o conteúdo deste manual de instruções para assegurar que utiliza corretamente o instrumento. Depois de ler este manual de instruções, guarde-o juntamente com o acordo de garantia num local seguro.

Se tiver alguma questão acerca das informações presentes neste manual de instruções, entre em contacto com a EVIDENT.

Os símbolos utilizados nos textos deste manual possuem os seguintes significados:

[] indica as palavras presentes na interface do utilizador do produto que são apresentadas em inglês.

< > indica as palavras presentes na interface do utilizador do produto e o idioma selecionável nas definições de utilizador.

Configuração do produto

Para a configuração dos dispositivos exigidos por este instrumento e dos dispositivos que podem ser utilizados em conjunto com o mesmo, consulte a “Quadro do sistema” (página 126) em “Anexo”.

Tenha em atenção que a utilização deste instrumento em conjunto com itens opcionais ou disponíveis em separado que não os presentes na “Quadro do sistema” pode criar o risco de operações anormais e danificar o dispositivo.

Precauções de segurança

Tenha em atenção que a utilização deste instrumento de uma forma que não a especificamente descrita neste manual de instruções não garante a segurança e poderá provocar avarias no instrumento. Certifique-se de que segue este manual de instruções ao utilizar o instrumento.

Os seguintes símbolos são utilizados ao longo deste manual de instruções.

-  **PERIGO** : Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, irá resultar em morte, lesão grave ou dano no objeto a ser observado.
-  **ADVERTÊNCIA** : Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte, lesão grave ou dano no objeto a ser observado.
-  **CUIDADO** : Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Pode também ser utilizado para alertar contra práticas inseguras ou potenciais danos materiais.
-  **NOTA** : Indica uma situação potencial que, se não for evitada, poderá resultar em falhas deste instrumento.
-  **DICA** : Indica informação útil adicional.



Precauções de segurança - Precauções gerais de segurança -

Cumpra rigorosamente as precauções descritas abaixo ao manusear este instrumento. A informação é suplementada por perigos, avisos e cuidados indicados em cada capítulo. Não é possível garantir a segurança quando o instrumento for utilizado de uma forma que não é especificamente descrita.

PERIGO

- **Nunca utilize o instrumento para observar o interior de uma cavidade humana ou animal.**
Caso contrário, tal poderá resultar em morte ou lesões graves da pessoa ou do animal.
- **Nunca utilize o instrumento nos seguintes ambientes.**
 - Onde existir um ambiente inflamável
 - Onde existir pó metálico ou de outro tipoCaso contrário, tal poderá resultar em incêndio ou explosão.

ADVERTÊNCIA

- **Não repare, desmonte nem modifique o instrumento.**
Nunca repare, desmonte nem modifique o instrumento. Caso contrário, tal poderá resultar em lesões no corpo humano ou em danos no instrumento. Apenas pessoal autorizado pela EVIDENT está autorizado a reparar o instrumento. A EVIDENT não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou danos no instrumento que ocorram em resultado de tentativas de reparação efetuadas por pessoal não autorizado pela EVIDENT.
- **Pare imediatamente de utilizar este instrumento ao primeiro sinal de sobreaquecimento, fumo, odor anormal, ruído estranho ou qualquer outra anomalia.**
Mesmo que o instrumento ainda funcione, DESLIGUE a alimentação.
- **Não introduza o tubo de inserção num objeto a inspecionar que ainda esteja em operação ou a conduzir eletricidade.**
Caso contrário, o tubo de inserção poderá ser danificado ao ficar preso no interior do objeto a inspecionar etc. ou o tubo de inserção pode tocar no objeto e resultar em choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA

- **Antes de armazenar o instrumento na respetiva mala de transporte, certifique-se de que DESLIGOU a alimentação e removeu a bateria.**
Deixar a bateria carregada durante o armazenamento faz com que esta fique quente, o que pode resultar em incêndio.

⚠️ CUIDADO

- **Não utilize o instrumento em outro tipo de ambientes (incluindo ambientes fortemente radioativos) que não o ambiente de funcionamento especificado.**
Caso contrário, tal poderá resultar em acidentes inesperados que podem danificar o tubo de inserção.
- **Não toque na extremidade distal imediatamente a seguir a utilizar este instrumento em ambientes de elevada temperatura.**
Caso contrário, tal poderá resultar em queimaduras.
- **Utilize o adaptador ótico estéreo e a unidade endoscópica na combinação especificada pela EVIDENT.**
A utilização dos mesmos numa combinação que não a especificada pela EVIDENT pode resultar em acidentes inesperados e numa deterioração do desempenho.
- **Utilize apenas o cabo de alimentação e o adaptador de CA especificado pela EVIDENT e ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica trifásica que cumpra a potência especificada.**
Caso contrário, tal poderá resultar em fumo, incêndio ou choque elétrico.
- **Não utilize o cabo de alimentação especificado para este instrumento em outros produtos.**
- **Não utilize o adaptador de CA no exterior.**
Caso contrário, tal poderá resultar em choque elétrico, fumo ou incêndio que podem danificar o instrumento.
O adaptador de CA foi concebido para utilização no interior.
- **Não aplique impactos fortes ao adaptador de CA ao submetê-lo a impactos contra a parede, ao deixá-lo cair ao chão etc.**
Caso contrário, tal poderá provocar avarias ou danos que podem resultar em choques elétricos.
- **Se sentir que existe alguma anomalia ao introduzir o tubo de inserção no objeto a inspecionar, não tente forçar a sua introdução e retire-o com cuidado.**
Tenha em atenção o seguinte ao retirar o tubo de inserção.
 - Não retire o tubo de inserção do objeto a inspecionar enquanto a angulação estiver bloqueada ou enquanto a secção de angulação estiver dobrada.
 - Se o tubo de inserção ficar preso em algo durante a remoção, rode-o cuidadosamente enquanto continua a removê-lo.
- **Tenha em atenção as seguintes precauções ao manusear a extremidade distal do tubo de inserção.**
 - Não deixe cair o adaptador ótico nem o submeta a impactos fortes.
 - Não submeta a extremidade distal a impactos ou puxões fortes.
 - Não submeta a secção de angulação a pressões ou dobras acentuadas.
 - Não desloque o tubo de inserção agarrando-o pela extremidade distal.
 - Não utilize este instrumento se o anel de vedação da extremidade distal do tubo de inserção estiver danificado ou rasgado.
 Caso contrário, tal poderá resultar em danos nas lentes de vidro e nos componentes de precisão que constituem a extremidade distal e a secção de angulação.

CUIDADO

- **Coloque sempre o adaptador ótico antes de utilizar este instrumento.**
Se utilizar o instrumento sem colocar o adaptador ótico no tubo de inserção, existem peças (parafusos etc.) que facilmente ficam deformadas devido ao contacto com objetos duros etc. Se as peças do tubo de inserção ficarem deformadas não será possível colocar o adaptador ótico ou este poderá cair.
- **Nunca utilize o adaptador ótico se alguma das suas peças estiver solta.**
Caso contrário, as peças soltas poderão cair.
- **Se o adaptador ótico não puder ser colocado ou removido porque a porca não roda, pare de o utilizar.**
Contacte a EVIDENT.
- **Se sentir alguma anomalia enquanto desempenha a operação de angulação, não tente forçar a operação de angulação.**
Caso contrário, o tubo de inserção ou o objeto a ser inspecionado pode ser danificado.
- **Ao colocar a unidade principal ao ombro utilizando a alça para o ombro, não permita que esta fique presa noutros objetos.**
Posicione-a com cuidado de modo a não apertar o seu pescoço.
- **Não permita que objetos estranhos ou de metal entrem na unidade principal através dos terminais do conector ou de qualquer outra abertura.**
Caso contrário, tal poderá resultar em avarias ou choque elétrico.
- **Não utilize este instrumento perto de fortes fontes de radiação eletromagnética.**
Podem interferir sobre o funcionamento correto. Verifique o ambiente eletromagnético antes de utilizar este instrumento.
- **As interfaces na tampa do conector, cartão SDHC e dispositivo de memória USB são peças bastante sensíveis. Certifique-se de que remove a eletricidade antes da utilização.**
Caso contrário, podem ocorrer avarias devido à eletricidade estática. (Posição da placa de cuidado: "■ Cuidado 2" na página 12)
- **Remova a eletricidade em torno da unidade de dissipação térmica antes da operação.**
Caso contrário, podem ocorrer avarias devido à eletricidade estática. (Posição da placa de cuidado: "■ Cuidado 5", "■ Cuidado 7", "■ Cuidado 8" e "■ Cuidado 9" na página 12)
- **Não utilize qualquer peça, à exceção do tubo de inserção, debaixo de água nem as limpe debaixo de água corrente.**
Caso contrário, a água irá criar um risco de choque elétrico. As peças, à exceção do tubo de inserção, foram concebidas para terem uma construção à prova de água apenas quando as tampas da bateria e do conector estão completamente fechadas. Não utilize nem armazene o instrumento num ambiente submerso em água.
- **Não submeta o monitor LCD a impactos fortes, a pressões elevadas ou a riscos por parte de um objeto duro ou pontiagudo.**
Caso contrário, o monitor LCD poderá ficar fissurado ou arranhado, sendo possível que o monitor danificado provoque lesões.
- **Ao inclinar a pega, tenha o cuidado de não apertar as mãos ou quaisquer objetos.**

⚠ CUIDADO

- **Utilize o cartão SDHC e microSDHC recomendados pela EVIDENT para gravar imagens.**
Este instrumento é fornecido com um cartão SDHC.
- **Não remova a bateria nem o adaptador de CA durante a operação.**
Caso contrário, poderá danificar os dados gravados.
- **Não remova o cartão SDHC ou o dispositivo de memória USB durante a gravação ou reprodução de imagens.**
Caso contrário, os dados gravados ou o suporte de gravação de imagens poderão ficar danificados ou perdidos.
- **Não repita continuamente a inserção ou remoção do cartão SDHC nem do dispositivo de memória USB.**
Caso contrário, os dados gravados ou o suporte de gravação de imagens poderão ficar danificados ou o cartão SDHC poderá deixar de funcionar corretamente.
- **Tenha os seguintes cuidados durante a utilização da pega extensível da mala de transporte.**
 - Tenha especial atenção para não ficar com a mão presa ao guardar a pega no interior da mala de transporte.
 - Não tente levantar a mala de transporte pela pega extensível.

NOTA

- **Não armazene o instrumento nas seguintes localizações.**
 - Ambientes expostos a elevadas temperaturas ou humidade e a grandes quantidades de pó e de partículas
 - Localizações expostas a luz ou radiação diretas
 - Localizações expostas a gases que incluem halogeneto*1

Caso contrário, o instrumento poderá ficar danificado.

***1 O desempenho de algumas peças elétricas poderá ficar deteriorado devido ao halogeneto presente em inseticidas, pesticidas e agentes de extinção gasosos etc.**
- **Não continue a utilizar o instrumento quando este se encontra húmido por condensação.**
A mudança repentina de temperaturas, como a entrada numa divisão quente vindo do frio exterior poderá provocar condensação no interior do instrumento. Utilizar o instrumento enquanto este se encontra húmido por condensação poderá provocar avarias. Caso a condensação ocorra, deixe o instrumento no ambiente em que vai ser utilizado e permita que a condensação seque antes de o utilizar.
- **Não introduza o tubo de inserção no objeto a ser inspecionado que esteja num ambiente que excede o intervalo de temperaturas de funcionamento.**
A utilização contínua poderá danificar ou deteriorar o desempenho do instrumento.
- **Não utilize o instrumento se existirem contaminantes na superfície exterior do instrumento.**
O instrumento poderá ficar danificado ou o desempenho deteriorar-se.
- **Não cubra a unidade principal com um saco de plástico ou outro tipo de objetos.**
O interior do instrumento poderá não ter arrefecido o suficiente, o que poderá danificar o instrumento.
- **Não permita que outros líquidos, à exceção de água, água salgada, óleo de máquina ou gasóleo, entrem em contacto com o tubo de inserção.**
Caso contrário, poderá danificar o tubo de inserção.

NOTA

- **Tenha em atenção as seguintes precauções ao manusear as tampas da bateria e do conector.**
 - Não abra nem feche as tampas com as mãos molhadas.
 - Não abra nem feche as tampas em áreas expostas a grandes quantidades de humidade e/ou de pó.
 - Feche as tampas ao armazenar o instrumento e quando os terminais não estiverem a ser utilizados.
- **Tenha em atenção as seguintes precauções ao retirar o instrumento da mala de transporte.**
 - Ao retirar a unidade endoscópica ou a unidade principal, não as levante com o tubo de inserção.
O instrumento poderá ficar danificado.
- **Tenha em atenção as seguintes precauções ao armazenar o instrumento na mala de transporte.**
 - Certifique-se de que a extremidade distal arrefeceu suficientemente antes de a armazenar.
- **Ao retirar a unidade endoscópica do respetivo estojo, não a levante com o tubo de inserção.**
- **Tenha em atenção as seguintes precauções ao armazenar a unidade endoscópica no respetivo estojo.**
 - Certifique-se de que a extremidade distal arrefeceu suficientemente antes de a armazenar.
 - Armazene a unidade endoscópica no respetivo estojo com o tubo de inserção enrolado à volta do cilindro.
- **Ao eliminar este produto, certifique-se de que o faz de acordo com todas as leis, normas e regulamentos locais.**
Antes de eliminar este produto, consulte as leis, normas e regulamentos locais, seguindo-os em conformidade.



Precauções de segurança - Precauções de cibersegurança-



CUIDADO

- **Configure as definições de segurança quando utilizar a rede.**
Instale a firewall ou o sistema de deteção/prevenção de intrusão para tomar medidas que previnam um acesso não autorizado a partir do exterior. A EVIDENT não é responsável por danos sofridos pelos clientes devido a um acesso não autorizado a partir do exterior.
- **Não divulgue a palavra-passe a outras pessoas que não os utilizadores.**
Não divulgue a palavra-passe a outras pessoas que não os utilizadores. A EVIDENT não se responsabiliza por fugas de informação, etc., que ocorram em resultado do incumprimento desta condição.
- **Se eliminar ou transferir este instrumento, elimine todas as informações gravadas neste instrumento.**
Para prevenir uma utilização abusiva das informações, elimine as informações gravadas de acordo com os procedimentos descritos em "8-5 Inicializar as informações de rede" antes de eliminar ou transferir este instrumento.

Precauções de segurança - Precauções do conjunto do gancho-

Cumpra rigorosamente as precauções descritas abaixo ao manusear o conjunto do gancho. Antes da utilização, leia atentamente o manual de inspeção do objeto a ser inspecionado para compreender bem as respetivas informações, seguindo-as durante a utilização.

ADVERTÊNCIA

Ao substituir o gancho:

- **Não reutilize o gancho que foi removido da haste em espiral.**
Caso contrário, o gancho poderá cair.
- **Como o orifício no gancho não é roscado, poderá ser difícil enroscar o gancho na haste em espiral. No entanto, continue a enroscar o gancho até este alcançar a sua posição limite na haste em espiral.**
Caso contrário, o gancho poderá cair.
- **Não continue a enroscar mais o gancho depois de este alcançar a sua posição limite na haste em espiral.**
Caso contrário, o gancho e a rosca da haste em espiral poderão ficar danificados. Além disso, o gancho poderá cair.
- **Assim que o gancho estiver encaixado na haste em espiral, não desenrosque o gancho.**
Caso contrário, o gancho poderá cair.
- **Se desenroskar o gancho, remova-o e substitua-o por um novo.**
Caso contrário, o gancho poderá cair.
- **Se não conseguir enroscar o gancho ou se este cair com extrema facilidade, substitua o conjunto do gancho por um sobresselente.**
Caso contrário, o gancho poderá cair.

Ao inserir o conjunto do gancho no canal da unidade endoscópica e ao utilizar o conjunto do gancho:

- **Mantenha a face distante das extremidades do conjunto do gancho.**
Os seus olhos podem ser picados pelas extremidades do conjunto do gancho.
- **Não introduza qualquer ferramenta no canal que não seja especificada pela EVIDENT.**
Poderá não ser possível retirar a ferramenta ou as peças soltas da ferramenta poderão cair.
- **Coloque a tampa de segurança na extremidade proximal do conjunto do gancho antes de utilizar a unidade endoscópica.**
Os seus olhos podem ser picados pela extremidade proximal do conjunto do gancho.
- **Utilize o conjunto do gancho apenas para a parte descrita como necessária pelo manual de inspeção do objeto a inspecionar e em conformidade com as descrições presentes nesse manual acerca desse objeto.**
Caso contrário, poderá acontecer uma falha que resulte na queda do gancho em cima do objeto a inspecionar, danificando-o etc.

Precauções de segurança - Precauções da bateria -

Se tiver algum tipo de problema relacionado com baterias ao utilizar este instrumento, contacte a EVIDENT.

Cumpra rigorosamente as precauções descritas abaixo ao manusear a bateria. O manuseamento indevido de baterias poderá resultar em fugas do fluido da bateria, produção de calor excessivo, fumo, explosão da bateria, choque elétrico e/ou queimaduras.

Antes da utilização, leia atentamente o manual de instruções fornecido com o carregador de baterias para compreender na totalidade as respetivas informações, seguindo-as durante a utilização.

PERIGO

- **Utilize a bateria NP-L7S e o carregador de baterias JL-2Plus.**
(Posição da placa de cuidado: "■ Cuidado 3" na página 12)
- **Não permita a ocorrência de curtos-circuitos nos terminais.**
- **Não solde a bateria diretamente ao terminal.**
- **Não ligue os eletrodos da bateria com metal nem transporte ou armazene a bateria juntamente com colares de metal, ganchos para o cabelo ou outro tipo de objetos de metal.**
- **Não ligue a bateria diretamente à tomada elétrica ou ao isqueiro do carro.**
- **Não mergulhe a bateria em água doce ou salgada nem permita que a bateria fique molhada.**
- **Não atire a bateria ao fogo nem a submeta ao calor.**
- **Não abra nem modifique a bateria.**
- **Não pise nem atinja a bateria com um martelo.**
- **Não submeta a bateria a impactos fortes.**
- **Não utilize nem deixe a bateria numa área exposta à luz do sol direta, num automóvel ao sol ou perto de uma fonte de calor etc.**
- **Se o fluido em fuga da bateria entrar em contacto com os seus olhos, poderá resultar na perda de visão. Neste caso, lave os olhos com água da torneira ou outro tipo de água limpa sem esfregar e consulte imediatamente um médico.**
- **Não utilize o carregador de baterias no exterior.**
Caso contrário, poderá ocorrer choque elétrico, fumo ou incêndio que podem provocar danos ao carregador. O carregador de baterias foi concebido para utilização no interior.

ADVERTÊNCIA

- **Durante o carregamento, não cubra o carregador de baterias com vestuário, roupa de cama ou outro tipo de materiais.**
- **Quando o carregamento estiver concluído, retire sempre a ficha do carregador de baterias da tomada elétrica.**
- **Se sentir produção de calor, odor anormal, ruído anormal, fumo ou outro tipo de anomalia, retire imediatamente a ficha do carregador de baterias da tomada elétrica e pare de o utilizar.**
Contacte a EVIDENT.
- **Se o carregador de baterias não concluir o carregamento da bateria no tempo de carregamento especificado pare de tentar recarregar a bateria.**

⚠️ ADVERTÊNCIA

- **Não utilize a bateria se esta apresentar alguma irregularidade como fugas de líquido, descoloração, deformação, odor anormal ou outro tipo de anomalia.**
Solicite imediatamente o serviço de reparações.
- **Se o fluido da bateria entrar em contacto com a sua pele ou vestuário, lave imediatamente com água da torneira ou outro tipo de água limpa.**
Caso contrário, tal poderá resultar em lesões na pele. Se necessário, contacte um médico para obter tratamento.
- **Não permita que o compartimento da bateria fique deformado e nunca coloque um objeto estranho no seu interior.**
- **Não permita que metal, água ou qualquer outro tipo de fluido entre no compartimento da bateria ou entre em contacto com os terminais da bateria.**
Se algum objeto estranho conseguir entrar na unidade principal, remova a bateria, desligue o adaptador de CA e contacte imediatamente a EVIDENT.
- **Não remova imediatamente a bateria se o instrumento tiver sido utilizado continuamente durante um longo período de tempo.**
O calor produzido pela bateria provoca o risco de queimaduras.
- **Não deixe a bateria num local exposto a humidade, fugas de água ou temperaturas extremamente altas ou baixas.**
- **Não toque nos terminais da bateria com as mãos molhadas.**
- **Se não pretende utilizar o instrumento durante um longo período de tempo, remova a bateria da unidade principal e armazene-a num local seco.**
Caso contrário, poderá haver fuga do fluido da bateria e a produção de calor poderá resultar em incêndio ou lesões.
- **Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.**

⚠️ CUIDADO

- **Se tiver dificuldade na inserção da bateria, não tente forçar a sua inserção.**
Verifique a orientação da bateria e os terminais em relação a anomalias. A tentativa de inserir com força a bateria no respetivo compartimento poderá resultar em avaria.
- **Se tiver dificuldade na remoção da bateria do instrumento, não tente forçar a remoção.**
Contacte a EVIDENT.
- **Contacte antecipadamente as companhias aéreas se quiser transportar a bateria no avião.**
- **Ao substituir a bateria, não a insira nem remova repetidamente e com rapidez.**
Caso contrário, poderá não ser possível LIGAR a alimentação.
- **Ao eliminar a bateria, certifique-se de que o faz de acordo com todas as leis, normas e regulamentos locais.**
Antes de eliminar baterias, consulte as leis, normas e regulamentos locais, seguindo-os em conformidade.

NOTA

- A contaminação dos elétrodos da bateria com suor ou óleo irá provocar a falha do contacto. Se a bateria estiver suja, limpe-a com um pano seco antes de a utilizar.
- Utilize a bateria de forma correta. Se a bateria for utilizada incorretamente, tal poderá resultar em fugas de líquido, produção de calor ou danos. Insira a bateria com a orientação correta quando a substituir.
- Intervalo de temperaturas recomendado para a operação de baterias de iões de lítio.
 - Descarregamento (utilizando a unidade principal) : entre -10 °C e 40 °C
 - Carregamento : entre 0 °C e 45 °C
 - Armazenamento : entre -20 °C e 60 °C

Utilizar a bateria sob temperaturas que excedem o intervalo de temperaturas descrito acima irá resultar na degradação do seu desempenho e vida útil. Antes de armazenar o instrumento, certifique-se de que remove a bateria da unidade principal.

Precauções de segurança - Precauções com a luz de iluminação -

Este produto está equipado com uma iluminação de alta intensidade para obtenção de uma luminosidade suficiente para observação do objeto de inspeção. Se a iluminação deste produto estiver LIGADA, é emitida uma luz intensa a partir da extremidade distal do tubo de inserção da unidade endoscópica. Cumpra rigorosamente as precauções descritas abaixo quando utilizar este produto.

CUIDADO

- **Desligue a iluminação, se esta não for necessária.**
Se a luz de iluminação incidir nos olhos do utilizador, os olhos podem sofrer lesões. Se observar a luz de iluminação durante um longo período, mesmo na periferia do seu campo de visão, os seus olhos podem sofrer lesões.
Se existir a possibilidade de a luz de iluminação incidir em olhos humanos, desligue a iluminação, se esta não for necessária.
Em particular, lembre-se de que a iluminação é LIGADA automaticamente nos casos indicados a seguir.
 - Quando a alimentação é LIGADA enquanto o adaptador ótico está instalado.
 - Quando instala o adaptador ótico enquanto a alimentação está LIGADA.
- **Não olhe diretamente para a luz de iluminação.**
Caso contrário, os seus olhos podem sofrer lesões. Se observar a luz de iluminação durante um longo período, mesmo de lado ou transversalmente, os seus olhos podem sofrer lesões.
- **Não olhe para a luz refletida da luz de iluminação.**
A luz refletida da luz de iluminação pode ser captada pelos olhos, dependendo do formato da superfície refletora. Se essa luz refletida incidir nos olhos do utilizador, os seus olhos podem sofrer lesões.
- **Se houver pessoas à sua volta, chame a atenção para os riscos de acordo com as precauções descritas nesta página.**
As pessoas à sua volta podem sofrer lesões nos olhos.
- **Não deixe a extremidade distal do tubo de inserção com a iluminação LIGADA perto de substâncias inflamáveis durante um longo período.**
Caso contrário, tal poderá resultar num incêndio.

Informações da IEC62471

- GRUPO DE RISCO 2

 **CUIDADO:** Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa. Não olhe para a luz de funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos.

DICA

Este produto utiliza fluorescência (luz branca) emitida a partir de fósforo excitado pelo feixe de laser como luz de iluminação. O feixe de laser não é emitido a partir deste produto.

Placa de classificação/cuidado

As classificações de segurança, cuidados e números de série são apresentados pela etiqueta fixada neste produto.

Estude o significado dos símbolos de segurança e utilize sempre o produto da forma mais segura possível.

Símbolo	Significado
	Indica um perigo geral não específico. Siga as descrições fornecidas a seguir a este símbolo ou presentes no manual de instruções.
	Indica que a extremidade distal do tubo de inserção está quente e não deve ser tocada com as mãos sem proteção. Pode provocar queimaduras.
	Indica que o feixe de laser está aplicado. Tenha especial atenção durante o manuseamento.

Se as etiquetas estiverem em falta ou o respetivo conteúdo estiver ilegível, contacte a EVIDENT.

Unidade de base

■ Cuidado 4

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

■ Cuidado 5



■ Cuidado 6

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

レーザー放射
ビームを覗かないこと
クラス2 レーザ製品

RENVONCEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2

激光放射
直射を避けること
2 类激光产品

Model: IVD9 400 - 700nm
IEC60825-1:2014
EN60825-1:2014/A11:2021
GB7247.1-2012 JIS C8902:2018

If the product complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.36, issued May 8, 2019.



■ Nome do modelo, número de série

MODEL IV9***N
Serial# Y*****
*** **

■ Classificação, Cuidado 1



INDUSTRIAL ENDOSCOPE
EVIDENT-REDA
CE    JIS Z15132:2020005
OLYMPUS CORPORATION
MADE IN JAPAN

AC Adapter 10V ~ 40W
Battery 14.0V ~ 40W
INPUT  
Shinjuku Office: 2-1
Mitsui-Shinjuku Bldg. 2/F
Shinjuku-Ku Tokyo
162-8504, Japan

■ Cuidado 2



■ Cuidado 3



■ Cuidado 7




■ Cuidado 8



■ Cuidado 9




Unidade endoscópica (opcional)

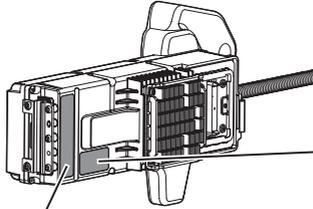

■ Etiqueta de conformidade




■ Cuidado

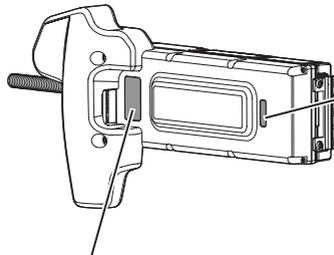



■ Etiqueta sem descrição




■ Nome do modelo, número de série



Unidade endoscópica estéreo (opcional)

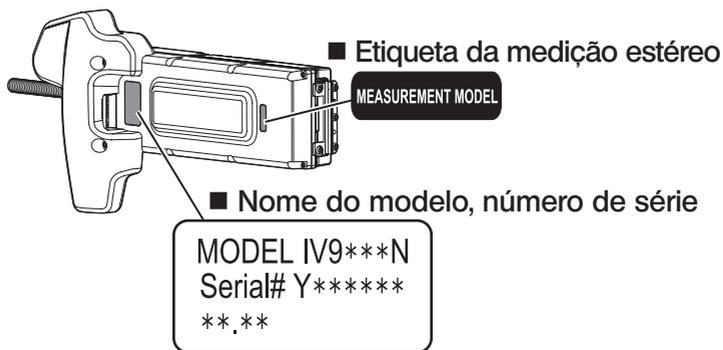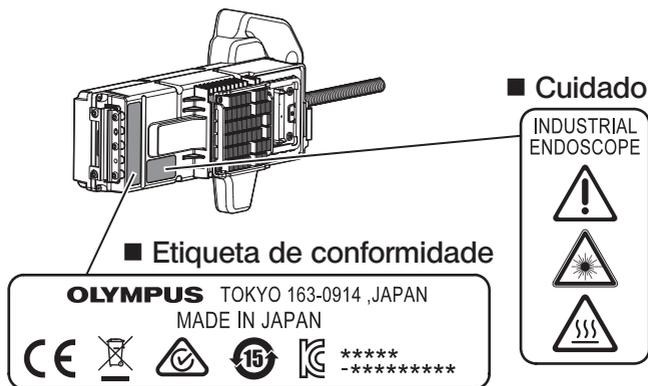

Unidade de controlo remoto (opcional)

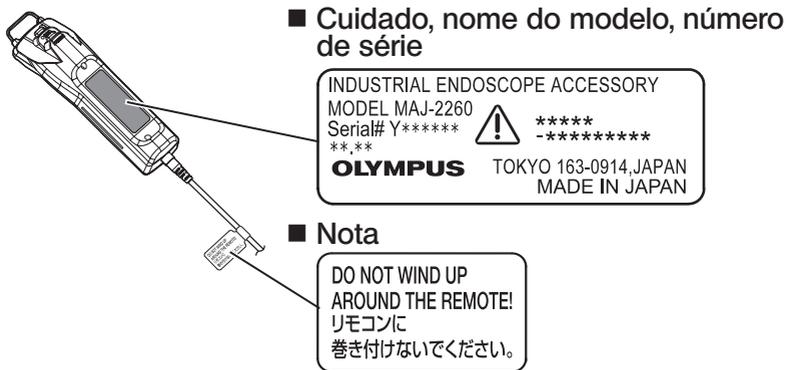

1 Desembalar

1-1 Desembalar

Ao desempacotar, certifique-se de que todos os itens listados abaixo estão incluídos. Se algo estiver em falta ou danificado, contacte a EVIDENT.

Nome	Quantidade
Unidade de base*	1
Suporte de gravação de imagens (cartão SDHC)	1
Adaptador de CA	1
Fixador do endoscópio	1
Suporte do LCD	1
Alça para o ombro	1
Manual de instruções	1
Mala de transporte	1


* Para saber como armazenar o instrumento na mala de transporte, consulte a etiqueta que descreve o procedimento de armazenamento fixa na superfície interior da tampa superior da mala de transporte.

1 Armazenar na caixa do adaptador ótico

Os seguintes itens podem ser armazenados na caixa do adaptador ótico fornecida com a unidade endoscópica opcional ou a unidade endoscópica estéreo opcional.

- Adaptador ótico
- Cartão SDHC
- Anel de vedação
- Escova do kit de limpeza da lente

Armazene estes itens na caixa do adaptador ótico quando não estiverem a ser utilizados. A figura à direita indica os locais de armazenamento de cada item.

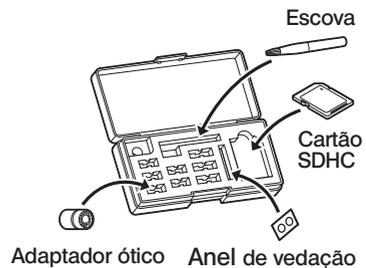

• Unidade endoscópica

Nome	Quantidade
Unidade endoscópica	1
Cilindro	1
Caixa do adaptador ótico	1

Nome	Quantidade
Kit de limpeza da lente (cotonete e escova)	1
Manual de instruções	1
Autocolante com identificação do número de modelo	1

• Unidade endoscópica estéreo

IV9●●●●N (●●●● indica o diâmetro e o comprimento do endoscópio.)

Nome	Quantidade
Unidade endoscópica	1
Cilindro	1
Caixa do adaptador ótico	1
Kit de limpeza da lente (cotonete e escova)	1
Manual de instruções	1
Autocolante com identificação do número de modelo	1
Guia de referência da medição estéreo	1
Ferramenta de verificação	1
Certificado de calibração da ferramenta de verificação	1

Nome	Quantidade
(ao utilizar a IV9●●●●N-MD) • Adaptador ótico estéreo de vista frontal	1
(ao utilizar a IV9●●●●N-MDS) • Adaptador ótico estéreo de vista frontal • Adaptador ótico estéreo de vista lateral	1 1
Anel de vedação (ao utilizar a IV9●●●●N-MD) (ao utilizar a IV9●●●●N-MDS)	6 12
Folha de registo do adaptador ótico estéreo	1

• Adaptador ótico

Nome	Quantidade
Adaptador ótico	1
Anel de vedação	6
Manual de instruções	1

※ Com a IV9635X1N, são fornecidos os seguintes itens para além dos itens que acompanham a unidade endoscópica. Com a IV9635X1N-MD ou a IV9635X1N-MDS, são fornecidos os seguintes itens para além dos itens que acompanham a unidade endoscópica estéreo.

Nome	Quantidade
Conjunto do gancho	2
Gancho	6
Estojo do conjunto do gancho	1

Nome	Quantidade
Tampa de segurança (sobresselente)	1
Pega da abertura do canal	1
Grampo de cinto	1

A IV9635X1N, IV9635X1N-MD ou a IV9635X1N-MDS podem ser utilizadas com a versão de software 1.40A ou posterior deste produto.

Se estiver a utilizar uma versão anterior à 1.40A, transfira a versão de software mais recente a partir do seguinte URL e atualize o software utilizado.

<https://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>


Consulte o “Quadro do sistema” (página 126) para obter informações sobre outras opções.

2 Nomenclatura


2-1 Nomenclatura

Unidade de base

A unidade de base é composta pela unidade principal e a unidade LCD.

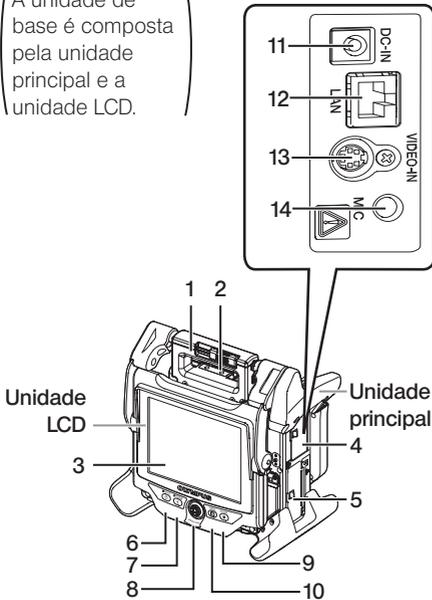


Unidade principal

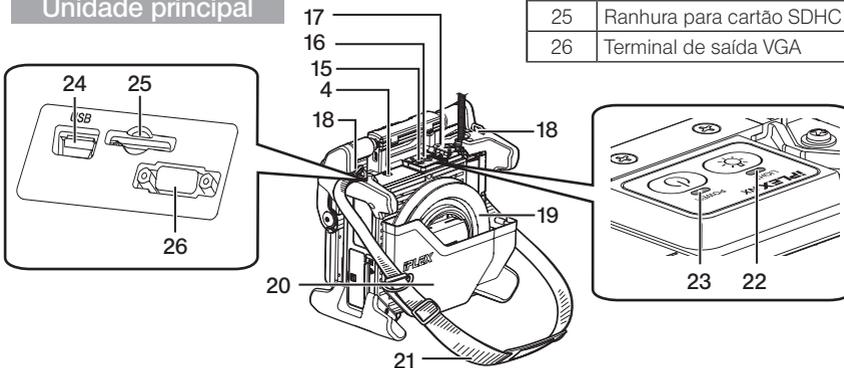


N.º	Nome
1	Pega
2	Alavanca de fixação da pega da unidade LCD
3	Monitor LCD
4	Tampa do conector
5	Tampa da bateria
6	Botão [ROTATE]
7	Botão [ANGLE SEL/CENTER]
8	Joystick [ANGLE/LOCK]
9	Botão [RECORD]
10	Botão [FREEZE]
11	Terminal DC-IN
12	Porta LAN
13	Terminal de entrada de vídeo externo
14	Terminal de entrada de microfone
15	Botão [POWER] (⏻)
16	Botão [LIGHT] (💡)
17	Fecho
18	Suporte de alça
19	Cilindro
20	Caixa do cilindro e suporte da unidade de controlo remoto
21	Alça para o ombro
22	Indicador [LIGHT]
23	Indicador [POWER]
24	Conector USB
25	Ranhura para cartão SDHC
26	Terminal de saída VGA

Unidade principal




N.º	Nome
1	Fixador de cabo para o cabo LCD comprido
2	Tampa do conector LCD
3	Suporte do tubo de inserção
4	Gancho para encaixe da unidade de controlo remoto

Unidade LCD

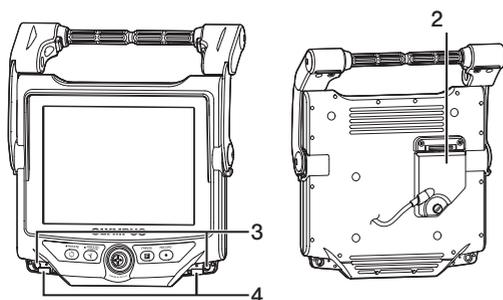


Unidade endoscópica

IV9●●●●N, IV9●●●●N-MD, IV9●●●●N-MDS

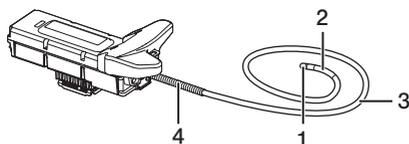



N.º	Nome
1	Extremidade distal
2	Secção de angulação
3	Tubo de inserção
4	Alívio de tensão do endoscópio

IV9635X1N, IV9635X1N-MD, IV9635X1N-MDS

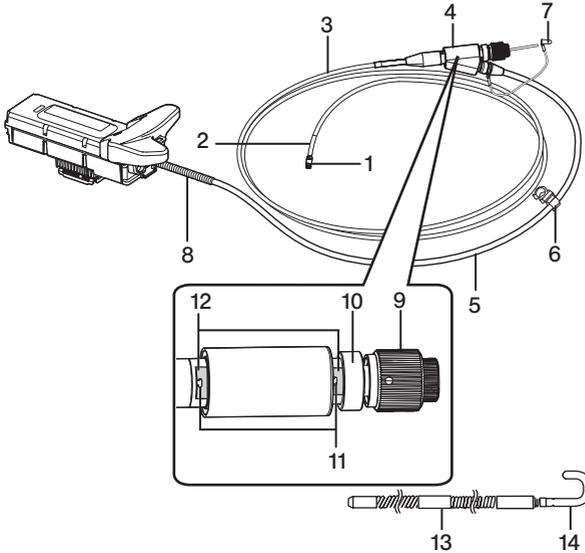

N.º	Nome
1	Extremidade distal
2	Secção de angulação
3	Tubo de inserção
4	Abertura do canal
5	Cabo universal
6	Suporte da pega
7	Tampa de segurança
8	Alívio de tensão do endoscópio
9	Mandril
10	Anel de bloqueio
11	Saliências (duas posições em cada um dos lados posterior e anterior)
12	Superfície plana (duas posições em cada um dos lados posterior e anterior)
13	Haste em espiral
14	Gancho

Unidade de controlo remoto

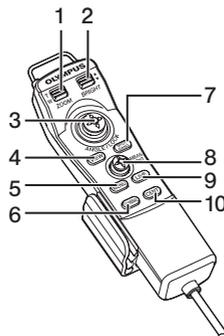


N.º	Nome
1	Alavanca [ZOOM]
2	Alavanca [BRIGHT]
3	Joystick [ANGLE/LOCK]
4	Botão [MEW]
5	Botão [MENU]
6	Botão [THUMBNAIL]
7	Botão [SPOT RANGING] (Apenas medição estéreo)

N.º	Nome
8	Joystick [MEAS/ENTER]
9	Botão [LIVE]
10	Botão [CENT]
11	Apoio para encaixe da unidade LCD
12	Botão [FREEZE]
13	Botão [RECORD]
14	Pega do tubo de inserção

2-2 Nomenclatura da extremidade distal/adaptador ótico


Modelo de 4 mm

● Extremidade distal




● Adaptador ótico, adaptador ótico estéreo

Vista lateral



Vista frontal




● Vista interior do adaptador ótico




Modelo de 6 mm

● Extremidade distal




● Adaptador ótico, adaptador ótico estéreo

Vista lateral



Vista frontal




● Vista interior do adaptador ótico




Modelo de 6,2 mm

● Extremidade distal




● Adaptador ótico, adaptador ótico estéreo

Vista lateral



Vista frontal



● Vista interior do adaptador ótico




N.º	Nome
1	Ranura de posicionamento do adaptador ótico
2	Primeira rosca
3	Segunda rosca
4	Rosca de ligação
5	Lente da objetiva
6	Porca
7	Anel de vedação

N.º	Nome
8	Iluminação
9	Abreviatura do nome do produto* e número de série (adaptador ótico estéreo)
10	Pino de posicionamento
11	Pinos de contacto
12	Canal

* Para obter informações sobre a abreviatura do nome do produto, consulte "11-3 Especificações do adaptador ótico" (página 124).


2-3 Nomenclatura do monitor LCD

Ecrã em tempo real

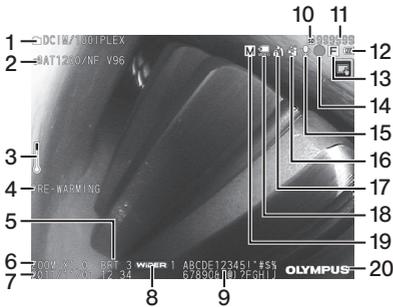


N.º	Ícone/Indicador	Nome
1	-	Nome da pasta
2	-	Nome do adaptador ótico
3		Indicador de temperatura da extremidade distal
4	PRE-WARNING	Ícone de aquecimento
5	-	Nível de brilho
6	-	Nível de zoom
7	-	Data/hora
8		Ícone WiDER
9	-	Título
10		Ícone do suporte (SD ou USB)
11	-	Número de imagens graváveis
12		Indicador de bateria
13		Ícone de fixação
14		Ícone de filme em gravação
15		Ícone de som em gravação
16		Ícone de centragem de ângulo
17		Ícone de bloqueio de ângulo
18		Ícone de entrada externa
19		Ícone manual
20	-	Logótipo

Ecrã de miniaturas

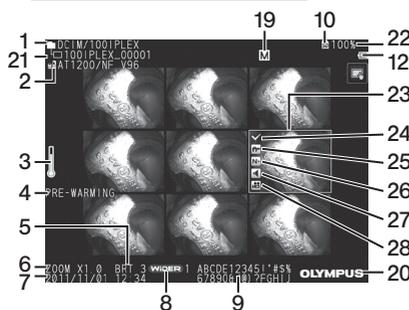


Ecrã de visualização

● Ao reproduzir a imagem fixa

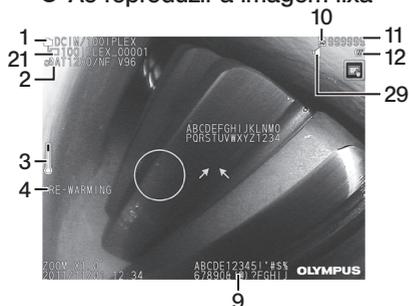

● Ao reproduzir o filme

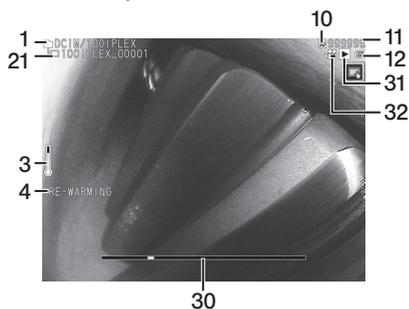

N.º	Ícone/Indicador	Nome
1	-	Nome da pasta
2	-	Nome do adaptador ótico
3		Indicador de temperatura da extremidade distal
4	PRE-WARNING	Ícone de aquecimento
5	-	Nível de brilho
6	-	Nível de zoom
7	-	Data/hora
8		Ícone WIDER
9	-	Título
10		Ícone do suporte (SD ou USB)
11	-	Número de imagens graváveis
12		Indicador de bateria
19		Ícone manual
20	-	Logótipo
21	-	Nome do ficheiro
22	-	Capacidade restante do suporte
23	-	Fotograma de seleção de miniatura
24		Marca
25		Ícone de medição
26		Ícone de nota
27		Ícone de som
28		Ícone de filme
29		Ícone de reprodução de som
30		Barra de posicionamento da reprodução do filme
31		Ícone do estado de reprodução do filme (Reproduzir, colocar em pausa ou terminar a reprodução)
32		Ícone de reprodução do filme


DICA

- O título apresentado é o título que foi introduzido no ecrã em tempo real na última vez em que o sistema foi utilizado.
- Se observar qualquer tipo de sujidade, manchas ou outras anomalias no monitor LCD, consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).

Painel tátil

Os botões no painel tátil são apresentados da mesma forma no ecrã em tempo real, no ecrã de miniaturas e no ecrã de visualização.

Quando os botões do painel tátil estão ocultos

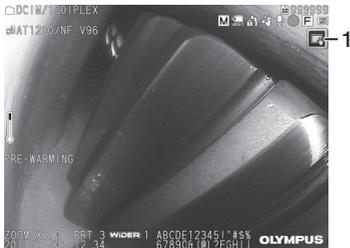

Quando os botões do painel tátil estão visíveis



N.º	Nome
1	Botão de apresentação dos botões do painel tátil
2	Botão [ZOOM]
3	Botão [BRT]
4	Botão de ocultação dos botões do painel tátil
5	Botão [MENU]
6	Botão [LIVE]
7	Botão [VIEW]
8	Botão [THUMBNAIL]
9	Botão [SPOT RANGING]
10	Botão [MEASURE]
11	Botão [Move] (setas para cima/baixo/esquerda/direita) Botão [ENTER] (ao centro)

3 Preparação e inspeção prévias à operação

Certifique-se de que desempenha a preparação e a inspeção descritas neste capítulo antes de utilizar o instrumento. Ao primeiro sinal de qualquer tipo de anomalia, pare imediatamente de utilizar o instrumento e desempenhe as ações necessárias conforme descrito em "9 Resolução de problemas" (página 107).


As inspeções são necessárias antes da utilização e devem ser realizadas de forma periódica.

NOTA

Certifique-se de que a alimentação do instrumento está **DESLIGADA** antes de realizar a preparação e inspeção prévias à operação.


3-1 Deslocar a mala de transporte

■ Ao utilizar a pega

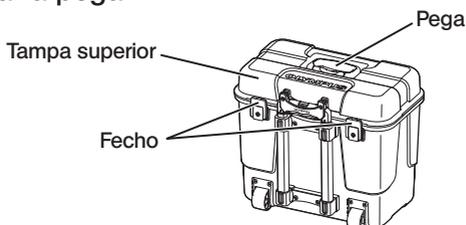

Certifique-se de que o fecho está bem fechado antes de levantar a mala de transporte.

■ Deslocar utilizando a pega extensível

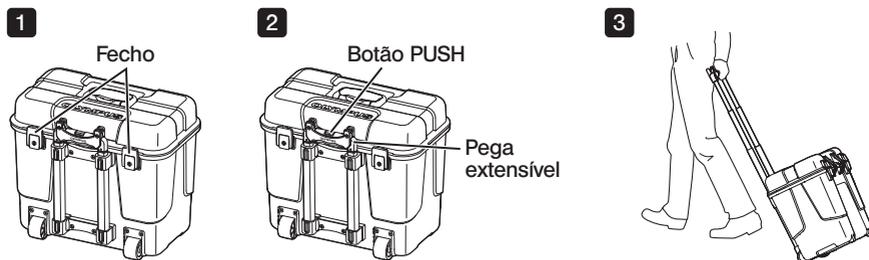


- 1** Certifique-se de que o fecho está completamente fechado.
- 2** Prima o botão PUSH para desbloquear a pega e a estender.
Prima novamente o botão PUSH para desbloquear a pega e guardá-la.
- 3** Segure na pega para levantar um lado da mala de transporte e a deslocar deslizando pelo chão as rodas colocadas na parte inferior da mala de transporte.

3-2 Colocar o instrumento


1 Remover componentes da mala de transporte

Segure na pega ao retirar da mala de transporte.

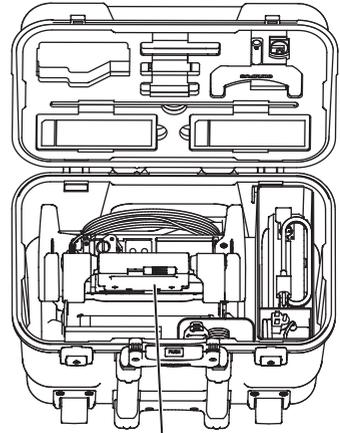


Pega

2 Colocar a unidade principal numa superfície plana



Orientação horizontal




Orientação vertical


A unidade principal pode ser colocada na orientação horizontal ou na orientação vertical. Coloque-a num local estável.

3 Ajustar a altura e a direção da unidade LCD

Pressione a tampa da pega e puxe para cima o monitor LCD para ajustar a altura do mesmo.



Rode o monitor LCD à volta da pega de encaixe para ajustar a direção.



4 Colocar a unidade LCD


A unidade LCD pode ser removida da unidade principal e colocada em separado utilizando o cabo LCD comprido (opcional).

■ Remover a unidade LCD

Deslize horizontalmente a alavanca de fixação da pega da unidade LCD na parte superior da unidade principal para abrir a tampa da pega.

Remova a unidade LCD da unidade principal.


Após a remoção da unidade LCD da unidade principal, coloque novamente a tampa da pega da unidade principal na sua posição original.

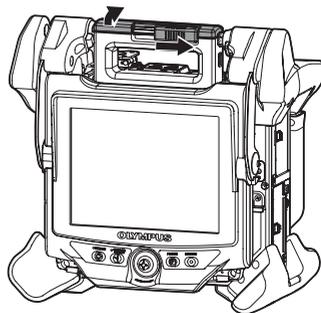

● Ligar a unidade LCD

Ligue a unidade LCD pela ordem contrária aos procedimentos de remoção.

■ Ligar o cabo LCD comprido

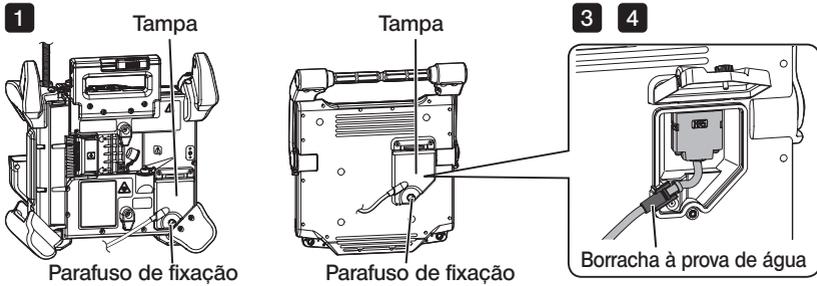

- 1** Desaperte os parafusos de fixação das tampas do conector LCD da unidade principal e da unidade LCD e abra a tampa.
- 2** Remova o cabo LCD da unidade principal e da unidade LCD.
- 3** Ligue o cabo LCD comprido à unidade principal e à unidade LCD.
- 4** Coloque a borracha à prova de água do cabo LCD comprido, tal como apresentado acima.
- 5** Feche as tampas do conector LCD da unidade principal e da unidade LCD e aperte os parafusos de fixação.

NOTA


- Coloque corretamente a borracha à prova de água e certifique-se de que aperta os parafusos de fixação das tampas. Caso contrário, não poderá ser assegurada a resistência à água.
- Certifique-se de que **DESLIGA** a alimentação antes de remover ou ligar o cabo LCD ou o cabo LCD comprido.
Caso contrário, o instrumento poderá ficar danificado.

■ Colocar apenas a unidade LCD


Remova a unidade LCD da unidade principal, coloque a unidade LCD na pega da mala de transporte e fixe-a.

NOTA


- **Ao ajustar o ângulo da pega da unidade LCD, segure na pega da mala de transporte para suportar com firmeza a unidade LCD.**
Caso contrário, a mala de transporte ou a unidade LCD poderão cair.
- **Se estiver a utilizar a unidade principal dentro da mala de transporte, não feche a tampa da mala de transporte.**
Caso contrário, os cabos poderão ficar presos entre a mala de transporte e a respetiva tampa.



Ao realizar observações pendurando a unidade LCD, coloque um gancho em S ou fio etc. na pega e pendure o monitor LCD.

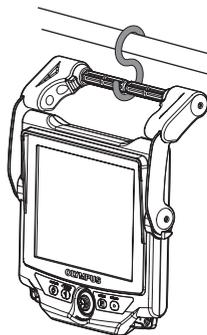

Ao realizar observações colocando a unidade LCD na secretária ou semelhante, fixe o adaptador de suporte do LCD (feito pela Manfrotto/disponível no mercado) na secretária ou semelhante. Insira o suporte do LCD no adaptador de suporte do LCD e depois encaixe a unidade LCD ao suporte e segure-a.

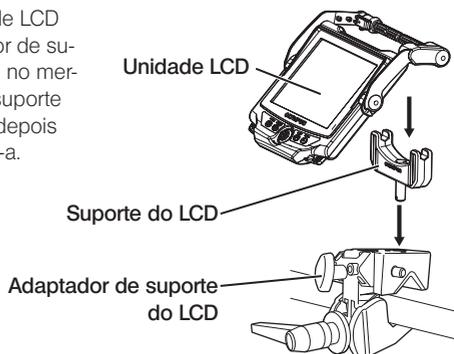

3-3 Preparar a fonte de alimentação

1 Utilizar a bateria

■ Verificar o nível restante de bateria (na bateria)


A energia restante da bateria pode ser verificada no [POWER INDICATOR] da bateria. (Tenha em atenção que a energia restante da bateria que é apresentada no monitor LCD é diferente da que é apresentada no [POWER INDICATOR].)

Enquanto o botão [CHECK] estiver a ser premido, o LED (com 3 níveis) que apresenta o estado de carregamento fica LIGADO.

Quando acende ●●●: energia quase completamente carregada.


Quando acende ●: recarregamento necessário.

Botão [CHECK]

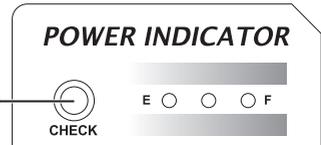

Para obter mais informações, consulte o manual de instruções da bateria.

■ Inserir a bateria na unidade principal

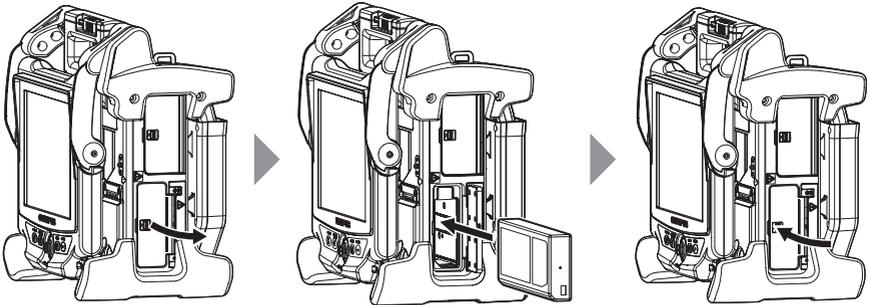

Abra a tampa da bateria.

Tenha em atenção a orientação da bateria ao inseri-la.

Certifique-se de que a bateria está bloqueada e feche a tampa.

Confirme se a tampa da bateria está completamente fechada.

DICA


- Certifique-se de que carrega a bateria antes de a utilizar pela primeira vez após a compra ou depois de um longo período em que a mesma não foi utilizada.
- Em geral, o desempenho da bateria degrada-se à medida que a temperatura ambiente desce. Tenha em atenção que um desempenho da bateria degradado devido a baixas temperaturas é recuperado assim que a temperatura aumentar para um nível normal.
- Um carregamento completo irá proporcionar aproximadamente 100 minutos (em geral) de operação contínua. O tempo de funcionamento depende do método de carregamento, do ambiente de funcionamento e da forma como o instrumento foi configurado. É recomendada a preparação de várias baterias sobresselentes no caso de serem esperadas longas horas de operações alimentadas a bateria. O tempo de carregamento normal de uma bateria é de aproximadamente duas horas e trinta minutos (em geral).
- Se aparecer a seguinte mensagem ao LIGAR a fonte de alimentação deste instrumento, significa que a bateria está a aquecer. Utilize o instrumento depois de a mensagem desaparecer.

[PRE-WARMING]


- A bateria é um item consumível.
- A bateria não pode ser carregada por este instrumento. Para obter informações sobre como carregar a bateria, consulte o manual de instruções fornecido com o carregador de baterias.

● Remover a bateria

Remova a bateria levantando a aba na ranhura de inserção da bateria.

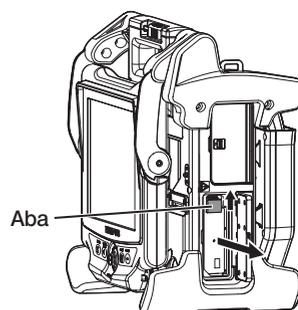

2 Utilizar o adaptador de CA

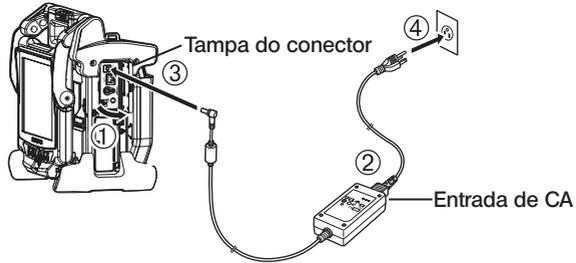

- ① Abra a tampa do conector na parte lateral da unidade principal.
- ② Ligue o cabo de alimentação de CA à entrada de CA do adaptador de CA.
- ③ Ligue o conector de saída do adaptador de CA ao terminal DC-IN da estrutura principal.
- ④ Ligue de forma segura a ficha do cabo de alimentação de CA a uma tomada elétrica trifásica.

3-4 Retirar o tubo de inserção



Remova o cilindro da respetiva caixa na unidade principal e retire o tubo de inserção do cilindro.

NOTA

- **Segure o cilindro ao retirar o tubo de inserção.**
- **Não aplique força excessiva sobre o tubo de inserção ao retirá-lo do cilindro.** Caso contrário, poderá danificar o tubo de inserção.

■ Armazenar o tubo de inserção

Insira a extremidade distal do tubo de inserção até que este toque ligeiramente no orifício de suporte da extremidade distal e enrole o tubo de inserção à volta do cilindro.

Orifício de suporte da
extremidade distal



NOTA

- **Ao armazenar este instrumento durante um longo período ou ao transportá-lo, armazene o tubo de inserção no cilindro.**
- **Ao inserir a extremidade distal do tubo de inserção na secção de suporte, não a insira com força excessiva.** Caso contrário, poderá danificar o tubo de inserção.
- **Certifique-se de que o tubo de inserção não está torcido antes de o enrolar à volta do cilindro.**

3-5 Colocar e remover o adaptador ótico

NOTA

- **Certifique-se de que coloca o anel de vedação na extremidade distal do tubo de inserção antes de utilizar o adaptador ótico.**


A entrada de água na área de união entre o tubo de inserção e o adaptador ótico poderá provocar avarias ou danos. Tenha também em atenção que o adaptador ótico não é, por si só, à prova de água.

- **Nunca utilize o instrumento quando existir água ou sujidade no interior do adaptador ótico.**


Caso contrário, pode ser perdida a estanquidade à água entre o adaptador ótico e a extremidade distal ou danificar o adaptador ótico ou a extremidade distal.

- 1 Segurando o adaptador ótico e a extremidade distal de forma a que formem uma linha reta, insira cuidadosamente o adaptador ótico na extremidade distal.


■ Modelo de 4 mm

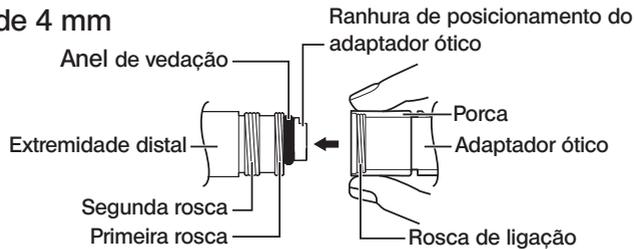

■ Modelo de 6 mm

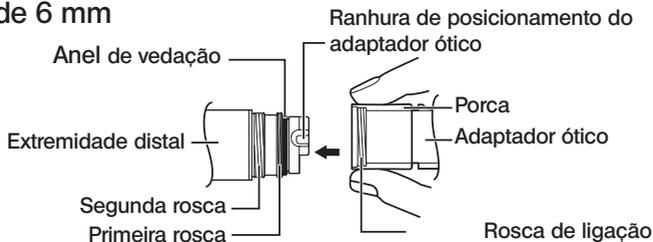

■ Modelo de 6,2 mm

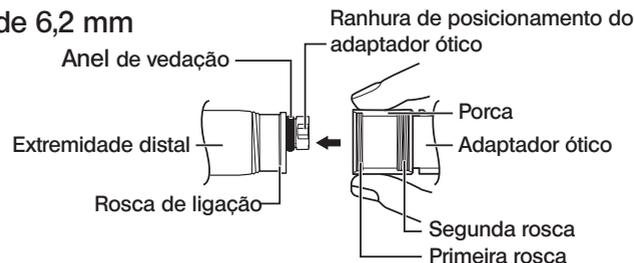


2 Rode a porca do adaptador ótico para a direita até que a rosca de ligação ultrapasse a primeira rosca.

3 Depois de ultrapassar a primeira rosca, rode todo o corpo principal do adaptador ótico para a direita, ao mesmo tempo que o empurra cuidadosamente até que o corpo principal do adaptador ótico encaixe na ranhura de posicionamento do tubo de inserção e pare de rodar.




4 Rode a porca do adaptador ótico para a direita para encaixar a rosca de ligação na segunda rosca. Aperte a porca até esta parar completamente.

Adaptador ótico



Porca

Corpo principal do adaptador ótico




■ Remover o adaptador ótico


Remova o adaptador ótico pela ordem contrária aos procedimentos de colocação.

3-6 Remover a unidade endoscópica

1

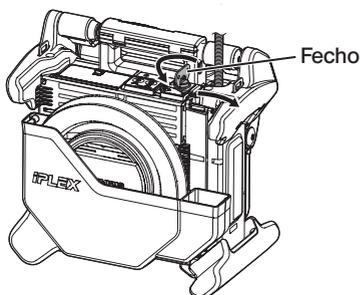


2

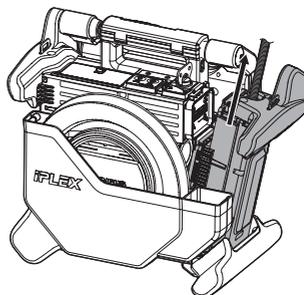

1 Rode o fecho na parte superior da unidade principal no sentido contrário dos ponteiros do relógio para o desbloquear.

2 Remova a unidade endoscópica.

■ Ligar a unidade endoscópica

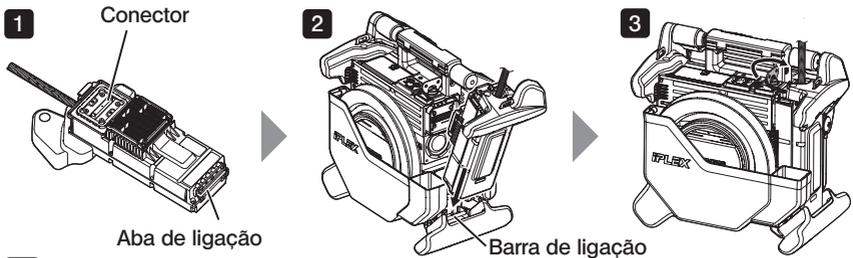


- 1 Certifique-se de que a extremidade do conector não está suja. Se estiver suja, limpe-a completamente com a cotonete fornecida no kit de limpeza da lente.
- 2 Faça corresponder a aba de ligação da unidade endoscópica com a barra de ligação da unidade principal e ligue a unidade endoscópica à unidade principal.
- 3 Rode o fecho para a direita para o bloquear.

NOTA

Certifique-se de que DESLIGA a alimentação antes de remover ou ligar a unidade endoscópica.

Caso contrário, o instrumento poderá ficar danificado.


3-7 Ligar a unidade de controlo remoto à unidade principal

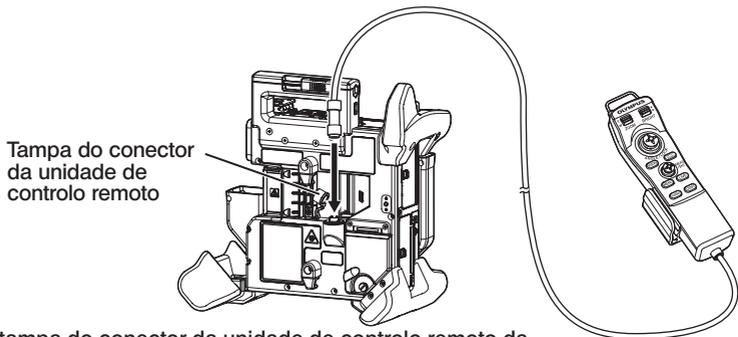

Remove a tampa do conector da unidade de controlo remoto da unidade principal. Em seguida, insira o conector da unidade de controlo remoto no respetivo conector da unidade principal e rode o conector da unidade de controlo remoto no sentido dos ponteiros do relógio para estabelecer a ligação da mesma.

DICA

Se necessário, coloque a pega do tubo de inserção na unidade de controlo remoto e atravesse o tubo de inserção pela pega. Agarrar a pega do tubo de inserção juntamente com a unidade de controlo remoto permite que segure de forma estável o tubo de inserção.

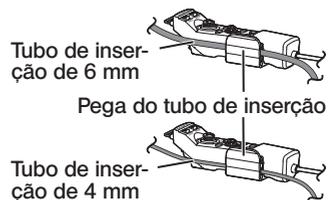

■ Remover a unidade de controlo remoto


Remova a unidade de controlo remoto pela ordem contrária aos procedimentos de ligação.

NOTA


- Não aplique força excessiva sobre a secção de ligação enquanto a unidade de controlo remoto estiver ligada à unidade principal.
- Certifique-se de que DESLIGA a alimentação antes de remover ou ligar a unidade de controlo remoto.
Caso contrário, o instrumento poderá ficar danificado.

■ Armazenar a unidade de controlo remoto

Armazene a unidade de controlo remoto no respetivo suporte.




Para arrumar, enrole os cabos com uma abraçadeira, conforme ilustrado na figura abaixo.

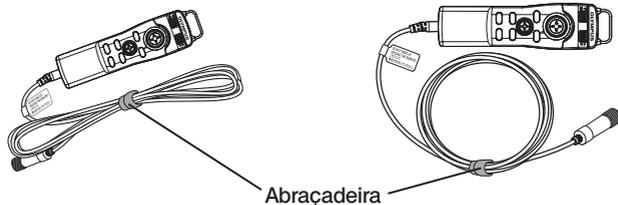

NOTA


Não enrole o cabo à volta da unidade de controlo.

Caso contrário, pode ser exercida uma força excessiva sobre o cabo, o que pode danificá-lo.



3-8 Ligar o cartão SDHC/dispositivo de memória USB

■ Inserir o cartão SDHC

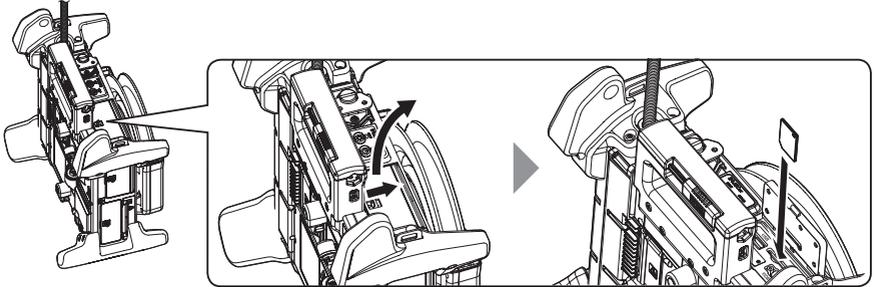


Abra a tampa do conector

Tenha em atenção a orientação do cartão SDHC ao inseri-lo na ranhura até ouvir o som de encaixe. Em seguida, feche a tampa do conector.

● Remover o cartão SDHC

Empurre uma vez o cartão SDHC para o remover.

■ Inserir o dispositivo de memória USB

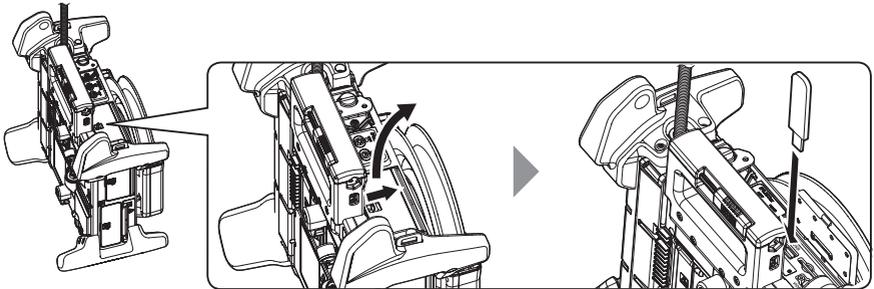

Abra a tampa do conector.

Insira o dispositivo de memória USB tendo em atenção a respetiva orientação.

DICA

Apenas podem ser gravadas imagens fixas no dispositivo de memória USB.

● Remover o dispositivo de memória USB


Segure no dispositivo de memória USB e remova-o.

3-9 Colocar/remover a alça para o ombro


A alça permite carregar facilmente ao ombro a unidade principal.

■ Colocar ao ombro a unidade principal


1



2



3



1

Encaixe os ganchos da alça para o ombro nos dois respectivos suportes.

2

Ajuste o comprimento da alça para o ombro pela fivela de ajuste do comprimento.

3

Coloque a alça ao ombro e segure-a com firmeza com a mão.

● Retirar a alça para o ombro

Para retirar a alça para o ombro, pressione a alavanca do gancho para o remover dos suportes da alça.




Alavanca do gancho

DICA

Encaixe o fio do fixador do endoscópio ao suporte da alça, faça um círculo com o velcro e atravesse o tubo de inserção pelo mesmo.

Restringir o movimento à volta da base do tubo de inserção permite evitar que o tubo de inserção interfira nas observações ou operações do monitor LCD.

Fixador do endoscópio



3-10 Encaixar o conjunto do gancho

Insira o conjunto do gancho a partir do canal do adaptador ótico, tal como descrito abaixo.

ADVERTÊNCIA

Para obter mais informações, consulte as "⚠️ Precauções de segurança – Precauções do conjunto do gancho –" (página 7).

- 1** Desaperte o mandril na abertura do canal de forma a que o conjunto do gancho o possa atravessar.
- 2** Endireite o tubo de inserção do endoscópio tanto quanto possível.
- 3** Insira lentamente a extremidade proximal do conjunto do gancho no canal do adaptador ótico.

NOTA

- Certifique-se de que insere o conjunto do gancho a partir da extremidade distal da unidade endoscópica. Não tente inseri-lo a partir da abertura do canal. Tal poderá danificar a unidade endoscópica e o conjunto do gancho.
- Limpe sujidade, óleo, água ou qualquer outro tipo de substância pegajosa do conjunto de gancho antes de o inserir. Caso contrário, poderá danificar a unidade endoscópica.
- Não force a inserção do conjunto do gancho no canal da unidade endoscópica se encontrar uma forte resistência. Caso contrário, poderá danificar a unidade endoscópica e o conjunto do gancho.

- 4** Insira o conjunto do gancho até que o gancho encoste na extremidade distal da unidade endoscópica na posição retraída.

NOTA

- Não ajuste o ângulo quando o conjunto do gancho está projetado 150 mm ou mais da extremidade distal da unidade endoscópica. Existe o risco de danificar a unidade endoscópica.

- 5** Coloque a tampa de segurança na extremidade proximal do conjunto do gancho.

3-11 Substituir o gancho

O gancho é substituível. Para encaixar o gancho na haste em espiral, siga o procedimento abaixo.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Para obter mais informações, consulte as "⚠️ Precauções de segurança – Precauções do conjunto do gancho–" (página 7).

1 Verifique a rosca na extremidade distal da haste em espiral.

Se os parafusos na extremidade abanarem ou estiverem desalinhados, não utilize a haste em espiral e utilize um novo conjunto do gancho.

Parafuso da extremidade distal




(Utilizável)




(Inutilizável)

2 Ao mesmo tempo que segura a parte A na figura abaixo com um alicate, empurre o gancho diretamente sobre a haste em espiral.

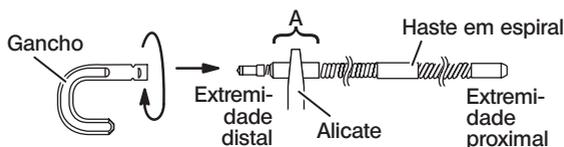

3 Enquanto pressiona o gancho diretamente contra a haste em espiral, rode-o devagar e no sentido dos ponteiros do relógio para o encaixar na haste em espiral. O espaço entre o gancho e a posição limite deve ser entre 0 e 0,2 mm.

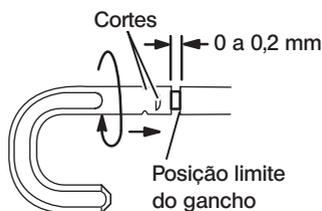


3-12 Substituir a tampa de segurança


⚠️ ADVERTÊNCIA

Para obter mais informações, consulte as "⚠️ Precauções de segurança – Precauções do conjunto do gancho-" (página 7).

- 1 Segurando a alça, puxe com firmeza a tampa de segurança do cabo universal e separe o anel de fixação.

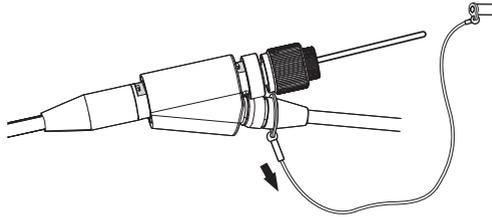


- 2 Abra o anel de fixação na nova tampa de segurança e coloque o cabo universal no encaixe apresentado pelo diagrama seguinte.

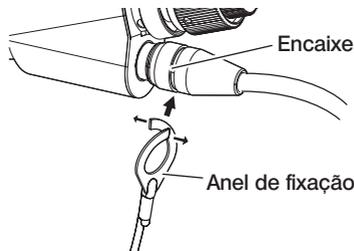

3-13 Utilizar o suporte da pega

Pode ligar a parte deslizante da ferramenta de recolha ao cabo universal da unidade endoscópica, utilizando o suporte da pega.

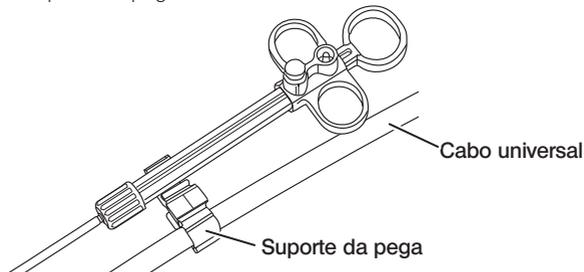


3-14 Utilizar a pega da abertura do canal e o grampo de cinto

Pode segurar de forma estável a abertura do canal e a unidade de controlo remoto com uma mão, utilizando a pega da abertura do canal.


■ Colocar a pega da abertura do canal e a unidade de controlo remoto

- 1** Insira a abertura da pega até à haste em espiral da abertura do canal (seta 1.). Coloque a pega da abertura do canal de forma a não colidir com as saliências da abertura do canal.

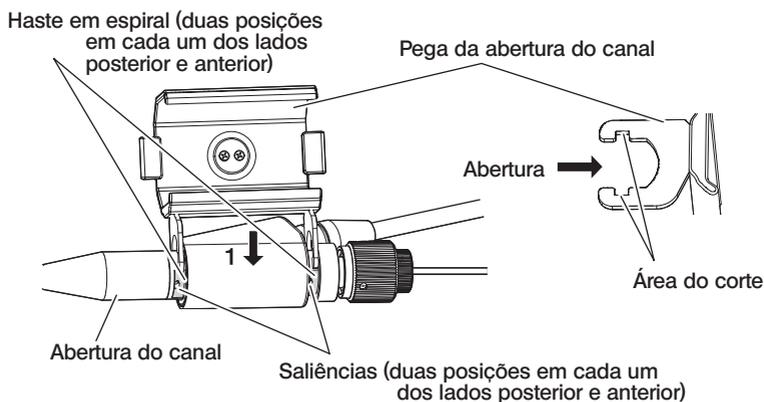


A imagem acima apresenta o caso em que a pega da abertura do canal está colocada no lado direito da abertura do canal.

A pega da abertura do canal pode ser colocada no lado direito ou no lado esquerdo da abertura do canal, tal como apresentado nas imagens abaixo.

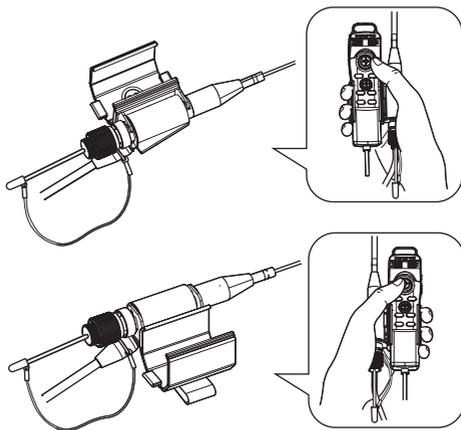


- 2** Deslize a pega da abertura do canal no sentido da seta 2. Isto deve acomodar as saliências na área do corte.
- 3** Rode o anel de bloqueio no sentido da seta 3 para prender a pega da abertura do canal. Confirme se está colocada com firmeza.

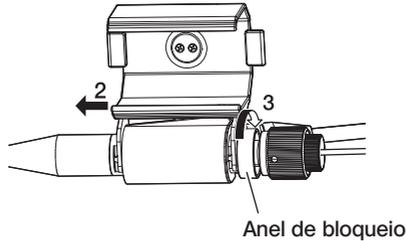**NOTA**

Se a pega da abertura do canal não puder ser colocada ou removida porque não é possível rodar o anel de bloqueio, pare de utilizar o equipamento e contacte a EVIDENT.

- 4** Coloque a unidade de controlo remoto no respetivo suporte da pega da abertura do canal.

A unidade de controlo remoto pode ser colocada em ambas as direções da abertura do canal.

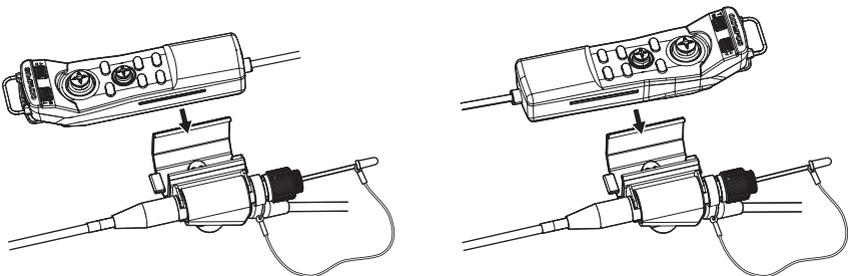


- **Remover a pega da abertura do canal e a unidade de controlo remoto**
Ao remover a unidade de controlo remoto e a pega da abertura do canal, siga a ordem contrária dos passos acima indicados.


Ao utilizar o grampo de cinto, pode fixar à parte lateral do seu corpo a abertura do canal e a unidade de controlo remoto colocadas na pega da abertura do canal.

■ Colocar o grampo de cinto e a pega da abertura do canal


- 1 Encaixe o grampo de cinto num cinto ou calças.



- 2 Empurre o dispositivo de ligação da pega da abertura do canal para dentro do suporte curvo do grampo de cinto, até ouvir o som de encaixe.

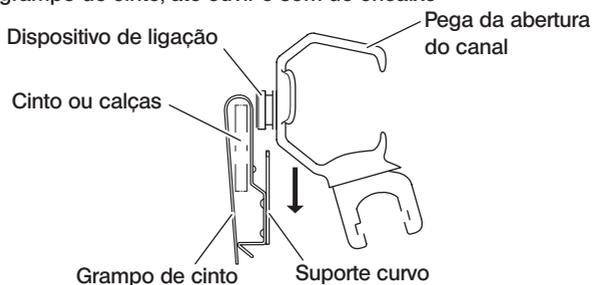

- 3 Confirme se a pega da abertura do canal está colocada com firmeza.



● Remover o grampo de cinto e a pega da abertura do canal


Remova o grampo de cinto e a pega da abertura do canal pela ordem contrária aos procedimentos de colocação.

3-15 Ligar e remover o adaptador LAN sem fios USB

■ Ligar o adaptador LAN sem fios USB

Ligue o adaptador LAN sem fios USB (recomendado) ao conector USB.

Para informações sobre os adaptadores LAN sem fios USB recomendados, contacte a EVIDENT.

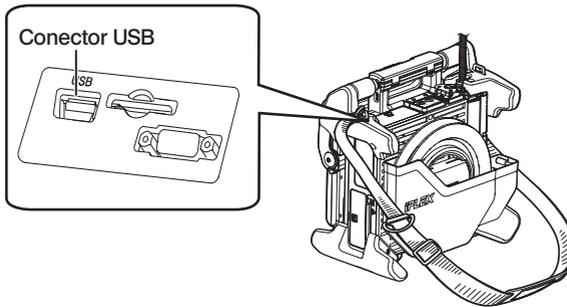

■ Remover o adaptador LAN sem fios USB

Remova o adaptador LAN sem fios USB pela ordem contrária à dos procedimentos de ligação.

3-16 Inspeções prévias/posteriores à operação

NOTA

- Ao inspecionar o tubo de inserção, certifique-se de que o segura num ponto anterior à secção de angulação. Caso contrário, a secção de angulação poderá ser danificada.
- Certifique-se também de que verifica os itens de inspeção depois de utilizar o instrumento.

Local de inspeção	Item	Se for descoberta uma anomalia
Geral	<input type="checkbox"/> Existe alguma substância estranha como sujidade ou areia na unidade de controlo remoto, monitor LCD, tubo de inserção ou tampas do conector?	Consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).
	<input type="checkbox"/> Existe alguma fissura ou risco na unidade de controlo remoto, monitor LCD, tubo de inserção ou tampas do conector?	É necessária a substituição. Contacte a EVIDENT.
	<input type="checkbox"/> Alguma irregularidade como deformações ou danos nos materiais exteriores, botões, joysticks ou alavancas?	
	<input type="checkbox"/> Alguma irregularidade como fissuras ou dobras no cabo do controlo remoto ou do LCD?	
Tubo de inserção/ Secção de angulação/ Extremidade distal	<input type="checkbox"/> Alguma folga nos materiais à exceção da secção de angulação?	Consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).
	<input type="checkbox"/> Alguma sujidade ou gotícula de água na lente da objetiva da extremidade distal? A utilização contínua nestas condições cria o risco de danos no adaptador ótico e/ou na extremidade distal.	
	<input type="checkbox"/> Existe alguma acumulação de sujidade na ranhura de posicionamento do adaptador ótico ou nas roscas da extremidade distal?	
	<input type="checkbox"/> Existe alguma deformação ou folga da extremidade distal ou desgaste atípico da rosca de ligação? Nunca utilize o instrumento se houver qualquer tipo de folga na extremidade distal. Caso contrário, as peças soltas poderão cair.	
Anel de vedação	<input type="checkbox"/> O anel de vedação está em falta, partido etc.? Um anel de vedação desalinhado ou partido pode permitir a entrada de água ou de outro líquido na união entre a extremidade distal e o adaptador ótico, criando o risco de avaria e de danos.	

Local de inspeção	Item	Se for descoberta uma anomalia
Adaptador ótico, adaptador ótico estéreo	<input type="checkbox"/> Alguma sujidade ou gotícula de água na superfície do adaptador ótico e/ou na lente da objetiva no adaptador ótico? A utilização contínua nestas condições cria o risco de danos no adaptador ótico e/ou na extremidade distal.	Consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).
	<input type="checkbox"/> Alguma deformação ou objeto estranho na rosca de ligação do adaptador ótico? Tenha em atenção que uma limpeza insuficiente poderá resultar na perda da estanquidade à água entre o adaptador ótico e a extremidade distal.	
	<input type="checkbox"/> Alguma folga nos componentes do adaptador ótico? Nunca utilize o adaptador ótico se algum dos componentes estiver solto. Caso contrário, as peças soltas poderão cair.	
	<input type="checkbox"/> Verificou os valores de medição antes e depois da medição estéreo? (Apenas medição estéreo)	
Monitor LCD	<input type="checkbox"/> Alguma fissura à superfície ou outro tipo de anomalias no ecrã? <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">DICA</div> <p>O monitor LCD foi fabricado com base em tecnologias de precisão. O monitor LCD poderá conter píxeis que não se iluminam (visíveis como pontos pretos) ou que possuem iluminação permanente (visíveis como pontos brilhantes). Isto não indica um defeito ou avaria do produto.</p>	É necessária a substituição. Contacte a EVIDENT.
	<input type="checkbox"/> Existe alguma impressão digital ou outro tipo de manchas no ecrã?	Consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).
Mala de transporte	<input type="checkbox"/> Existe algum dano, folga ou outro tipo de irregularidades na parte externa, pega, fecho ou outras peças da mala de transporte?	Consulte "10 Armazenamento e manutenção" (página 112).
	<input type="checkbox"/> Está a utilizar a mala de transporte indicada? A utilização de uma mala de transporte não indicada poderá criar um risco de danos ou avarias do tubo de inserção ou da unidade principal.	Contacte a EVIDENT.

Local de inspeção	Item	Se for descoberta uma anomalia
Bateria	<input type="checkbox"/> Existe alguma fuga de líquido, deformação, fissuras ou outro tipo de anomalias na bateria?	Contacte a EVIDENT.
Canal	<input type="checkbox"/> Forte resistência ao conjunto do gancho? A inserção forçada do conjunto do gancho no endoscópio poderá danificar a unidade endoscópica e o conjunto do gancho.	Contacte a EVIDENT.
Abertura do canal	<input type="checkbox"/> Alguma deformação anormal ou objeto estranho no mandril? O mandril roda suavemente para prender ou libertar o conjunto do gancho?	Contacte a EVIDENT.
	<input type="checkbox"/> A tampa de segurança está colocada de forma segura?	Consulte "3-12 Substituir a tampa de segurança" (página 41).
Conjunto do gancho	<input type="checkbox"/> Existe alguma irregularidade como dobras, alongamentos, separações de peças, esmagamentos ou dobras excessivas? A utilização contínua nestas condições poderá danificar o conjunto do gancho ou este poderá cair.	Substitua o conjunto do gancho por um novo.

4 Operações básicas

4-1 LIGAR a alimentação

1 LIGAR a alimentação

Para LIGAR a alimentação, prima o botão [POWER] (⏻) da unidade principal durante aproximadamente um segundo.

Depois de premir o botão [POWER] (⏻) durante aproximadamente um segundo, o indicador [POWER] ilumina-se e a alimentação é ligada.

O ecrã e as operações do menu ficam ativas durante aproximadamente 35 segundos depois de o botão [POWER] (⏻) ter sido premido.

DICA

Se o adaptador ótico estiver colocado, a luz é LIGADA de forma automática.

■ DESLIGAR a alimentação

Prima o botão [POWER] (⏻) da unidade principal durante um ou mais segundos.

Quando o sistema se desliga, o indicador [POWER] da unidade principal e o indicador do botão [ANGLE SEL/CENTER] do monitor LCD são DESLIGADOS de forma automática.

Se estiver a utilizar a unidade de controlo remoto, a iluminação do botão é DESLIGADA de forma automática.

4-2 LIGAR a luz

1 Verificar a luz da iluminação na extremidade distal do tubo de inserção

A intensidade da luz é ajustada em conformidade com a luminosidade do objeto a ser inspecionado.

DICA

- DESLIGUE sempre o botão [LIGHT] (☞) da unidade principal quando o instrumento não estiver a ser utilizado, como durante a substituição do adaptador ótico ou colocação do conjunto do gancho etc.
- A colocação do adaptador ótico irá LIGAR a luz de forma automática. Por sua vez, a remoção do adaptador ótico irá DESLIGAR a luz de forma automática.

■ LIGAR/DESLIGAR a luz de forma manual

Premir o botão [LIGHT] (☞) irá LIGAR ou DESLIGAR a luz.

Enquanto a luz é LIGADA, o indicador [LIGHT] acende-se.

4-3 Operar o instrumento

Este instrumento pode ser operado através do painel tátil, botões e joysticks da unidade LCD e da unidade de controlo remoto (opcional).

Para as operações em que utilizar a unidade LCD e a unidade de controlo remoto, consulte a tabela seguinte.

Painel tátil da unidade LCD	Unidade de controlo remoto	Função
	(Sem botão aplicável)	Apresenta o botão do painel tátil.
	(Sem botão aplicável)	Oculta o botão do painel tátil.
	Botão [MENU]	Apresenta/oculta o ecrã do menu.
	※ toque	Botão [LIVE]
	※ toque contínuo	※ pressão breve
	Botão [LIVE]	Regressa ao ecrã em tempo real.
	※ pressão contínua	Altera o ajuste de brilho entre o modo Auto e o modo Manual.
	Botão [VIEW]	Apresenta a imagem gravada. (Tocar neste botão durante a apresentação do ecrã de visualização irá apresentar o ecrã em tempo real.)
	Botão [THUMBNAIL]	Apresenta o ecrã de miniaturas. (Tocar neste botão durante a apresentação do ecrã de miniaturas irá apresentar o ecrã em tempo real.)
	Botão [SPOT RANGING]	Inicia/sai da função de extensão de ponto. (Tocar neste botão durante a apresentação do ecrã de alcance de ponto irá apresentar o ecrã em tempo real.)
	Joystick [MEAS/ENTER] (Prima o botão.)	Inicia a função de medição estéreo.
 	Alavanca [ZOOM]	Utiliza a função de ampliação.  aumenta a imagem e  reduz a imagem.
 	Alavanca [BRT]	Altera a definição de brilho.  aumenta o nível de brilho e  diminui o nível de brilho.
		Tocar em  no ecrã de miniaturas irá marcar a imagem selecionada e tocar em  irá marcar todas as imagens em miniatura.
	Joystick [MEAS/ENTER] (Prima o botão.)	Determina o menu etc.

Painel tátil da unidade LCD	Unidade de controlo remoto	Função
	Joystick [MEAS/ENTER] (Operação com joystick)	Seleciona o menu ou desloca o cursor. Altera a pasta de destino da gravação da imagem no ecrã em tempo real. Altera a imagem selecionada no ecrã de miniaturas. ◀ apresenta a última imagem e ▶ apresenta a imagem seguinte do ecrã de visualização.

Botões e joystick da unidade LCD	Unidade de controlo remoto	Função
Joystick [ANGLE/LOCK] (Prima o botão.)		Bloqueia a operação de angulação da extremidade distal do tubo de inserção. Premir este botão durante o bloqueio da operação de angulação irá cancelar esse bloqueio.
Joystick [ANGLE/LOCK] (Operação com joystick)		Opera a angulação da extremidade distal do tubo de inserção. Premir este botão durante o bloqueio da operação de angulação irá ajustar o ângulo de forma precisa.
Botão [ROTATE] (Quando a imagem é apresentada numa rotação de 180 graus, o indicador do lado superior do botão é LIGADO.)	(Sem botão aplicável)	Roda a imagem em 180 graus.
Botão [ANGLE SEL/CENTER] ※ pressão breve (Se o joystick [ANGLE/LOCK] da unidade LCD estiver operável, o indicador do lado superior do botão é LIGADO. Se o joystick [ANGLE/LOCK] da unidade de controlo remoto estiver operável, o indicador do lado superior do botão é DESLIGADO.)	(Sem botão aplicável)	Altera a ativação/desativação da operação com o joystick [ANGLE/LOCK] da unidade de controlo remoto.
Botão [ANGLE SEL/CENTER] ※ pressão contínua	Botão [CENT]	Centra a extremidade distal do tubo de inserção.
Botão [RECORD] ※ pressão breve		Grava a imagem fixa.
Botão [RECORD] ※ pressão contínua		Grava o filme.
Botão [FREEZE]		Fixa a imagem da observação. Premir este botão durante a fixação da imagem irá cancelar essa fixação.

DICA

Se forem atribuídas várias ações ao mesmo botão, o tempo de pressão sobre o botão faz a distinção entre cada uma das funções. Neste manual, os termos "pressão" ou "pressão curta" são utilizados para indicar uma pressão sobre o botão de curta duração, enquanto "pressão contínua" significa premir o botão durante aproximadamente um segundo.

A partir deste ponto, as descrições deste manual de instruções pressupõem que o instrumento é operado com a unidade LCD.

4-4 Observar o objeto a inspecionar

1 **LIGUE a iluminação.**

2 **Enquanto observa o ecrã, insira o tubo de inserção no objeto a inspecionar.**

Insira cuidadosamente o tubo de inserção ao mesmo tempo que verifica a direção da inserção.

3 **Utilize o joystick [ANGLE/LOCK] para realizar as operações de angulação e observe as áreas aplicáveis no ecrã.**

Tenha o cuidado de não forçar, torcer ou tensionar excessivamente o tubo de inserção.

4 **Bloqueie o ângulo e a direção da secção de angulação (bloqueio de angulação) e realize as observações.**

Quando a secção de angulação estiver definida na direção e ângulo desejados, pressione o joystick [ANGLE/ LOCK].

O ângulo pode ser ajustado de forma precisa mesmo que a angulação esteja bloqueada.

Quando a angulação está bloqueada, o ícone de bloqueio de ângulo  é apresentado no canto superior direito do monitor LCD.

Se necessário, ajuste e grave a imagem.

5 **Enquanto observa o ecrã, retire de forma lenta e cuidadosa o tubo de inserção do objeto a inspecionar.**

Se a angulação estiver bloqueada, pressione o joystick [ANGLE/LOCK] para desbloquear a angulação e, em seguida, retire o tubo de inserção.

NOTA

- **Se aparecer a seguinte mensagem enquanto inspeciona, pare imediatamente a observação, retire cuidadosamente o tubo de inserção e realize as ações necessárias, tal como indicado em “1 Mensagens de erro” (página 107).**
<HIGH TEMPERATURE (DISTAL END). PLEASE IMMEDIATELY PULL OUT THE INSERTION TUBE.>
- **Ao operar a secção de angulação, não dobre o tubo de inserção para o seu raio de dobragem mínimo ou inferior (20 mm para o modelo de 4 mm, 30 mm para o modelo de 6 mm e de 6,2 mm).**

DICA

- Aumentar o arqueamento (dobra) diminui o limite máximo do ângulo de angulação da secção de angulação. Mantenha o tubo de inserção tão reto quanto possível para obter o melhor desempenho do instrumento.
- O ângulo de angulação é tendencialmente difícil de alcançar a baixas temperaturas.
- O ruído da imagem poderá ser perceptível em temperaturas ambiente elevadas.
- O indicador amarelo de temperatura da extremidade distal é apresentado quando a temperatura ambiente da extremidade distal atinge aproximadamente os 80 °C. Tenha em atenção que isto indica que está prestes a ser atingido o limite superior da temperatura ambiente de funcionamento.
- O tubo de inserção contém linhas indicadoras para que possa ser conhecido o comprimento inserido no objeto a inspecionar.

4-5 Retirar a unidade endoscópica

Retire o dedo do joystick [ANGLE] e observe cuidadosamente à medida que retira a unidade endoscópica.


■ Resolução do problema do gancho estar preso

Projete o conjunto do gancho do canal do adaptador ótico e rode o conjunto do gancho para desengatar o gancho. Caso continue a não ser possível proceder à remoção, retire o gancho da haste em espiral de acordo com o seguinte procedimento.

NOTA

Ao retirar o gancho, a unidade endoscópica poderá ser danificada. Este procedimento deverá ser realizado apenas em último recurso para retirar um gancho que esteja preso. Qualquer dano provocado por este procedimento não está coberto pela garantia e as reparações são da responsabilidade do proprietário.

- 1 Aperte com firmeza o mandril da abertura do canal para fixar de forma segura o conjunto do gancho.
- 2 Depois de manter retos o tubo de inserção e a abertura do canal, puxe devagar e com firmeza a abertura do canal.
O gancho irá cair da haste em espiral.

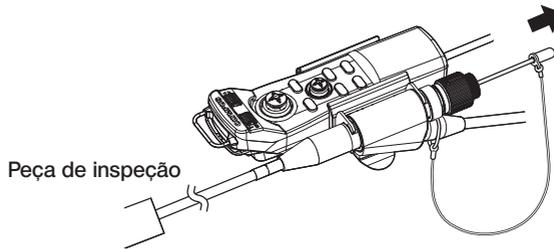

- 3 Depois de o gancho ter sido retirado, não retraia a extremidade distal da haste em espiral para dentro do canal. Retire cuidadosamente a unidade endoscópica com a extremidade distal da haste em espiral visível e dentro do campo de visão.

DICA

Quando o gancho quebra na parte dos cortes e cai, uma porção do gancho partido continua presa na haste em espiral. Remova a parte restante rodando a haste em espiral no sentido oposto ao que foi utilizado para encaixar o gancho na haste em espiral.

Tal como mencionado em "3-11 Substituir o gancho" (página 40), segure a extremidade distal da haste em espiral com um alicate. Tendo o cuidado de não arranhar a rosca da haste em espiral, segure cuidadosamente a parte restante do gancho com outro alicate e rode. A parte restante pode ser facilmente removida.

4-6 Ajustar a apresentação da imagem

1 Imagem fixa (Fixação)

1 Enquanto é apresentada uma imagem ao vivo, prima o botão [FREEZE].

A imagem observada é fixada e o ícone de fixação () é apresentado no canto superior direito do monitor LCD. Não insira nem puxe o tubo de inserção enquanto a imagem estiver fixada.

2 Toque no botão [LIVE] ou prima o botão [FREEZE].

A imagem deixa de estar fixada.

DICA

Fixar uma imagem que contém uma ação de elevada velocidade poderá resultar numa imagem desfocada.

2 Ampliar a imagem (Zoom)

A imagem apresentada pode ser ampliada para uma vista alargada do objeto a observar.

TOCAR NO BOTÃO PARA CIMA DO BOTÃO [ZOOM]  irá ampliar (zoom) a imagem até cinco vezes. Para voltar ao tamanho original da imagem, toque no botão para baixo do botão [ZOOM].

DICA

- As imagens são ampliadas utilizando a função de ampliação digital. Por esta razão, a imagem poderá ter uma resolução ligeiramente menor em ampliações maiores.
- A função de ampliação não está disponível durante a extensão de ponto. Tocar no botão [ZOOM] durante a extensão de ponto irá alterar a posição de medição da distância do objeto.

Para obter mais informações, consulte "■ Posição de medição da distância do objeto" (página 86).

3 Ajustar o brilho

■ Ajustar a intensidade da luz com o botão [BRT]

O botão [BRT] é utilizado para ajustar o brilho ao alterar o brilho geral da imagem em tempo real durante a observação.

Tocar no botão [BRT] para cima ilumina a imagem em geral e tocar no botão para baixo escurece-a.

● Modo de exposição longa

Durante a apresentação de uma imagem em tempo real, pode passar para o modo de exposição longa definindo o [BRT] (nível de brilho) para o Nível 10. Esta função é eficaz na apresentação de um nível de brilho superior ao normal, ao visualizar um objeto bastante escuro etc. No entanto, a imagem poderá ficar desfocada em certas condições de observação.

■ Modo manual

No modo Manual, o brilho é fixo independentemente das condições da imagem da observação. Se seleccionar este modo para observar a imagem que contém movimento e contraste significativo, uma vez que o brilho não é alterado, consegue observar com nitidez a imagem.

1 Toque continuamente no botão [LIVE] enquanto é apresentada uma imagem ao vivo.

É seleccionado o modo Manual e o ícone Manual (M) é apresentado no canto superior direito do monitor LCD.

2 Toque continuamente no botão [LIVE].

O modo Manual é cancelado.

4-7 Alterar a pasta no ecrã em tempo real


DICA

Podem criar uma pasta para gravação e reprodução da imagem. Para obter mais informações, consulte "1 Menu de operações em ficheiros/pastas" (página 77).

No ecrã em tempo real, pode utilizar o botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶) para alterar a pasta de gravação e reprodução da imagem.

1 Durante a apresentação de uma imagem em tempo real, toque no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶).

O nome da pasta apresentado no canto superior esquerdo do ecrã irá alterar-se.

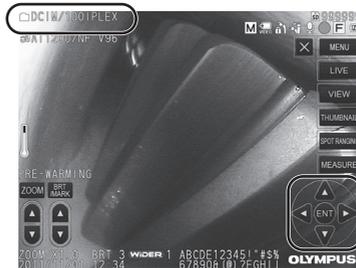

A pasta apresentada será aquela em que a imagem será gravada ou reproduzida.

DICA

A configuração de pastas que pode ser alterada com o botão para cima/baixo/esquerda/direita

(▲▼◀▶) estende-se até ao segundo nível.

4-8 Gravar imagens

As imagens a serem observadas podem ser gravadas em suporte de gravação de imagens (cartão SDHC) como imagens fixas ou filmes.

DICA

Apenas podem ser gravadas imagens fixas no dispositivo de memória USB.

Utilize o cartão SDHC fornecido ou o cartão SDHC recomendado.

Utilize o dispositivo de memória USB recomendado.

Certifique-se de o suporte de gravação de imagens está corretamente colocado antes de o utilizar.

1 Preparar gravação de imagens

Antes de utilizar o suporte de gravação de imagens, proceda à sua formatação através deste instrumento. Para obter mais informações acerca da formatação, consulte "MEDIA FORMAT" (página 69).

A tabela seguinte apresenta o tamanho de uma única imagem e o número aproximado de imagens que podem ser gravadas num cartão SDHC.

Formato de gravação/ Duração da gravação		Tamanho aproxima- do de uma única imagem	Capacidade aproximada para imagens/Tempo de gravação (4 GB)
Imagem fixa	Modelo de 6 mm	750 KB	5400 imagens
	Modelo de 4 mm	420 KB	9600 imagens
	Modelo de 6,2 mm	420 KB	9600 imagens
	PAL	420 KB	9600 imagens
	NTSC	300 KB	13 400 imagens
Filme (por seg.)		500 KB	100 minutos
Áudio (por seg.)		16 KB	-

As definições para a gravação de imagens devem ser configuradas utilizando <menu operations>. Consulte "5-1 Operações do menu" (página 66) e "5-2 Utilizar o ecrã ao vivo/ecrã de fixação" (página 68).

DICA

Se estiver seleccionado <OFF> no menu <STILL AUDIO>, o diálogo de confirmação da gravação de som não é apresentado.

■ Gravar a informação apresentada na imagem

Para gravar a data/hora, título, logótipo, resultados de medição e outras informações apresentadas no ecrã na imagem fixa, toque no botão [MENU] no ecrã em tempo real para apresentar o menu, selecione «RECORD MODE» - «PRINT SCREEN ON/OFF» e selecione «ON» (Consulte a página 69).

DICA

A reprodução da imagem fixa que contém data, título e outras informações gravadas na mesma poderá resultar numa sobreposição da data, hora, título, logótipo e outro texto. Isto não é uma anomalia.

■ Marcas do ficheiro

Selecionar «ON» no menu «FILE NAME MARK» ativa as seguintes funções ao gravar imagens.

- Função para seleccionar as pastas de destino das gravações.
- Função para seleccionar as marcas do ficheiro que serão adicionadas ao final dos nomes dos ficheiros.
- Função para seleccionar títulos.

Para ativar «FILE NAME MARK», toque no botão [MENU] no ecrã ao vivo para ser apresentado o menu, selecione «RECORD MODE» - «FILE NAME MARK» e selecione «ON» (Consulte a página 69).

■ Nomes dos ficheiros de imagem

Os nomes dos ficheiros que utilizam os nomes das pastas de destino da gravação são atribuídos às imagens e estas são gravadas na pasta de destino da gravação no cartão SDHC. Pode alterar o nome do ficheiro para o nome que desejar (até 30 caracteres alfanuméricos e símbolos).

Nome da pasta de destino da gravação_?????.***

Extensão

“.JPG” para ficheiros com imagens fixas, “.WAV” para ficheiros de som e “.AVI” para ficheiros de filme.

Número de série do nome do ficheiro com 5 dígitos

O número de série do nome do ficheiro é atribuído de forma sequencial de 00001 a 99999.

DICA

- Se estiver seleccionado «ON» no menu «FILE NAME MARK», pode adicionar a letra “_A”, “_B”, “_C” ou “_D” no final dos nomes dos ficheiros de imagem. Utilize esta função para categorizar os ficheiros de imagem.
- Os nomes da categoria das marcas do ficheiro podem ser alterados. (Contacte a EVIDENT para obter mais informações.)

2 Gravar a imagem fixa

1 **Selecione a pasta de destino da gravação.**

Toque no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶) para selecionar a pasta de destino da gravação (consulte a página 55).

2 **Durante a apresentação da imagem em tempo real, prima o botão [FREEZE].**

A imagem é fixada.

3 **Durante a apresentação da imagem fixada, prima brevemente o botão [RECORD].**

É apresentado o nome da pasta de destino da gravação.

4 **Confirme o nome da pasta e selecione <YES>.**

Se pretende alterar a pasta, selecione <MODIFY> e altere a pasta de destino da gravação.



5 **Selecione a marca a adicionar ao final do nome do ficheiro da imagem que está a gravar.**



6 Selecione as cadeias na lista de títulos predefinidos previamente registada.



DICA

Para saber como registar previamente títulos predefinidos, consulte "3 Registering a text string as a preset title" (página 73).

7 A imagem fixa é gravada. O ecrã fica a preto durante um momento e, em seguida, é apresentada a imagem fixada.

8 Depois de a imagem fixa ter sido gravada, é apresentada a caixa de diálogo de confirmação da gravação de som.

9 Selecione «YES».

É iniciada a gravação de som. O ícone do microfone pisca no monitor LCD enquanto a gravação de som estiver em curso. Se selecionar «NO» na caixa de diálogo de confirmação da gravação de som, apenas é gravada a imagem fixa e o som não é gravado.

10 Prima o botão [RECORD] para sair da gravação de som.

DICA

- Se estiver selecionado «OFF» no menu «FILE NAME MARK», os passos 4 a 6 são ignorados.
- Se estiver selecionado «OFF» no menu «STILL AUDIO», os passos 8 a 10 são ignorados.
- Ao premir brevemente o botão [RECORD] durante a apresentação da imagem em tempo real irá gravar a imagem fixa.
- Nunca tente inserir ou remover o suporte de gravação de imagens enquanto a gravação de dados estiver em curso. Caso contrário, a gravação é interrompida e é apresentada uma mensagem de erro no ecrã.
- A gravação de som é automaticamente interrompida quando o suporte de gravação de imagens ficar cheio.
- Em alguns casos, as imagens fixas gravadas podem ser medidas. Para obter mais informações, consulte "6-5 Medição" (página 87).
- A gravação de som está disponível para um minuto.

3 Gravar o filme

1 Seleccione a pasta de destino da gravação.

Toque no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶) para seleccionar a pasta de destino da gravação (consulte a página 55).

2 Durante a apresentação da imagem em tempo real, prima continuamente o botão [RECORD].

É apresentado o nome da pasta de destino da gravação.

3 Confirme o nome da pasta e seleccione <YES>.

Se pretender alterar a pasta, seleccione <MODIFY>, altere a pasta de destino da gravação e seleccione <YES>.



4 Seleccione a marca a adicionar ao final do nome do ficheiro da imagem que está a gravar.



5 Seleccione as cadeias na lista de títulos predefinidos previamente registada.



6 Depois de a imagem fixa ter sido gravada, é apresentado o diálogo de confirmação da gravação de filme.

7 Seleccione «YES».

É iniciada a gravação do filme e de som. O ícone de círculo vermelho pisca no monitor LCD enquanto a gravação do filme estiver em curso. Se seleccionar «NO» na caixa de diálogo de confirmação da gravação de filme, apenas é gravada a imagem fixa e o filme não é gravado. Se seleccionar «CONTINUE» na caixa de diálogo de confirmação da gravação de filme, o filme é adicionado ao último filme gravado. Para obter mais informações, consulte “4 Juntar o filme”.

8 Prima o botão [RECORD] para sair da gravação de filme.

O ícone de círculo vermelho deixa de piscar quando a gravação do filme é concluída.

DICA

- Se estiver seleccionado «OFF» no menu «FILE NAME MARK», os passos 3 a 5 são ignorados.
- Nunca tente inserir ou remover o cartão SDHC enquanto a gravação de dados estiver em curso. Caso contrário, a gravação é interrompida e é apresentada uma mensagem de erro no ecrã.
- A gravação do filme é automaticamente interrompida quando o cartão SDHC ficar cheio ou quando o tamanho do ficheiro atingir 4 GB. Um cartão SDHC de 4 GB vazio tem capacidade suficiente para gravar aproximadamente 90 minutos.

4 Juntar o filme


Podem juntar o filme ao último filme gravado.

Selecionar «CONTINUE» na caixa de diálogo de confirmação da gravação de filme permite adicionar o filme ao último filme gravado. Se o cartão SDHC for inserido ou removido, o botão [VIEW] ou [THUMBNAIL] for tocado ou a pasta for alterada entre a pasta de gravação de imagens e a pasta de reprodução, não é possível seleccionar «CONTINUE».

4-9 Reproduzir a imagem

As imagens gravadas podem ser apresentadas utilizando dois tipos de visualização de ecrã: uma visualização de ecrã inteiro de uma única imagem (ecrã de visualização) ou uma visualização de várias imagens em miniatura (ecrã de miniaturas).

O ecrã de miniaturas apresenta várias imagens de uma só vez, sendo útil quando se pretende encontrar uma imagem específica entre um grande grupo de imagens.

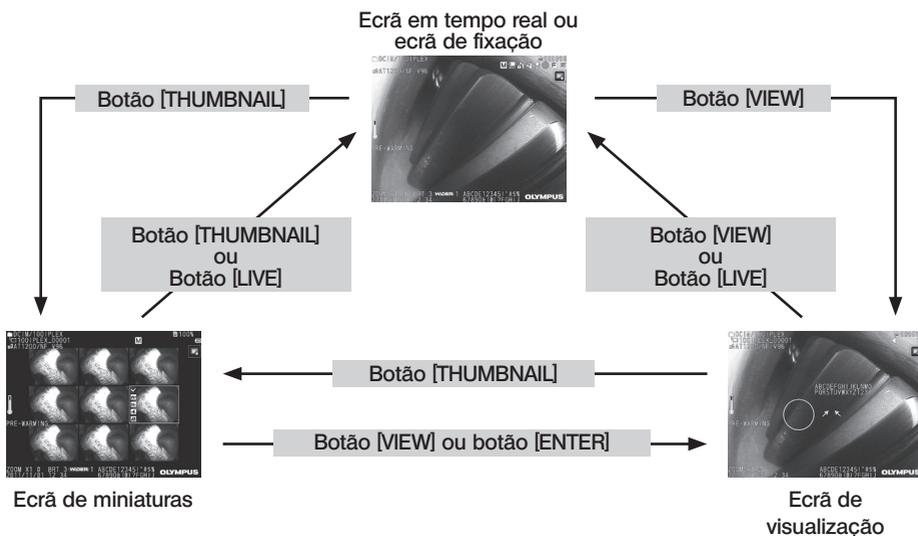

1

Reproduzir a imagem numa visualização de ecrã inteiro (ecrã de visualização)

1

Selecione a pasta de destino da gravação.

Consulte “4-7 Alterar a pasta no ecrã em tempo real” (página 55) para obter mais informações acerca das operações.

2

Toque no botão [VIEW] no ecrã ao vivo ou no ecrã de fixação.

A imagem gravada é apresentada numa visualização de ecrã inteiro.

3

Altere a imagem que pretende reproduzir.

Toque no botão de deslocação para a esquerda/direita (◀▶) para alterar a imagem a reproduzir.

- Toque no botão de deslocação (◀).

Isto permite percorrer as imagens da atual imagem apresentada para a imagem cronologicamente anterior.

Ao ordenar imagens por ordem descendente, depois de a última imagem ter sido apresentada, esta operação apresentará novamente a primeira imagem.

- Toque no botão de deslocação (▶).

Isto permite percorrer as imagens da atual imagem apresentada para a imagem cronologicamente posterior.

Ao ordenar as imagens por ordem ascendente, depois de a última imagem ter sido apresentada, esta operação apresentará novamente a primeira imagem.

4

Amplie a imagem.

zoom



Toque no botão para cima do botão [ZOOM] para ampliar (zoom) a imagem até cinco vezes. Para voltar ao tamanho original da imagem, toque no botão para baixo do botão [ZOOM].

5

Toque no botão [VIEW] ou no botão [LIVE] para regressar ao ecrã em tempo real.

DICA

A imagem fixa gravada em «BINOCULAR IMAGE» utilizando o NX pode ser medida depois de a imagem ter sido gravada. Para obter mais informações acerca das medições, consulte “6 Função de medição estéreo” (página 79).

2

Ver o ecrã de miniaturas e selecionar a imagem a reproduzir

O ecrã de miniaturas apresenta várias imagens fixas e filmes gravados num único ecrã (nove imagens por ecrã).

O ecrã de miniaturas é útil quando se pretende encontrar uma imagem específica entre um grande grupo de imagens ou ao selecionar várias imagens para as mover e eliminar de uma só vez.

1

Selecione a pasta de destino da gravação.

Consulte “4-7 Alterar a pasta no ecrã em tempo real” (página 55) para obter mais informações acerca das operações.

2

Toque no botão [THUMBNAIL] no ecrã em tempo real, no ecrã de fixação ou no ecrã de visualização.

É apresentada uma visualização de várias imagens gravadas (até nove imagens por ecrã).

O ícone de filme  é apresentado para filmes.

O ícone de som  é apresentado para imagens que contêm som.

O ícone de nota  é apresentado para imagens que contêm notas informativas (texto/símbolo).

O ícone de medição  é apresentado para imagens medidas.

■ Para seleccionar uma imagem em miniatura

Toque no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶) para mover o enquadramento. A imagem enquadrada é a imagem a ser seleccionada.

■ Para reproduzir uma imagem

Selecione a imagem a reproduzir e toque no botão [ENTER] ou toque na imagem a ser reproduzir. A imagem seleccionada é reproduzida numa visualização de ecrã inteiro.

■ Para seleccionar ou cancelar a seleção de uma imagem

Toque na caixa de verificação no canto superior esquerdo da imagem em miniatura para ser apresentada uma marca de verificação (✓) no canto superior esquerdo da imagem em miniatura. Ou selecione uma imagem com o botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶) e, em

BRT



seguida, toque no botão para cima do botão [BRT] para ser apresentada uma marca de verificação (✓) no canto superior esquerdo da imagem em miniatura.

Realizar o mesmo procedimento quando já existe uma marca de verificação apresentada (✓) no canto superior esquerdo da imagem em miniatura irá cancelar a marca (✓).

■ Para seleccionar ou cancelar a seleção de todas as imagens em miniatura

Tocar no botão para baixo do botão [BRT] irá apresentar um sinal de visto (✓) no canto superior esquerdo de todas as imagens em miniatura.

Para cancelar as marcas (✓) em todas as imagens em miniatura, toque novamente no botão para baixo do botão [BRT].

■ Para mover ou eliminar a imagem seleccionada

É apresentada uma de verificação (✓) no canto superior esquerdo da imagem em miniatura. Repita este passo em todas as imagens que deseja seleccionar e utilize as operações do menu para as mover ou eliminar.

3 Toque no botão [THUMBNAIL] ou no botão [LIVE] para regressar ao ecrã ao vivo.

3 Som anexado à imagem fixa


Quando o ecrã de visualização é apresentado, o som é reproduzido.

4 Reproduzir e colocar em pausa o filme

- Tocar no botão [ENTER] durante a reprodução do filme irá colocá-lo em pausa.
- Tocar no botão para a esquerda (direita) (◀ ▶) durante a pausa irá apresentar a imagem fixa antes (após) um segundo e tocar no botão para cima (baixo) (▲ ▼) irá apresentar a imagem fixa antes (após) um minuto.
- Tocar no botão [ENTER] durante a pausa irá retomar a reprodução do filme.
- Premir o botão [RECORD] durante a pausa irá gravar a imagem parada como uma imagem fixa.

4-10 Apresentar imagens ao vivo no monitor externo

Ligar o cabo VGA (disponível no mercado) ao terminal de vídeo na parte superior da unidade principal irá apresentar a imagem em tempo real no monitor externo (disponível no mercado).

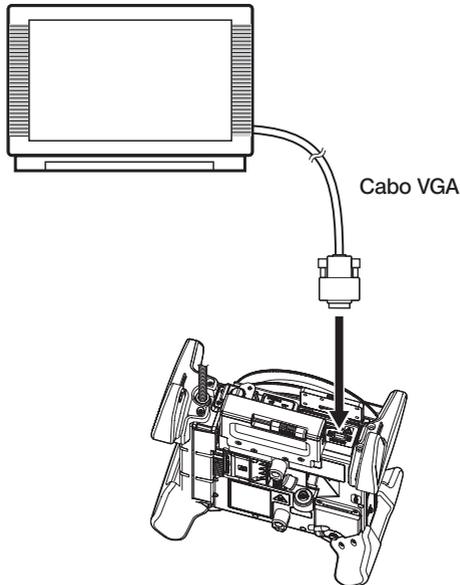

4-11 Utilizar as imagens gravadas num PC

As imagens gravadas com este instrumento podem ser utilizadas no PC através do InHelp VIEWER.

As imagens gravadas são carregadas diretamente no PC a partir do cartão SDHC ou do dispositivo de memória USB que as contém.

Para utilizar o software InHelp VIEWER, transfira-o a partir do site da EVIDENT (<http://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/>).

5 Operações de menu e funções

5-1 Operações do menu

Este instrumento pode ser operado através da unidade de controlo remoto e do painel tátil.

■ Utilizar o painel tátil


Ao operar este instrumento através do painel tátil, toque nos ícones no ecrã.



São apresentados os ícones de operação.




Touchar no botão voltar (↶) durante as operações de menu irá regressar ao ecrã anterior.
Touchar no botão fechar (✕) durante as operações de menu irá regressar ao ecrã anterior à apresentação do menu.

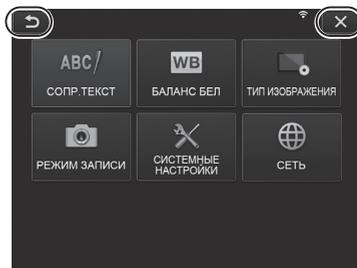

■ Utilizar a unidade de controlo remoto

- 1** Prima o botão [MENU].
É apresentado o ecrã do menu.



- 2** Opere o joystick [MEAS/ENTER] para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para selecionar o item de menu que deseja executar.




- 3** Prima o joystick [MEAS/ENTER] para aplicar as definições e regressar ao ecrã anterior.



5-2 Utilizar o ecrã ao vivo/ecrã de fixação

1 Menu de definições iniciais

Ao LIGAR a alimentação deste instrumento é apresentado o ecrã em tempo real. Tocar no botão [MENU] no ecrã em tempo real e/ou no ecrã de fixação permite configurar as seguintes definições.

Menu principal	Menu secundário	Item
<TITLE> 	-	Introduz um título. Coloca um título no ecrã em tempo real e nas imagens gravadas. Podem ser introduzidos até 30 caracteres. Consulte "2 Introduzir um título" (página 71).
<WHITE BALANCE> 	-	Ajusta o balanço de brancos (apenas no ecrã em tempo real). Especifica se o balanço de brancos é ou não ajustado. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL> : Não ajustar. • <EXECUTE> : Ajustar. Ao substituir peças como o adaptador ótico, ajuste o balanço de brancos captando uma imagem de um objeto branco, como uma folha de papel, a uma distância entre 50 e 60 mm.
<IMAGE MODE> 	<SHARPNESS> 	Ajusta a nitidez de uma imagem O nível de nitidez aumenta da esquerda para a direita (4 níveis). Consulte "4 Ajustar a nitidez da imagem" (página 74).
	<SATURATION> 	Ajusta a cor da imagem <ul style="list-style-type: none"> • <MONOTONE> : Apresenta a imagem em modo monocromático. • <NATURAL> : Apresenta a imagem padrão observada. • <VIVID> : Acentua a totalidade da imagem. Consulte "5 Ajustar a saturação da imagem" (página 74).
	<WIDER> 	Ativa a função WIDER. O nível pode ser definido entre <OFF>, <WIDER1> e <WIDER2>. O nível aumenta pela ordem de <OFF>, <WIDER1> e <WIDER2>.
	<NOISE REDUCTION> 	Reduz o ruído da imagem. O nível do efeito aumenta pela ordem de <OFF>, <LOW>, <MEDIUM> e <HIGH>. <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">DICA</div> Se definir <NOISE REDUCTION> para <HIGH>, poderá demorar vários segundos a concluir a fixação.

Menu principal	Menu secundário	Item
<IMAGE MODE> 	<STEREO ADAPTER IMAGE DISPLAY MODE> 	Seleciona o ecrã em <MONOCULAR IMAGE> ou <BINOCULAR IMAGE>. Define se a imagem em tempo real deve apresentar uma visualização monocular ou binocular quando é colocado o adaptador ótico estéreo. <ul style="list-style-type: none"> • <MONOCULAR IMAGE>: Apresenta a imagem numa visualização monocular (um ecrã) • <BINOCULAR IMAGE>: Apresenta a imagem numa visualização binocular (dois ecrãs)
	<GRID> 	Apresenta uma grelha no ecrã. A apresentação da grelha pode ser definida entre <OFF> e três tipos de grelha. A grelha é apresentada no ecrã em tempo real.
	<STEREO ADAPTER SELECT> 	Apresenta a lista do adaptador ótico estéreo. A seleção do adaptador ótico irá definir o adaptador ótico estéreo ligado ao sistema.
<RECORD MODE> 	<PRINT SCREEN> 	Grava dados de texto e gráficos sobre as imagens fixas ou filmes. Alterna entre a gravação de dados de texto e gráficos sobre imagens fixas ou filmes.
	<FILE NAME MARK> 	Especifica a adição de marcas aos nomes dos ficheiros de imagem fixa ou filme. <ul style="list-style-type: none"> • <OFF>: A marca não é colocada. • <ON> : A marca é colocada. Pode seleccionar a marca a adicionar durante a gravação da imagem. As marcas podem ser definidas entre "None, _A, _B, _C e _D".
	<STILL AUDIO> 	Alterna entre a gravação ou não do som ao gravar a imagem. A gravação de som pode ser definida entre <ON> e <OFF>. Se for selecionado <ON>, é apresentado o diálogo de confirmação da gravação de som ao gravar a imagem fixa.
	<MEDIA> 	Seleciona o suporte de gravação e reprodução. Pode ser selecionado o cartão SDHC ou o dispositivo de memória USB.
	<MEDIA FORMAT> 	Faz a formatação do suporte (cartão SDHC ou dispositivo de memória USB) atualmente selecionado.

Menu principal	Menu secundário	Item
<SYSTEM SETUP> 	<DISPLAY> 	Seleciona se a informação no ecrã é apresentada ou ocultada.
	<AUDIO VOLUME> 	Especifica o volume de som. Ajusta a emissão do volume de som de acordo com o volume de som especificado. O volume de som pode ser definido entre <OFF>, <LOW>, <MEDIUM> e <HIGH> (4 níveis).
	<BEEP> 	Define a emissão do som de operação (sinal sonoro). O sinal sonoro pode ser definido entre <ON> e <OFF>.
	<VIDEO IN> 	Especifica o modo de entrada de imagem para o próximo arranque. O modo de entrada pode ser definido entre <OFF>, <NTSC> ou <PAL>.
	<DATE TIME> 	Especifica a data e a hora.
	<LANGUAGE> 	Especifica o idioma de apresentação. Seleciona o idioma utilizado em menus e mensagens. É suportado o inglês e outros idiomas. A predefinição é [ENGLISH].
	<VERSION> 	Apresenta a versão do software.
	<FINE MODE SPEED> 	Especifica a velocidade de angulação para o bloqueio de angulação. A velocidade de angulação pode ser definida entre <SLOW>, <STANDARD> e <FAST> (3 níveis).
<NETWORK> 	<WIRELESS> 	Especifica a comunicação sem fios. Ativa a comunicação sem fios. Especifica e seleciona o ponto de acesso.
	<TRANSFER AS RECORDING> 	Especifica a transferência como gravação. DESLIGADO: Desativa a transferência como gravação. LIGADO: Ativa a transferência como gravação. Ativar esta definição permite-lhe carregar fotografias para o servidor na nuvem em conjunto com a operação de gravação.
	<DEVICE AUTHENTICATION> 	Especifica a autenticação do dispositivo. Introduza o código PIN para processar a autenticação do dispositivo.

2 Introduzir um título

Existem dois métodos que podem ser utilizados para introduzir um título e que são apresentados abaixo.

- Introduzir texto através do teclado no ecrã
- Selecionar um título predefinido para introdução

■ Introduzir texto através do teclado no ecrã



1 Seleccione o modo de introdução.

2 Seleccione os botões de texto que deseja.

O texto selecionado é apresentado na caixa de introdução de títulos. Se necessário, edite o texto.

● Para eliminar os textos

- Para eliminar uma linha de texto, desloque o cursor até à mesma e seleccione <DELETE>.
- Para eliminar todos os textos introduzidos, seleccione <CLEAR>.

● Para introduzir um espaço

Desloque o cursor para onde pretende introduzir o espaço e seleccione <SPACE>.

3 Seleccione <EXECUTE>.

O título que introduziu é apresentado no ecrã em real/de fixação.

■ Selecionar um título predefinido para introdução

Com este procedimento, pode selecionar uma cadeia predefinida de caracteres e utilizá-la para introduzir um título.



1 Seleccione «PRESET».

É apresentada uma lista de títulos predefinidos. Para cancelar a seleção de títulos predefinidos, toque no botão fechar (X) para fechar o ecrã.

2 Seleccione as cadeias a partir da lista de títulos predefinidos.

A cadeia de texto que selecionou é apresentada na caixa de introdução de títulos e a lista é fechada.

Repita os passos 1 e 2 para concluir a introdução do título.

DICA

A lista de títulos predefinidos tem nove páginas. Para mudar de página, seleccione a cadeia de texto na linha 1 ou na linha 6 da página apresentada e, em seguida, toque no botão para cima ou para baixo.

3 Seleccione «EXECUTE».

O título que selecionou é apresentado no ecrã em tempo real/de fixação.

3 Registrar uma cadeia de texto como título predefinido

Depois de registar as cadeias de texto frequentemente utilizadas como títulos predefinidos, pode recuperá-las ao introduzir títulos. Pode registar um máximo de 54 cadeias de texto como títulos predefinidos.



1 Introduza a cadeia de texto que pretende registar na caixa de introdução de títulos. Para obter mais informações acerca da introdução, consulte “2 Introduzir um título” (página 71).

2 Seleccione «ENTRY».

É apresentada uma lista de títulos predefinidos.

Para cancelar o registo de títulos predefinidos, toque no botão de fechar (X) para fechar o ecrã.

DICA

A lista de títulos predefinidos tem nove páginas. Para mudar de página, seleccione a cadeia de texto na linha 1 ou na linha 6 da página apresentada e, em seguida, toque no botão para cima ou para baixo.

3 Seleccione a linha para registo da cadeia de texto.

A cadeia de texto que introduzir na caixa de introdução de títulos é registada como título predefinido.

Registar um título predefinido substitui tudo o que estiver na linha especificada da lista. Isto significa que pode eliminar um título predefinido desempenhando a operação de registo enquanto a caixa de introdução de títulos estiver em branco.

O ecrã da lista de títulos predefinidos é fechado.

4 Ajustar a nitidez da imagem

A nitidez do fotograma da imagem pode ser acentuada.

⟨IMAGE MODE⟩ - ⟨SHARPNESS⟩



Tocar no botão irá alterar o nível de nitidez do fotograma.
Quando conseguir a nitidez desejada, toque no botão fechar (X).

5 Ajustar a saturação da imagem

A saturação da imagem pode ser ajustada.

⟨IMAGE MODE⟩ - ⟨SATURATION⟩




Tocar no botão irá alterar o nível de saturação.
Quando conseguir a saturação pretendida, toque no botão fechar (X).

6 Definir data e hora

Utilize o procedimento abaixo para especificar a data e a hora.

«SYSTEM SETUP» - «DATE TIME»



Certifique-se de que define a data e hora corretas antes de utilizar o instrumento pela primeira vez. A informação da data e hora é registada na impressão do ecrã juntamente com a informação do ecrã. A gravação de dados é igualmente desempenhada de acordo com a informação da data e hora.

7 IDIOMA

Utilize o procedimento abaixo para seleccionar o idioma dos menus e das mensagens de erro no ecrã.

«SYSTEM SETUP» - «LANGUAGE»



DICA

O idioma inicial está definido como inglês. Se necessário, altere para o idioma pretendido.

8

VELOCIDADE DO MODO PRECISO

Especifica a velocidade de angulação para o bloqueio de angulação.

«SYSTEM SETUP» - «FINE MODE SPEED»




Selecione «SLOW», «STANDARD» ou «FAST».

5-3 Utilizar os ecrãs de miniaturas/visualização

1 Menu de operações em ficheiros/pastas

O menu apresentado no ecrã de miniaturas pode ser utilizado para as seguintes definições.


Menu	Definições disponíveis
<DELETE> 	Elimina a imagem gravada. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL> : Não elimina a imagem. • <EXECUTE> : Elimina a imagem. No ecrã de miniaturas, a imagem atualmente selecionada ou todas as imagens com uma marca de verificação (✓) serão eliminadas.
<MOVE FILE> 	Move os ficheiros de imagem para pastas (apenas no ecrã de miniaturas). As imagens gravadas podem ser movidas para uma pasta diferente. A imagem atualmente selecionada ou todas as imagens com uma marca de verificação (✓) no ecrã de miniaturas serão movidas.
<RENAME FILE> 	Muda o nome do ficheiro de imagem (apenas no ecrã de miniaturas). Pode alterar o nome do ficheiro de uma imagem gravada (até 30 letras).
<CHANGE FOLDER> 	Altera uma pasta para gravação e reprodução de imagens (apenas no ecrã de miniaturas). Pode alterar uma pasta para gravação e reprodução de imagens, tocando na pasta. A predefinição é [DCIM\100IPLEX]. Pode alternar a cor do nome da pasta entre branco e verde ao tocar continuamente sobre a pasta. A predefinição é [White]. Para saber como alterar a cor, consulte a página 78.
<MAKE FOLDER> 	Cria uma nova pasta para gravação e reprodução de imagens. Pode criar uma pasta para gravação e reprodução de imagens.
<RENAME FOLDER> 	Muda o nome de uma pasta para gravação e reprodução de imagens. Pode mudar o nome de uma pasta para gravação e reprodução de imagens.

DICA

Pode utilizar caracteres alfanuméricos e símbolos nos nomes de ficheiros e pastas. Alguns símbolos não podem ser utilizados nos nomes de ficheiros e pastas.

DICA

A cor do nome da pasta no primeiro nível é alterada em conjunto com a do segundo nível da seguinte forma. Por exemplo, a cor do nome da pasta pode indicar se a imagem foi obtida ou não.

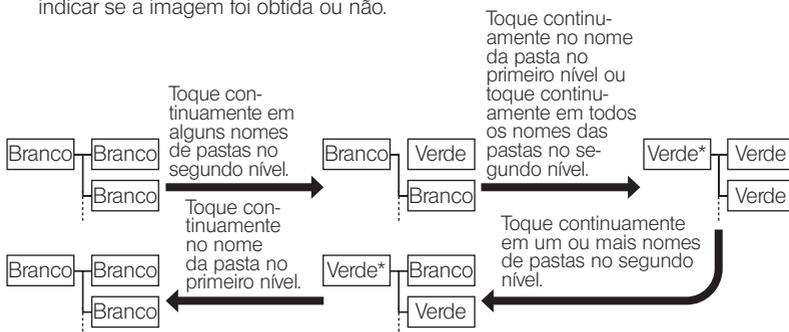

* A cor do nome da pasta no primeiro nível pode ser alterada de verde para branco com apenas um toque contínuo no nome da pasta no primeiro nível. (Não é alterada em conjunto com a alteração da cor do nome da pasta no segundo nível.)

O menu apresentado no ecrã de visualização (apenas no ecrã de visualização de imagens fixas) pode ser utilizado para as seguintes definições.

Menu	Definições disponíveis
<DELETE> 	Elimina a imagem gravada. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL> : Não elimina a imagem. • <EXECUTE> : Elimina a imagem. No ecrã de visualização, a imagem apresentada será eliminada.
<NOTE> 	Introduz a nota informativa (textos/símbolos) na posição pretendida no ecrã. Pode introduzir a nota informativa (textos/símbolos) tocando na imagem fixa que está a ser reproduzida ou tocando no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶).
<COMPARE> 	Apresenta o ecrã de comparação. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL> : Volta ao ecrã de visualização. • <EXECUTE> : Apresenta o ecrã de comparação. Para ocultar o ecrã de comparação, toque no botão [MENU].
<GHOST> 	Apresenta o ecrã fantasma. <ul style="list-style-type: none"> • <CANCEL> : Volta ao ecrã de visualização. • <EXECUTE> : Apresenta o ecrã fantasma. Para ocultar o ecrã fantasma, toque no botão [MENU].

6 Função de medição estéreo

As coordenadas 3D de cada ponto especificado são calculadas aplicando os princípios de triangulação a um conjunto de imagens obtido por duas lentes objetivas em paralaxe. As medições são realizadas com base nestas coordenadas.

Como os resultados obtidos pelas medições são afetados pelas condições da superfície do objeto medido ou pelas condições de captação de imagens como a luminosidade, a EVIDENT não pode garantir a precisão dos resultados das medições. É recomendado que os utilizadores identifiquem a precisão das medições através de experiências.

Este método de medição utiliza as imagens esquerda e direita obtidas por duas lentes objetivas em paralaxe e identifica os pontos correspondentes na imagem da direita localizada nas mesmas posições que os pontos de medição e de referência especificados na imagem da esquerda. Se a posição de um ponto correspondente for deslocada de um ponto de medição ou de referência, não poderá ser obtido um resultado correto de medição. Neste caso, corrija a posição do ponto (consulte **■ Modificar o ponto** (página 93)). Em alternativa, altere o ponto de visualização movendo a ponta do endoscópio para efetuar a medição.

Esta função de medição estéreo permite seleccionar o modo de apresentação da imagem ao vivo entre <MONOCULAR IMAGE> e <BINOCULAR IMAGE>.

O <MONOCULAR IMAGE> é um modo de apresentação para observar facilmente a abordagem à área de medição no ecrã.

A unidade endoscópica estéreo (opcional) é necessária para a medição estéreo.

6-1 Fluxo de medições

São apresentados em seguida os procedimentos de medição e fluxo dos ecrãs.

Colocar o adaptador ótico estéreo (Consulte a página 81)

Verificar o número de série da unidade endoscópica estéreo, o nome abreviado e o número de série do adaptador ótico estéreo (Consulte a página 14 ou 20)


Verificar os valores de medição (antes da medição) (Consulte a página 82)*

Captar a área de medição (Consulte a página 84)

Ecrã em tempo real

Observar a área de medição


(Para saber como selecionar «MONOCULAR IMAGE» ou «BINOCULAR IMAGE» do ecrã em tempo real, consulte a página 69.)

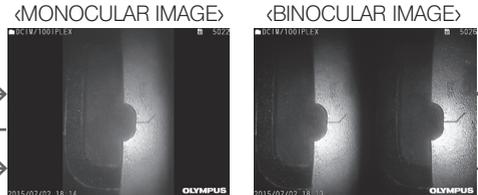

[SPOT RANGING]

Ecrã de extensão do ponto

Verifique a distância para a área de medição antes da medição.



[LIVE]
[SPOT RANGING]

[LIVE]
[SPOT RANGING]

[MEASURE]

Medição (Consulte a página 87)

Ecrã de medição

Faça a medição do comprimento ou da área.



[MEASURE]
[MENU] - «EXIT MEASUREMENT»
[LIVE]

[MEASURE]
[MENU] - «EXIT MEASUREMENT»
[LIVE]


Verificar os valores de medição (após a medição) (Consulte a página 82)*

* Certifique-se de que os valores de medição obtidos ao "Verificar os valores de medição (antes da medição)" e ao "Verificar os valores de medição (após a medição)" são praticamente idênticos. Se os valores de medição diferirem, verifique se o adaptador ótico estéreo não está solto nem a lente suja e, se necessário, realize novamente a medição.

6-2 Colocar o adaptador óptico estéreo

Consulte também “3-16 Inspeções prévias/posteriores à operação” (página 46) para obter mais informações acerca da colocação dos adaptadores óticos estéreos.

- 1** **Certifique-se de que o anel de vedação na extremidade distal está colocado corretamente.** Consulte “3-5 Colocar e remover o adaptador ótico” (página 33) para obter mais informações sobre a verificação do anel de vedação.
- 2** **Coloque o adaptador de forma a que não haja qualquer movimento do corpo principal do adaptador ótico estéreo.** Rode o adaptador ótico estéreo no sentido da seta A apresentada na figura. Mantenha o adaptador ótico estéreo rodado completamente e rode a porca do adaptador ótico estéreo no sentido da seta B apresentada na figura até ficar apertada.

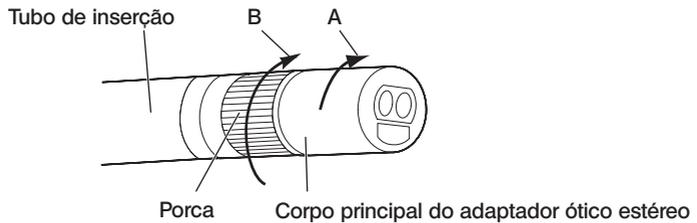

NOTA

- Ao segurar o adaptador ótico estéreo à extremidade distal, não utilize ferramentas nem aperte com força excessiva.
- Certifique-se de que o adaptador ótico estéreo está colocado corretamente, não está solto nem contém sujidade e partículas de pó.
- Se o adaptador ótico estéreo colocado vibrar ou estiver solto, ou mesmo que não vibre nem esteja solto, se não estiver colocado com firmeza, sendo rodado no sentido da seta A apresentada na imagem, a precisão da medição deteriora-se.
- Se depois de o adaptador ótico estéreo estar colocado a extremidade distal for manuseada agarrando o adaptador ótico estéreo, o mesmo pode rodar no sentido oposto da seta A na imagem, mesmo que a porca esteja apertada de forma segura. Isto pode resultar na deterioração da precisão da medição. Ao manusear a extremidade distal, não a segure pelo adaptador ótico estéreo, mas agarre sempre o tubo de inserção. No entanto, não o segure pela secção de angulação.
- Quando a extremidade distal do tubo de inserção é sujeita a uma grande vibração ou força exterior, a instalação do adaptador ótico estéreo poderá ser sacudida, rodada ou ficar solta. Mesmo que deixe o adaptador ótico estéreo colocado no tubo de inserção, verifique sempre as condições de instalação antes de inserir o tubo de inserção na área de medição da observação.

DICA

Quando o adaptador ótico estéreo é colocado no instrumento, é reconhecido automaticamente e é apresentado o diálogo de confirmação do adaptador ótico.



N.º de série do adaptador ótico estéreo


N.º de série da unidade endoscópica estéreo

Verifique se o n.º de série do adaptador ótico estéreo colocado é consistente com o n.º de série da unidade endoscópica e toque em «YES». Se o adaptador ótico estéreo não for reconhecido automaticamente, pode utilizar o menu «STEREO ADAPTER SELECT» para o reconhecer manualmente. (Consulte a página 69)


6-3 Verificar os valores de medição

A precisão da medição poderá ser degradada pela colocação solta do adaptador ótico estéreo ou de sujidade nos componentes da lente. Utilize a ferramenta de verificação para confirmar os valores anteriores e posteriores à medição.


- 1 Insira até ao final a extremidade distal do tubo de inserção no orifício do adaptador ótico estéreo da ferramenta de verificação.

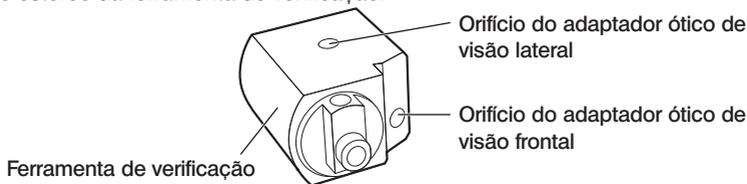

- 2 Rode a ferramenta de verificação de forma a obter uma imagem semelhante à apresentada na imagem abaixo.



Adaptador ótico de vista frontal



Adaptador ótico de vista lateral

- 3** Durante a apresentação da imagem em tempo real, toque no botão [SPOT RANGING].

É apresentado o ecrã de extensão do ponto.

- 4** Enquanto a extremidade distal do tubo de inserção é inserida até ao final do orifício do adaptador ótico estéreo para a ferramenta de verificação, confirme se a distância é de 15 mm ou inferior na caixa de apresentação da distância do objeto e toque no botão [MEASURE].

É apresentado o ecrã de seleção do método de medição.

- 5** Toque em «Distance».

É apresentado o ecrã de medição.

- 6** Toque na área da imagem à esquerda ou no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶) para deslocar o cursor. E toque no botão [ENTER] para especificar os pontos de medição. (2 pontos)

- 7** Prima o botão [RECORD].


É gravada a imagem medida.

- 8** Confirme se os valores anteriores e posteriores à medição estão ambos dentro do seguinte intervalo de erro a partir do valor padrão (2 mm ou 0,1 polegadas).

- Modelo de 6 mm: $\pm 1\%$ ou inferior
- Modelo de 4 mm e modelo de 6,2 mm: $\pm 2\%$ ou inferior

Se o intervalo de erro exceder o valor acima, coloque novamente o adaptador ótico estéreo (consulte “6-2 Colocar o adaptador ótico estéreo” (página 81)) e, em seguida, certifique-se de que o adaptador ótico estéreo não está solto nem a lente suja e verifique novamente os valores de medição. Se o intervalo de erro continuar a exceder o valor acima após ter verificado algumas vezes os valores de medição, contacte a EVIDENT.

Além disso, se os valores anteriores e posteriores à medição diferirem significativamente, inspecione dessa mesma forma o adaptador e, se necessário, verifique novamente os valores de medição.

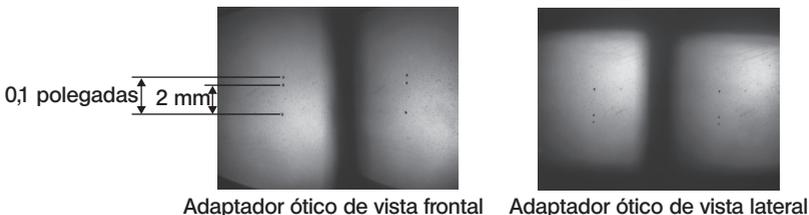

DICA


Se o adaptador ótico estéreo estiver solto, certifique-se de que o anel de vedação não foi retirado (consulte “3-5 Colocar e remover o adaptador ótico” (página 33)).

6-4 Observar a área de medição

Observe a área de medição e verifique se a imagem é adequada para medição. Utilize a extensão do ponto para confirmar se a distância entre a extremidade distal do adaptador óptico estereó e a área de medição é adequada.

1 Observar a área de medição no ecrã ao vivo

Observe a área de medição definindo o seu modo de apresentação favorito para «MONOCULAR IMAGE» ou «BINOCULAR IMAGE».

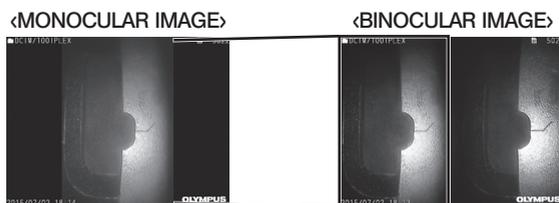

Consulte também “4-4 Observar o objeto a inspecionar” (página 52) para obter mais informações acerca da observação da área de medição.

DICA

- Caso a área de medição apresente repetições, reflita facilmente ou tenha poucos padrões, altere a direção ou a distância da captação de imagens.
- No caso de existirem reflexos ou sombras na área de medição, mova ou rode a posição do tubo de inserção para alterar a direção ou a distância da captação de imagens.



Utilize também o botão [BRT] para colocar a imagem ligeiramente mais escura.

- Para alterar o modo de apresentação, consulte a página “5-2 Utilizar o ecrã ao vivo/ ecrã de fixação” (página 68).
- Restrição de «MONOCULAR IMAGE»
É apenas apresentada a imagem esquerda de «BINOCULAR IMAGE».
- Restrição de «BINOCULAR IMAGE»
A função de ampliação não está disponível.
- A posição das imagens esquerda e direita poderão estar desalinhas em alguma direção ou ângulo, dependendo da colocação do adaptador óptico estereó e do tubo de inserção. No entanto, isto não é uma anomalia nem afeta a precisão da medição.



Alteração da imagem: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita



Rodada

2 Medir a distância para a área de medição através da extensão do ponto

A extensão do ponto mede a distância entre a extremidade distal do adaptador ótico estereó e a área de medição no ecrã em tempo real e no ecrã de fixação.

Durante a apresentação do ecrã em tempo real ou do ecrã de fixação, toque no botão [SPOT RANGING].

É apresentado o ecrã de extensão do ponto.

DICA

- A extensão do ponto não está disponível durante a gravação do filme.
- A imagem em tempo real no ecrã de extensão do ponto é apenas apresentada em «BINOCULAR IMAGE».
- Se for premido o botão [FREEZE] no ecrã de extensão do ponto na visualização ao vivo, o ecrã de extensão do ponto é fixado.
- Restrição durante a extensão do ponto

A função de ampliação não está disponível. Se tocar no botão [ZOOM] durante a extensão do ponto, a posição de medição da distância do objeto é alterada. Para obter mais informações, consulte "■ Posição de medição da distância do objeto" (página 86).

■ Ecrã de extensão do ponto

Meça a distância do objeto na posição do cursor na área da imagem à esquerda.

O indicador de distância do objeto apresenta a distância entre a extremidade distal do adaptador ótico estereó e a área de medição em nove níveis.

Até 10 mm :	■
Até 20 mm :	■ ■
Até 30 mm :	■ ■ ■
Até 40 mm :	■ ■ ■ ■
Até 50 mm :	■ ■ ■ ■ ■
Até 60 mm :	■ ■ ■ ■ ■ ■
Até 70 mm :	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Até 80 mm :	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
80 mm ou mais :	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

↑ Verde ↑ Ama-
 relo
 ↑ Ver-
 mel-
 ho



■ Posição de medição da distância do objeto

Apresenta o círculo que centra a posição do cursor na área da imagem à esquerda. Pode também confirmar a distância do objeto através dos pontos para cima/baixo/esquerda/direita da posição do cursor (no círculo).



Se tocar no botão para cima do botão [ZOOM] , pode aumentar o círculo até 3 níveis e alterar a posição de medição. Para regressar à posição de medição original, toque no botão para baixo do botão [ZOOM].

■ Deslocar o cursor

Toque na posição para a qual pretende deslocar o cursor na área da imagem à esquerda. Tocar no botão para cima/baixo/esquerda/direita (   ) desloca a posição do cursor de forma gradual.

Um toque contínuo no botão de deslocação move continuamente a posição do cursor.

■ Iniciar a medição

Toque no botão [MEASURE]. É apresentado o ecrã de medição.

DICA

Enquanto verifica a distância para a área de medição utilizando a função de extensão do ponto, aproxime-se da área de medição até à distância de medição recomendada. Geralmente, quanto mais próximo estiver o objeto medido, mais precisa será a medição.

■ Terminar a extensão do ponto

Toque no botão [MENU], no botão [LIVE] ou no botão [SPOT RANGING] para ser apresentado o ecrã em tempo real ou o ecrã de fixação.

Toque no botão [VIEW] para ser apresentado o ecrã de visualização.

Toque no botão [THUMBNAIL] para ser apresentado o ecrã de miniaturas.

6-5 Medição

1 Medição

- 1** Durante a apresentação do ecrã de extensão do ponto, o ecrã em tempo real/de fixação ou o ecrã de visualização (imagem gravada em «BINOCULAR IMAGE»), toque no botão [MEASURE].

É apresentado o ecrã de seleção do método de medição.

DICA

- Obtenha várias imagens com diferentes pontos de vista e faça a medição das mesmas.
- Certifique-se de que a área de medição não está desfocada na imagem obtida.
- Se a imagem estiver a ser ampliada no ecrã de visualização, a medição não está disponível.
- As imagens fixas obtidas através de PRINT SCREEN não podem ser medidas.
- As imagens fixas obtidas através de dispositivos de entrada externa não podem ser medidas.
- As imagens fixas gravadas em «MONOCULAR IMAGE» não podem ser medidas.

- 2** Seleccione um método de medição.

Selecione o método de medição para ser apresentado o ecrã de medição.

- 3** Especifique os pontos de medição ou de referência e confirme os pontos correspondentes.

Especifique os pontos de medição ou de referência na área da imagem à esquerda.

Os pontos correspondentes (pontos na área da imagem à direita que correspondem aos pontos de medição ou de referência especificados na área da imagem à esquerda) são apresentados na área da imagem à direita.

Confirme se as posições dos pontos de medição ou de referência (na área da imagem à esquerda) são as mesmas posições dos pontos correspondentes (na área da imagem à direita).

- 4** Grave os resultados da medição.

Prima o botão [RECORD] para gravar a imagem com os resultados da medição.

- 5** Saia da medição.

Toque no botão [LIVE] para ser apresentado o diálogo de confirmação de saída da medição. E selecione «YES» para sair da medição estéreo. Selecione «NO» para regressar ao ecrã de medição.


Ou selecione «EXIT MEASUREMENT» no ecrã do menu de medição e selecione «EXECUTE» para sair da medição estéreo e regressar ao ecrã anterior à medição estéreo ser ativada. Selecione «CANCEL» para regressar ao ecrã de medição.

■ Verificar os valores de medição

Os valores de medição devem ser verificados antes e depois da medição.

Consulte “6-3 Verificar os valores de medição” (página 82) para obter mais informações acerca das operações.

■ Explicação do ecrã de medição

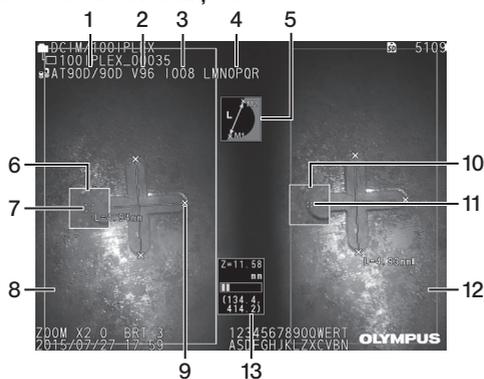

N.º	Item
1	Abreviatura do produto
2	Diâmetro do endoscópio
3	N.º de série do adaptador ótico estéreo
4	N.º de série da unidade endoscópica estéreo
5	Ícone do método de medição
6	Janela de ampliação do cursor Apresenta uma imagem ampliada à volta do ponto especificado.
7	Cursor Especifica um ponto de medição ou de referência.
8	Área da imagem à esquerda
9	Ponto Indica um ponto de medição ou de referência especificado.
10	Janela de ampliação do ponto correspondente Apresenta uma imagem ampliada à volta do ponto correspondente.
11	Ponto correspondente
12	Área da imagem à direita São apresentados os três resultados de medição mais recentes. A marca da distância do objeto (■) (consulte “■ Ecrã de extensão do ponto” (página 85)) indicando a distância do objeto para o ponto de medição é apresentada no lado direito do valor de medição.
13	Caixa de apresentação da distância do objeto É apresentada a distância entre a extremidade distal do tubo de inserção e a posição do cursor. A marca da distância do objeto (■) (consulte “■ Ecrã de extensão do ponto” (página 85)) é apresentada.

■ Apresentação do menu e funções

Quando toca no botão [MENU] no ecrã de medição.




Menu	Definições disponíveis
<CLEAR> 	Elimina o último ponto de medição ou de referência especificado.
<ALL CLEAR> 	Elimina todos os pontos de medição e de referência especificados.
<MODIFY> 	Modifica os pontos de medição ou de referência (área da imagem à esquerda) ou pontos correspondentes (área da imagem à direita).
<METHOD> 	Seleciona um método de medição. Consulte "3 Measurement method types" (página 90) para obter mais informações acerca das operações.
<3D OPTION> 	Seleciona uma visualização 2D ou 3D. Consulte "5 <3D OPTION>" (página 94) para obter mais informações acerca das operações.
<UNIT> 	Seleciona a unidade dos resultados da medição. Seleciona <mm> ou <inch>.
<CURSOR> 	Seleciona a forma do cursor. Seleciona [x], [←] ou [+]. No ecrã de extensão do ponto, o cursor é apresentado como [x].
<EXIT MEASUREMENT> 	Sai do ecrã da medição estéreo. A apresentação regressa ao ecrã anterior ao início da medição estéreo.

3 Tipos de método de medição

O ecrã de seleção do método de medição é apresentado imediatamente após iniciar a medição estéreo ou quando seleciona «METHOD» no ecrã do menu de medição. Estão disponíveis os seguintes quatro métodos de medição.

■ «Distance»

Este modo permite a medição da distância entre dois pontos de medição especificados. Coloque o cursor nas duas extremidades da área de medição que pretende medir e toque no botão [ENTER] para especificar os pontos de medição.

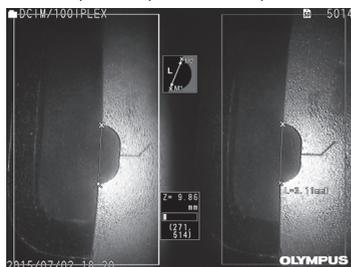


«Distance»




■ «Point to Line»

Este modo permite não só a medição da distância entre um ponto de medição e a linha de referência especificada por dois pontos de referência como também a apresentação da linha de desvio paralela à linha de referência que atravessa o ponto de medição.

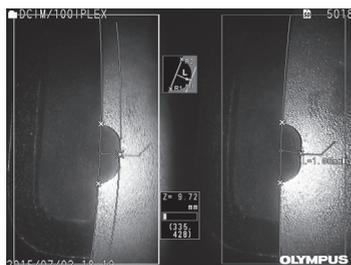

«Point to Line»

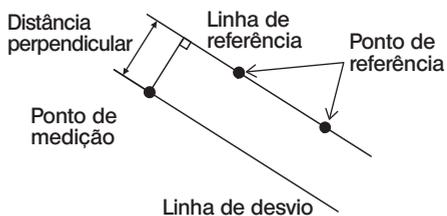


■ <Depth>

Este modo permite a medição da distância entre o ponto de medição e o plano de referência especificado por três pontos de referência. Indica a profundidade e a altitude.

A altitude é indicada por um valor positivo e a profundidade por um valor negativo.



<Depth>

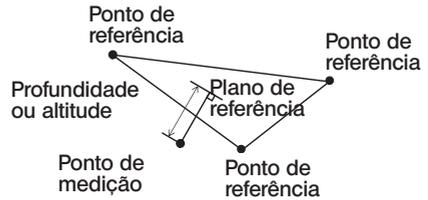


■ <Area/Lines>

Este modo permite a medição do comprimento total de várias linhas, cada uma das quais especificada por dois pontos de medição. Quando a especificação do último ponto de medição resulta no cruzamento entre a primeira linha e a última linha desenhadas, a área da figura dentro das linhas será medida. No entanto, tenha em atenção que a área medida não indica a área precisa do alvo de medição; é apenas um valor aproximado que foi obtido pela divisão da figura em triângulos. Podem ser especificados até 20 pontos de medição por sessão de medição.



<Area/Lines>

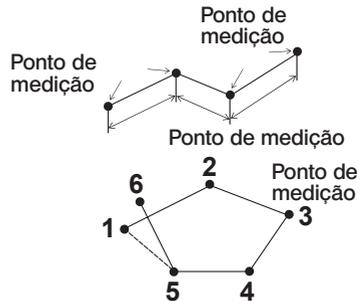

■ Especificar e deslocar os pontos de medição

Toque na posição para a qual pretende deslocar o cursor na área da imagem à esquerda. Tocando no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶) desloca a posição do cursor de forma gradual.

Um toque contínuo no botão de deslocação move continuamente a posição do cursor. A distância do objeto medida na posição do cursor (distância entre a extremidade distal do adaptador ótico estéreo e a área de medição) e os resultados de medição são sempre apresentados.

Tenha em atenção que a distância do objeto que apresentar <- - - mm>, indica que o ponto de referência correto não foi obtido de forma automática.

■ Apresentar a ampliação

Se tocar no botão para cima do botão [ZOOM]  durante a medição estéreo, a imagem à volta da posição atual do cursor e a imagem em redor do ponto correspondente serão apresentadas respetivamente na janela de ampliação do cursor e na janela de ampliação do ponto correspondente.

Se tocar na área da imagem à esquerda durante a apresentação da janela de ampliação do cursor ou tocar no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶), a imagem da ampliação será movida e poderá especificar a posição do cursor.

Para alterar a ampliação, toque no botão [ZOOM] . Pode definir uma ampliação de 2X, 3X ou 4X. Tocando no botão para cima irá aumentar a ampliação e tocar no botão para baixo irá diminuí-la.

Tocando no botão para baixo quando a ampliação está definida para 2X fará com que a janela de ampliação do cursor e a janela de ampliação do ponto correspondente desapareçam.

■ Especificar novamente os pontos de medição ou de referência

Se por engano forem especificados pontos de medição ou de referência incorretos, selecione <CLEAR> no menu de medição.

■ Medir novamente

Caso pretenda reiniciar a medição da imagem, selecione <ALL CLEAR> no menu de medição para eliminar todos os pontos de medição e de referência.


■ Modificar o ponto

Para corrigir a posição dos pontos de medição ou de referência (área da imagem à esquerda) ou dos pontos correspondentes (área da imagem à direita), selecione «MODIFY» no menu de medição.

Toque em «LEFT IMAGE» para corrigir os pontos de medição ou de referência ou toque em «RIGHT IMAGE» para corrigir os pontos correspondentes.

Em seguida, selecione um ponto para ser corrigido tocando no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶) e no botão [ENTER] para efetuar a correção.

Em seguida, desloque o ponto tocando no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲▼◀▶) e no botão [ENTER] para fixar a posição. Se tocar no botão [MENU] antes de tocar no botão [ENTER], a correção é cancelada.

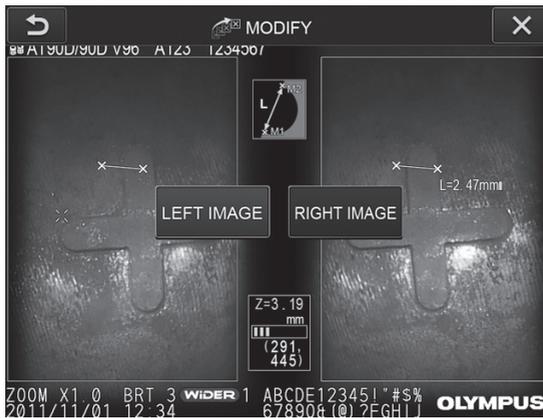

Menu «MODIFY»

5

〈3D OPTION〉

O objeto a medir pode ser apresentado em 3D.

Selecione [3D option] no ecrã do menu de medição e selecione o modo de visualização 〈2D/2D〉, 〈2D/3D〉, 〈3D〉, 〈2D/3D (color map)〉 e 〈3D (color map)〉.

DICA

Se o modo de visualização for 〈3D〉 ou 〈3D (color map)〉, não poderá especificar os pontos de medição ou de referência. A marca da distância do objeto  (consulte "■ Ecrã de extensão do ponto" (página 85)) indicando a distância do objeto para o ponto de medição é apresentada no lado direito do valor de medição.

■ Operar numa área de visualização 3D

Algumas funções são alternadas entre a unidade LCD e a unidade de controlo remoto. Para obter mais informações, consulte a tabela abaixo.


Painel tátil da unidade LCD		Unidade de controlo remoto	Função
	※ toque contínuo	Botão [MENU] ※ pressão contínua	Apresenta/oculta o eixo de coordenadas (eixo X (vermelho), eixo Y (verde), eixo Z (azul)).
	※ toque contínuo	Botão [LIVE] ※ pressão contínua	A visualização da imagem 3D regressa ao estado original.
	※ toque	Botão [SPOT RANGING] ※ pressão breve	Altera a direção de visualização da imagem 3D pela ordem do eixo X, eixo Y e eixo Z.
	※ toque contínuo	Botão [SPOT RANGING] ※ pressão contínua	A função do botão [ZOOM] altera entre a ampliação/redução da imagem e a operação da visualização do perfil transversal.*
		Alavanca [ZOOM]	Ampliação/redução.  aumenta a imagem e  reduz a imagem. Na operação da visualização do perfil transversal,  desloca o perfil transversal de frente para trás e  de trás para a frente.

* Na operação da visualização do perfil transversal, é apresentado o ícone da visualização do perfil transversal  no canto superior direito do monitor LCD.

Painel tátil da unidade LCD		Unidade de controle remoto	Função
	※ toque	Joystick [MEAS/ENTER] ※ pressão breve	Alterna entre o movimento rotacional e paralelo.
	※ toque contínuo	Joystick [MEAS/ENTER] ※ pressão contínua	Altera o objeto para operação na visualização binocular para visualização 2D (área da imagem à esquerda) ou visualização 3D (área da imagem à direita).
		Joystick [MEAS/ENTER] (Operação com joystick)	Roda a visualização 3D ou desloca-a em paralelo.

■ Visualização do mapa a cores

A distância para o objeto a medir é apresentada a cores com a extremidade distal do adaptador ótico estéreo como referência. Se o plano de referência for especificado no modo de profundidade, a profundidade (altura) com o plano de referência especificado como referência é apresentada a cores.

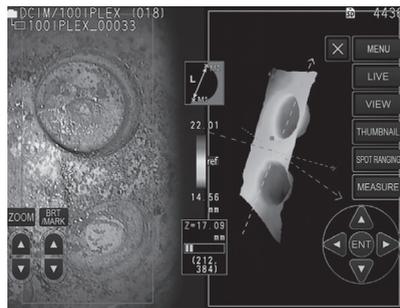

As marcas seguintes são apresentadas na posição mais próxima (menos profunda) e na posição mais afastada (mais profunda) na visualização 3D.

Marca	Extremidade distal como referência	Plano de referência especificado como referência
▲	Posição mais próxima	Posição menos profunda
▼	Posição mais afastada	Posição mais profunda

DICA

Os valores indicados na tabela de cores e nas posições ▲▼ no mapa de cores servem apenas de referência. Para obter valores precisos, consulte “6-5 Medição” (página 87).

7 Função de medição de escala

A medição de escala mede o comprimento de um objeto utilizando o valor de referência do comprimento que foi predefinido de acordo com um comprimento conhecido no interior da imagem de observação.

NOTA

Por outras palavras, não poderá ser obtida uma medição precisa se o valor de referência estiver incorreto. Além disso, a medição é realizada com base no pressuposto de que o objeto de referência e o objeto a medir estão no mesmo plano vertical que o eixo ótico.

7-1 Fluxo de medições

São apresentados em seguida os procedimentos de medição e fluxo dos ecrãs.

Colocar o adaptador ótico (Consulte a página 97)



Captar a área de medição (Consulte a página 97)

Ecrã em tempo real

Observar a área de medição.



Medição (Consulte a página 98)

Ecrã de medição

Proceda à medição do comprimento.

[MEASURE]

[MENU] - <EXIT
MEASUREMENT>
[LIVE]



7-2 Colocar o adaptador ótico

À exceção dos adaptadores óticos estéreo, coloque os adaptadores óticos na extremidade distal do endoscópio, seguindo o procedimento descrito em “3-5 Colocar e remover o adaptador ótico” (página 33).

DICA

Quando o adaptador ótico é colocado no instrumento, é reconhecido automaticamente e é apresentada a seguinte mensagem.



Certifique-se de que o nome do adaptador ótico está correto.

7-3 Observar a área de medição

Observe a área de medição no ecrã em tempo real e verifique se a imagem é adequada para medição.



Consulte também “4-4 Observar o objeto a inspeccionar” (página 52) para obter mais informações acerca da observação da área de medição.

7-4 Medição

1 Durante a apresentação do ecrã em tempo real/de fixação, toque no botão [MEASURE].

É apresentado o ecrã de medição.

2 Especifique os pontos de referência.

Coloque o cursor em cada extremidade de um objeto com um comprimento conhecido na imagem observada e toque no botão [ENTER].

3 Defina o comprimento de referência.

Quando for apresentada a mensagem de introdução do comprimento de referência, introduza o comprimento conhecido tocando no botão para cima/baixo/esquerda/direita (▲ ▼ ◀ ▶) e toque no botão [ENTER] para o fixar.

4 Especifique os pontos de medição.

Coloque o cursor em cada extremidade do objeto a medir e toque no botão [ENTER] para medir o comprimento.

5 Grave os resultados da medição.


Prima o botão [RECORD] para gravar a imagem com os resultados da medição.

6 Saia da medição.

Toque no botão [LIVE] para ser apresentado o diálogo de confirmação de saída da medição. Selecione <YES> para sair da medição de escala. Selecione <NO> para regressar ao ecrã de medição.

Ou selecione <EXIT MEASUREMENT> no ecrã do menu de medição e selecione <EXECUTE> para sair da medição de escala e regressar ao ecrã anterior à medição de escala ser ativada. Selecione <CANCEL> para regressar ao ecrã de medição.

■ Apresentação do menu e funções do ecrã de medição de escala

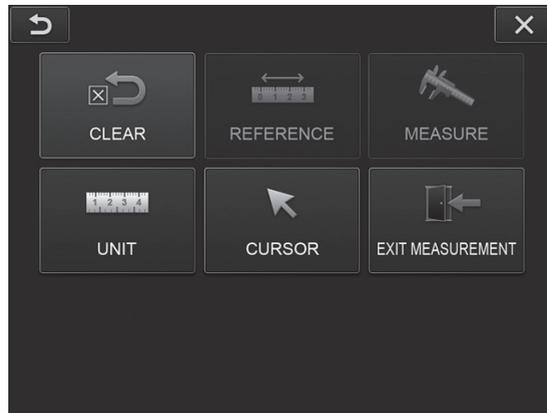

Menu	Definições disponíveis
<CLEAR> 	Elimina o último ponto de medição ou de referência especificado.
<REFERENCE> 	Define o novo comprimento de referência.
<MEASURE> 	Define os novos pontos de medição.
<UNIT> 	Seleciona a unidade dos resultados da medição. Seleciona <mm> ou <inch>.
<CURSOR> 	Seleciona a forma do cursor. Seleciona [x], [←] ou [+].
<EXIT MEASUREMENT> 	Sai do ecrã de medição de escala. A apresentação regressa ao ecrã anterior ao início da medição de escala.

8 Função de rede

8-1 Ligar à LAN sem fios

NOTA

- Note que a função de rede deste produto apenas é válida em determinadas áreas.
- Antes de iniciar o instrumento, certifique-se de que liga o adaptador LAN sem fios USB ao instrumento.

1 Ligar o adaptador LAN sem fios USB


Consulte "Ligar e remover o adaptador LAN sem fios USB" (página 43).

2 Configurar a LAN sem fios

■ Quando utilizar a unidade de controlo remoto

1 Seleccione [MENU] - <NETWORK> - <WIRELESS>.

2 Quando aparecer a janela de configuração de rede sem fios abaixo, incline o joystick [MEAS/ENTER] da unidade de controlo remoto para a direita para seleccionar a linha de ponto de acesso em branco e prima o botão [ENTER] durante breves instantes.




3 Quando aparecer a janela de configuração de ponto de acesso, introduza <SSID> e <PASSWORD>. Em seguida, seleccione <ENCRYPTION METHOD> e <ENTRY>.




4 Quando aparecer a janela de configuração de rede sem fios, incline o joystick [MEAS/ENTER] da unidade de controlo remoto para a esquerda para seleccionar o botão de seleção de ponto de acesso  e prima-o durante breves instantes.

Se o botão de seleção de ponto de acesso estiver iluminado, a configuração foi concluída.




■ Quando utilizar o painel tátil

- 1 Seleccione [MENU] - «NETWORK» - «WIRELESS».
- 2 Quando aparecer a janela de configuração de rede sem fios abaixo, seleccione a linha de ponto de acesso em branco.




- 3 Quando aparecer a janela de configuração de ponto de acesso, introduza «SSID» e «PASSWORD». Em seguida, seleccione «ENCRYPTION METHOD» e «ENTRY».

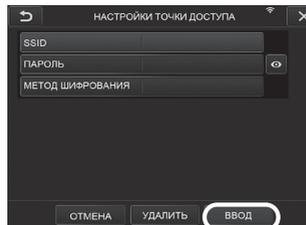

- 4 Quando aparecer a janela de configuração de rede sem fios, toque no botão de seleção de ponto de acesso  da linha em que é apresentado o ponto de acesso.

Se o botão de seleção de ponto de acesso estiver iluminado, a configuração foi concluída.

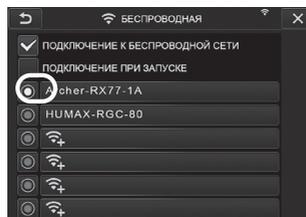

3 Ligar à LAN sem fios

- 1 Seleccione [MENU] - «NETWORK» - «WIRELESS» para ver a janela de configuração de rede sem fios.
- 2 Seleccione a caixa de selecção da linha de «CONNECT TO WIRELESS».
- 3 Se a ligação ao ponto de acesso for realizada com sucesso,  é apresentado no canto superior direito da janela.

Quando está a decorrer a ligação ao ponto de acesso, é apresentada a mensagem «CONNECTING».

8-2 Autenticação de dispositivo

NOTA


Antes de realizar a operação indicada nesta secção, inicie sessão no site do portal OSC e registe o instrumento que irá utilizar.

Para informações sobre os procedimentos de registo, consulte o método de operação OSC.

- 1 Seleccione [MENU] - «NETWORK» - «DEVICE AUTHENTICATION».



- 2 Quando aparecer a janela de autenticação de dispositivo abaixo, introduza o código PIN e seleccione «EXECUTE».




8-3 Atualização do software


DICA

Certifique-se de que liga previamente o cartão SD para transferir o software.

- 1 Selecione [MENU] - <SYSTEM SETUP> - <VERSION>.

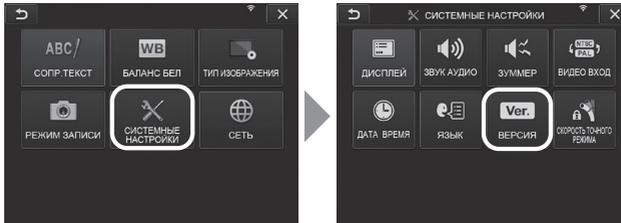


- 2 Ao premir [Check for updates], é apresentada a versão mais recente. Se existir uma versão para atualização, [Get updates] muda de uma apresentação a cinzento para um aspeto normal. Prima [Get updates] para obter os dados atualizados.

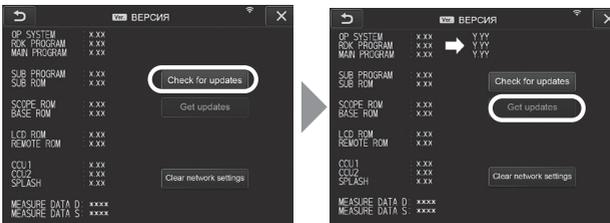

- 3 Quando a aquisição dos dados atualizados é concluída com sucesso, aparece a caixa de diálogo apresentada abaixo. Prima o botão [OK].

Reinicie o instrumento para concluir a configuração.

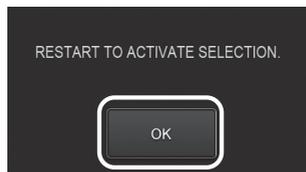

DICA

Pode ser necessária uma segunda atualização. Se for necessária uma segunda atualização, [REPEAT UPDATE.] é apresentado durante a primeira atualização. Reinicie o instrumento.

8-4 Carregar a imagem

1 Transferir como gravação

Pode carregar os ficheiros de fotografias gravados para o servidor na nuvem.


1 Seleccione [MENU] - «NETWORK» - «TRANSFER AS RECORDING».



2 Quando aparecer a janela abaixo, seleccione «ON».

Apenas são carregadas fotografias em conjunto com a operação de gravação.

Se a função print screen estiver LIGADA, dois ficheiros gravados serão carregados. Contudo, se falhar o carregamento do primeiro ficheiro, o segundo ficheiro não será carregado.



2 Transferência de lote


Podemos carregar os ficheiros de fotografias guardados na pasta para o servidor na nuvem por lote.

- 1 Abra a pasta em que são guardadas as imagens que pretende carregar e seleccione «BATCH TRANSFER» a partir do menu principal de miniaturas.



- 2 Quando for exibido o botão «EXECUTE», prima este botão para iniciar o carregamento.

Os ficheiros nas pastas de trabalho e os ficheiros em todas as subpastas são sujeitos a transferência de lote.




8-5 Inicializar as informações de rede


Pode inicializar as informações de rede especificadas para este produto. Quando eliminar este produto, certifique-se de que realiza esta operação. As informações indicadas abaixo são inicializadas durante esta operação.

- Informações de autenticação de dispositivo
- Informações de ponto de acesso (método de encriptação SSID, PW)
- Outras definições de rede (transferir como gravação, etc)

1 Seleccione [MENU] - <SYSTEM SETUP> - <VERSION>.

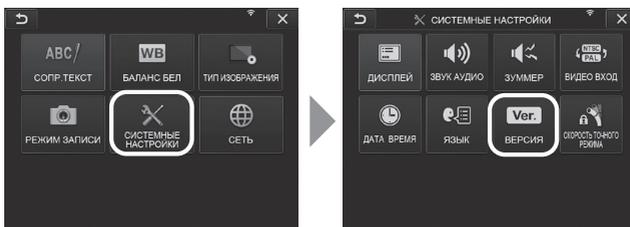


2 Prima [Clear network settings].



3 Quando a caixa de diálogo <DO YOU WANT TO INITIALIZE NETWORK SETTINGS?> é apresentada, prima <YES>.

As informações de rede são inicializadas.

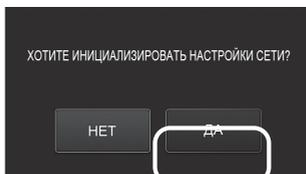

Inspeccione o instrumento tal como descrito em “3 Preparação e inspeção prévias à operação” (página 24). Se existir alguma avaria óbvia, não utilize o instrumento e contacte a EVIDENT para reparação. Ao mínimo de suspeita de irregularidade, não utilize o instrumento e desempenhe as ações descritas em “9-1 Guia de resolução de problemas”. Se não for possível resolver o problema adotando a ação corretiva descrita, pare de utilizar o instrumento e contacte a EVIDENT para reparação.

9-1 Guia de resolução de problemas

1 Mensagens de erro

Mensagem	Motivo e ação recomendada
⟨NO RECORDING MEDIA⟩	O cartão SDHC ou o dispositivo de memória USB não foi colocado. → Coloque o cartão SDHC ou o dispositivo de memória USB a utilizar e tente novamente. Ou DESLIGUE e volte a LIGAR o instrumento.
⟨RECORDING MEDIA FULL⟩	O cartão SDHC ou o dispositivo de memória USB está cheio. → Elimine os dados desnecessários para libertar espaço ou substitua por um novo cartão SDHC ou dispositivo de memória USB.
⟨THIS IMAGE CANNOT BE RETRIEVED⟩	A imagem não foi gravada com este instrumento. → Apenas as imagens gravadas com este instrumento podem ser apresentadas.
⟨RECORDING MEDIA ERROR. PLEASE FORMAT THE RECORDING MEDIA⟩	Não foi possível reconhecer o formato do cartão SDHC ou do dispositivo de memória USB. → Proceda à formatação do cartão SDHC ou do dispositivo de memória USB com este instrumento.
⟨THE SPECIFIED FILE NAME ALREADY EXISTS. PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME⟩	O nome do ficheiro já existe. → Especifique um nome do ficheiro diferente do que já existe.
⟨THE SPECIFIED FOLDER NAME ALREADY EXISTS. PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME⟩	O nome da pasta já existe. → Especifique um nome da pasta diferente do que já existe.
⟨RECORDING MEDIA IS LOCKED. PLEASE UNLOCK⟩	O cartão SDHC está bloqueado. → Desbloqueie o cartão SDHC a utilizar e insira-o no instrumento.
⟨INCOMPARABLE IMAGE RESOLUTION⟩	A resolução da imagem em tempo real é diferente da utilizada pela imagem reproduzida. → Especifique o ficheiro com a mesma resolução da utilizada pela imagem em tempo real.
⟨The image cannot be displayed in 3D view. Acquire the stereo image again⟩	A imagem não é adequada para visualização 3D. → Obtenha novamente a imagem estéreo.

Mensagem	Motivo e ação recomendada
<p>«OVER CURRENT (USB). PLEASE TURN OFF THE POWER.»</p>	<p>Não está a ser utilizado o dispositivo de memória USB recomendado. → Pare a inspeção, DESLIGUE e volte a LIGAR o instrumento. Utilize o dispositivo de memória USB recomendado.</p> <p>Foi ligado um dispositivo USB que não é um dispositivo de memória USB. → Desligue todos os dispositivos USB à exceção do dispositivo de memória USB.</p>
<p>«LOW BATTERY. PLEASE CONNECT TO THE AC ADAPTER OR TURN OFF THE POWER.»</p>	<p>A tensão da bateria é baixa. → Pare todas as operações, como a gravação, cópia ou eliminação de imagens, a formatação do dispositivo de memória USB etc. e substitua imediatamente a bateria. Alternativamente, ligue o adaptador de CA.</p>
<p>«HIGH TEMPERATURE (DISTAL END). PLEASE IMMEDIATELY PULL OUT THE INSERTION TUBE.»</p>	<p>A função de autoverificação foi ativada para solicitar o término da inspeção porque a extremidade distal ficou demasiado quente. → Retire imediatamente o tubo de inserção do objeto a observar.</p> <p>DICA</p> <p>Esta mensagem será apresentada antes de a temperatura atmosférica da extremidade distal atingir o máximo da temperatura ambiente de funcionamento.</p>
<p>«OVER CURRENT (ARTICULATION MOTOR). PLEASE TURN OFF THE POWER.»</p>	<p>A função de autoverificação foi ativada para solicitar o término da operação porque o tubo de inserção está sobrecarregado. → Estenda o tubo de inserção tanto quanto possível para diminuir o aquecimento e LIGUE a alimentação sem operar o joystick [ANGLE/LOCK].</p>
<p>«OVER CURRENT (LIGHT SOURCE). PLEASE TURN OFF THE POWER.»</p>	<p>A função de autoverificação foi ativada para solicitar o término da operação devido à corrente excessiva da fonte de luz. → Termine a inspeção, permita que o instrumento arrefeça e, em seguida, volte a LIGAR a alimentação.</p>
<p>«COMMUNICATION FAILED.»</p>	<p>O instrumento não está ligado à LAN sem fios. → Verifique a ligação da LAN sem fios. (Consulte "8-1 Ligar à LAN sem fios")</p> <p>A onda de rádio da LAN sem fios é fraca. → Desloque o instrumento para um local com boas condições de onda de rádio.</p> <p>O código PIN está incorreto ou o instrumento não está registado. → Verifique no site do portal OSC.</p> <p>As informações de autenticação de dispositivo não são guardadas na unidade principal. → Cancele o registo do instrumento no site do portal OSC e aguarde, no mínimo, 30 minutos antes de realizar novamente a autenticação de dispositivo.</p>

2

Problemas comuns

Problema	Motivo e ação recomendada
A iluminação não acende.	O botão [LIGHT] (☞) não está LIGADO. → LIGUE o botão [LIGHT] (☞).
Não é possível colocar o adaptador ótico no tubo de inserção.	Há um objeto estranho preso nos parafusos. → Limpe utilizando uma gaze ou cotonete limpos.
	O adaptador ótico utilizado não é um adaptador ótico indicado para este sistema. → Utilize o adaptador ótico indicado.
	O procedimento de instalação não foi o correto. → Instale novamente o adaptador ótico de acordo com os procedimentos corretos (consulte "3-5 Colocar e remover o adaptador ótico" (página 33)).
Não é possível remover o adaptador ótico do tubo de inserção.	O procedimento de remoção não foi o correto. → Instale novamente o adaptador ótico de acordo com os procedimentos corretos (consulte "3-5 Colocar e remover o adaptador ótico" (página 33)).
Não é possível LIGAR o sistema.	Não está ligado o adaptador de CA ou a bateria. → Ligue corretamente o adaptador de CA ou a bateria (consulte "3-3 Preparar a fonte de alimentação" (página 29)).
	A alimentação não está LIGADA. → Coloque o botão [POWER] (⏻) da unidade principal na posição de LIGADO.
	Está ligado um adaptador de CA ou bateria não indicados. → Utilize o adaptador de CA ou bateria indicados.
	A unidade endoscópica não foi colocada corretamente na unidade principal. → Coloque corretamente a unidade endoscópica na unidade principal.
Não é possível DESLIGAR o sistema.	A unidade principal está danificada. → Remova o adaptador de CA ou a bateria da unidade principal e DESLIGUE a alimentação.
A imagem não é nítida.	A lente da objetiva da extremidade distal do tubo de inserção ou o adaptador ótico estão sujos. → Limpe utilizando uma gaze ou cotonete limpos.
	O adaptador ótico não foi colocado corretamente. → Coloque corretamente o adaptador ótico.
	A nitidez da imagem não foi ajustada corretamente. → Ajuste corretamente a nitidez da imagem (consulte "4 Ajustar a nitidez da imagem" (página 74)).
	O monitor externo não foi ajustado corretamente. → Ajuste corretamente o monitor externo.

Problema	Motivo e ação recomendada
O brilho da imagem não é ótimo.	A lente da objetiva da extremidade distal do tubo de inserção ou o adaptador ótico estão sujos, ou a iluminação do adaptador ótico está suja. → Limpe utilizando uma gaze ou cotonete limpos.
	O controlo automático de brilho não está definido corretamente. → Utilize o botão [BRT]  para conseguir a definição correta.
	O monitor externo não foi ajustado corretamente. → Ajuste corretamente o monitor externo.
	O adaptador ótico está solto. → Coloque corretamente o adaptador ótico (consulte "3-5 Colocar e remover o adaptador ótico" (página 33)).
A reprodução de cores é fraca.	O balanço de brancos não foi definido corretamente. → Ajuste novamente o balanço de brancos.
	A cor da imagem não foi ajustada corretamente. → Ajuste corretamente a cor da imagem (consulte "5 Ajustar a saturação da imagem" (página 74)).
Há ruído visível na imagem.	O controlo automático de brilho não está definido corretamente. → Utilize o botão [BRT]  para o ajustar para a definição correta.
	A redução de ruído não foi ajustada corretamente. → Ajuste a redução de ruído para a definição correta através de «NOISE REDUCTION» no menu «IMAGE MODE».
O ecrã não é apresentado. (O ecrã não é apresentado corretamente.)	Coloque o botão [POWER]  da unidade principal na posição de DESLIGADO e volte a colocar o botão [POWER] na posição de LIGADO para reiniciar o instrumento.
	A unidade endoscópica não foi colocada corretamente na unidade principal. → Coloque corretamente a unidade endoscópica na unidade principal.
Não é possível ouvir o sinal sonoro de operação.	A opção «BEEP» no menu «SYSTEM SETUP» está definida como «OFF». Coloque «BEEP» no menu «SYSTEM SETUP» como «ON».
Todas as funções pararam durante a gravação de filmes.	O cartão SDHC que está a ser utilizado para a gravação de imagens não é o fornecido nem é recomendado pela EVIDENT. → Remova o adaptador de CA ou a bateria da unidade principal e DESLIGUE a alimentação. → Utilize o cartão SDHC para gravação de imagens que é fornecido ou recomendado pela EVIDENT.

Problema	Motivo e ação recomendada
A função de medição estéreo não inicia.	A combinação do adaptador ótico estéreo com a unidade endoscópica estéreo não é a correta. → Verifique se a combinação do n.º de série do adaptador ótico estéreo e o n.º de série da unidade endoscópica estéreo é a correta.
O resultado da medição de escala não é apresentado.	Está a ser utilizada uma imagem obtida por uma versão de software não suportada (1.20 ou anterior). → Utilize a imagem obtida pela versão de software 1.20A ou posterior.

9-2 Solicitar a reparação deste produto

Contacte a EVIDENT quando solicitar a reparação deste instrumento. Ao entregar o instrumento, inclua uma descrição detalhada sobre a avaria e as condições em que a mesma ocorre. As avarias que ocorrem durante o período de garantia são reparadas sem custos, em conformidade com o acordo de garantia. Certifique-se de que anexa o acordo de garantia ao entregar o instrumento para reparação. A reparação será cobrada se o acordo de garantia não for anexado. Os custos de envio são pagos pelo utilizador mesmo que a reparação seja feita de forma gratuita.

A EVIDENT não realiza reparações de instrumentos contaminados por substâncias nocivas.

NOTA

Se a placa principal deste produto for substituída devido a reparação, cancele o registo do instrumento antes da reparação no site do portal OSC. Em seguida, registre novamente as informações do instrumento após a reparação e realize a autenticação de dispositivo. Note que, se as informações do instrumento não forem registadas novamente, não poderá utilizar a função de rede.

10 Armazenamento e manutenção

10-1 Substituir a bateria

Embora a vida útil da bateria dependa do ambiente de funcionamento e da frequência de utilização, é recomendada a substituição da bateria sempre que o tempo de operação da mesma se torne demasiado curto.

Contacte a EVIDENT para a substituição da bateria.

Para obter mais informações sobre como inserir e remover a bateria, consulte “1 Utilizar a bateria” (página 29).

10-2 Substituir o anel de vedação

Aplique a massa de silicone no anel de vedação sobresselente fornecido com o adaptador ótico e substitua-o.

Substitua periodicamente o anel de vedação.

A posição de colocação do anel de vedação difere entre o modelo de 6 mm, o modelo de 4 mm e o modelo de 6,2 mm.

Consulte “2-2 Nomenclatura da extremidade distal/adaptador ótico” (página 20) e “3-5 Colocar e remover o adaptador ótico” (página 33) e coloque o anel de vedação na posição correta.

10-3 Limpar os componentes

1 Limpar o tubo de inserção

Sujidade ou outros objetos estranhos no tubo de inserção:

Limpe utilizando um pano suave e limpo.

Água suja, óleo de máquina ou outro líquido no tubo de inserção:

Ao limpar, não utilize um pano ou escova duros, mas sim um pano suave ou um cotonete e, em seguida, lave minuciosamente com uma gaze ou outro material humedecido com um detergente neutro. Em seguida, utilize uma gaze suave e limpa humedecida com água limpa e limpe o tubo de inserção para secar toda a humidade.

NOTA

Limpe o tubo de inserção imediatamente após o retirar. Deixar o tubo de inserção demasiado sujo durante um longo período pode provocar corrosão.


2 Limpar a extremidade distal

Sujidade ou gotículas de água na lente da objetiva da extremidade distal

Agarrando a parte rígida da extremidade distal, utilize uma gaze suave e limpa ou um cotonete para limpar a sujidade ou as gotículas de água.

Pode também utilizar a escova para limpar a sujidade e as gotículas de água.

Poderá obter um melhor resultado utilizando etanol absoluto ou álcool isopropílico, disponíveis no mercado.

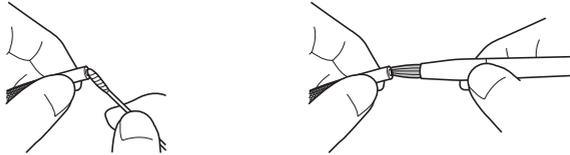

Acumulação de sujidade na ranhura de posicionamento do adaptador ótico ou nas roscas da extremidade distal

Utilize a escova fornecida com o kit de limpeza para limpar a sujidade acumulada.

Tenha em atenção que uma limpeza insuficiente poderá resultar na perda da estanquidade à água entre o adaptador ótico e a extremidade distal.

3 Limpar o adaptador ótico

Sujidade ou gotículas de água na superfície exterior do adaptador ótico ou da lente da objetiva no adaptador ótico

Utilize uma gaze suave e limpa ou um cotonete para limpar a sujidade e a água. Pode também utilizar a escova para limpar a sujidade e a água.


Limpar a sujidade da superfície externa do adaptador ótico quando este está colocado na extremidade distal

Agarrando a parte rígida da extremidade distal, limpe o adaptador ótico. Poderá obter um melhor resultado utilizando etanol absoluto ou álcool isopropílico, disponíveis no mercado.

Sujidade nas roscas do adaptador ótico

Humedeça um cotonete com etanol absoluto ou álcool isopropílico, disponíveis no mercado, e limpe continuamente na sequência ①, ②, ③ apresentada à direita até não haver sujidade no cotonete. Rode o cotonete enquanto limpa.

Além disso, para uma limpeza minuciosa, rode o adaptador ótico enquanto faz ② e ③.



NOTA

Não limpe o adaptador ótico debaixo de água corrente. Caso contrário, poderá danificar o adaptador ótico.

4 Limpar o conjunto do gancho

NOTA

Durante a limpeza, tenha atenção para não dobrar a haste em espiral num pequeno raio de curvatura nem aplicar força excessiva sobre o gancho.

- 1 Remova o conjunto do gancho invertendo a ordem dos passos descritos na secção “3-10 Encaixar o conjunto do gancho” (página 39).
- 2 Se o conjunto do gancho for contaminado por sujidade ou óleo, lave-o com um líquido de limpeza como um detergente neutro, enxague bem e seque-o completamente.

5 Limpar o monitor LCD

Problemas de visualização do monitor LCD devido a impressões digitais e sujidade

Limpe o monitor LCD com um pano suave humedecido com água limpa. Em seguida, limpe suavemente com um pano limpo e seco.

NOTA

- Nunca utilize um pano tratado quimicamente ou detergente forte como benzina ou álcool. Caso contrário, poderá danificar a superfície do monitor LCD.
- Não utilize um pano duro, sujo ou com substâncias estranhas. Caso contrário, poderá danificar a superfície do monitor LCD.

6 Limpar outras unidades

Se a unidade principal estiver suja, limpe-a com um pano suave humedecido com água limpa. Em seguida, limpe suavemente com um pano limpo e seco. Além disso, limpe completamente a sujidade e as gotículas de água da tampa da bateria, do interior da tampa do conector, da área de ligação da unidade de controlo remoto e da unidade principal e a área de ligação da unidade endoscópica e da unidade principal.

10-4 Precauções de armazenamento

Armazene este produto a uma temperatura ambiente e humidade normais.

1 Armazenar o instrumento na mala de transporte

Para saber como armazenar o instrumento na mala de transporte, consulte a etiqueta que descreve o procedimento de armazenamento fixa na superfície interior da tampa superior da mala de transporte.


NOTA

- Nunca submeta os cabos a dobras, puxões, fixações ou torções excessivas ou a esmagamento. Não permita que o cabo seja exposto a um calor que possa derreter a sua cobertura. Caso contrário, o cabo poderá ser danificado, o que pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não armazene o instrumento na mala de transporte com a alça para o ombro colocada. Caso contrário, o monitor LCD poderá ser arranhado ou a alça para o ombro danificada.

- 1 **DESLIGUE** a alimentação e remova a bateria ou retire a ficha do adaptador de CA.
- 2 Enrole o tubo de inserção à volta do cilindro e armazene-o na caixa do cilindro. Guarde o instrumento na mala de transporte de acordo com a ilustração presente na etiqueta de instruções de armazenamento.
- 3 Armazene o instrumento numa superfície plana em local limpo, seco e estável.

2 Armazenar o conjunto do gancho

- 1 Retire o estojo do conjunto do gancho da mala de transporte.
- 2 Enrole o conjunto do gancho e coloque-o no respetivo estojo.
(Podem ser armazenados dois conjuntos do gancho no estojo.)
- 3 Armazene também o gancho sobresselente no estojo do conjunto do gancho.
- 4 Armazene o estojo do conjunto do gancho na parte traseira da unidade principal.

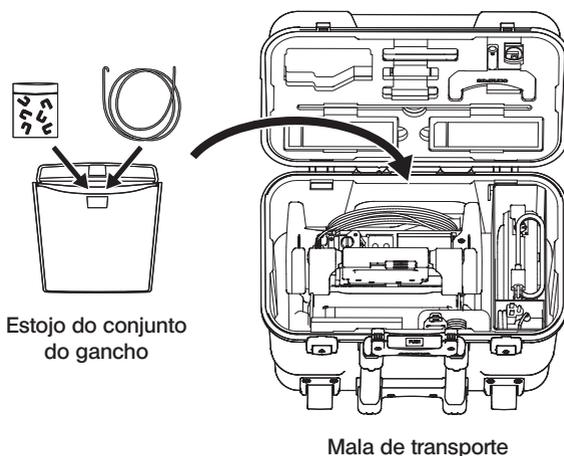

11-1 Ambiente de funcionamento

Item	Especificações
Temperaturas de funcionamento	
Tubo de inserção	No ar : -25 a 100 °C Na água: 10 a 30 °C
Outras peças à exceção do tubo de inserção	No ar : -21 a 49 °C (operação alimentada por bateria) 0 a 40 °C (operação alimentada por adaptador de CA)
Pressão atmosférica de funcionamento	
Tubo de inserção	No ar : pressão normal (1013 hPa) Na água : série IV94 1013 a 1513 hPa (até uma profundidade de água de 5,0 m) série IV96 1013 a 1772 hPa (até uma profundidade de água de 7,5 m)
Outras peças à exceção do tubo de inserção	No ar : pressão normal (1013 hPa)
Altitude do ambiente de funcionamento	
Todas as peças	Até uma altitude de 2000 m
Humidade do ambiente de funcionamento	
Todas as peças	15 a 90% (humidade relativa)
Resistência a líquidos	
Tubo de inserção	Nenhum problema mesmo que haja exposição a óleo de máquina, óleo leve ou solução salina a 5%.
Outras peças à exceção do tubo de inserção	
Impermeabilização	
Tubo de inserção	IV9●●●●N, V9●●●●N-MD, IV9●●●●N-MDS Construção à prova de água. Pode ser utilizado debaixo de água com o adaptador ótico colocado. A medição estéreo não está disponível debaixo de água. IV9635X1N, IV9635X1N-MD, IV9635X1N-MDS A utilização debaixo de água não é suportada.
Outras peças à exceção do tubo de inserção	Construção resistente à água. A utilização debaixo de água não é suportada. O instrumento não é resistente à água se a tampa da bateria ou outras tampas estiverem abertas.

Item	Especificações
Grau de poluição	
Todas as peças	2 (incluindo adaptador de CA)
Categoria de instalação (sobretensão)	
Todas as peças	II




NOTA

- O cumprimento das especificações do ambiente de funcionamento não constitui qualquer garantia contra danos ou avarias deste instrumento.
- Utilize o adaptador de CA e o carregador de baterias no interior (temperatura normal).

11-2 Outras especificações

1 Outras especificações

Item	Especificações	
Sistema ótico		
Para obter as especificações do adaptador ótico, consulte "11-3 Especificações do adaptador ótico" (página 124).		
Iluminação	A luz branca na unidade endoscópica é orientada para a extremidade distal do tubo de inserção pelo guia de luz.	
Extremidade distal		
Diâmetro externo	Série IV94: Ø4,0 mm	Série IV96: Ø6,0 mm, Ø6,2 mm
Comprimento da secção rígida da extremidade distal	Consulte as especificações do comprimento da secção rígida da extremidade distal do adaptador ótico.	
Angulação	IV9435N, IV9450N, IV9635X1N: 130 ° * IV9635N, IV9650N: 180 ° * IV9675N: 150 ° *	
	* Direção PARA CIMA, PARA BAIXO, PARA A ESQUERDA E PARA A DIREITA (Quando o tubo de inserção está reto.)	

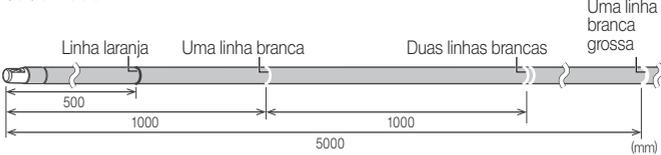Item	Especificações	
Secção flexível		
Flexibilidade	<p>Série IV94: Tubo ondulado duro e fixo entre a extremidade distal do tubo de inserção e a unidade endoscópica</p> <p>Série IV96: Tubo TF ondulado com a flexibilidade a aumentar gradualmente em direção à extremidade distal do tubo de inserção</p>	
Diâmetro externo	Série IV94: Ø4,0 mm	Série IV96: Ø6,0 mm, Ø6,2 mm
Linhas indicadoras	<p>Série IV94, série IV96 (exceto IV9635X1N)</p> <p>É apresentada uma linha laranja na posição de 500 mm a partir da extremidade distal do tubo de inserção.</p> <p>São apresentadas linhas brancas a cada 1000 mm a partir da extremidade distal do tubo de inserção. O número de linhas brancas aumenta a cada 1000 mm (1 linha aos 1000 mm, 2 linhas aos 2000 mm).</p> <p>É apresentada uma linha branca grossa na posição de 5000 mm a partir da extremidade distal do tubo de inserção. Para além dos 5000 mm, é adicionada uma linha branca à linha branca grossa a cada 1000 mm.</p>  <p>Série IV96 (apenas IV9635X1N)</p> <p>São apresentadas seis linhas brancas e cinco linhas laranja a partir da posição de 300 mm da extremidade distal do tubo de inserção, em intervalos de 20 mm.</p>  <p>São apresentadas 10 linhas brancas a partir da posição de 2350 mm da extremidade distal da extremidade distal do tubo de inserção, em intervalos de 20 mm.</p> 	
Comprimento total	<p>IV9435N, IV9635N, IV9635X1N: 3,5 m</p> <p>IV9450N, IV9650N: 5,0 m</p> <p>IV9675N: 7,5 m</p>	

Item	Especificações
Unidade de controlo remoto	
Dimensões	39(L) x 137(A) x 40(P) mm (sem tubo de inserção e cabos)
Peso (incluindo cabos e conectores)	0,2 kg
Unidade principal	
Dimensões	320(L) x 310(A) x 180(P) mm
Peso	3,9 kg
Peso (incluindo bateria e cartão SDHC)	IV9435N: 7,1 kg IV9450N: 7,2 kg IV9635N: 7,3 kg IV9635X1N: 7,5 kg IV9650N: 7,4 kg IV9675N: 7,6 kg
Painel LCD	TFT de 8,4 polegadas a cores com revestimento de baixa reflexão
Conector de entrada/saída	
Conector USB	Um conector compatível com USB 2.0
Fonte de alimentação	
Bateria	Bateria especificada (íons de lítio) Modelo: NP-L7S, fabricada pela IDX Tensão nominal: CC 14,8 V Capacidade nominal: 68 Wh Tempo de funcionamento alimentado por bateria: Aproximadamente 100 minutos (baseado numa bateria nova) Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do carregador de baterias.
Adaptador de CA da unidade principal	Modelo: SPU61A-107-P25G001-OSC, fabricado pela SINPRO Tensão de entrada: 100 V a 240 V CA \pm 10% Frequência: 50/60 Hz Tensão de saída: 16 V CC
Carregador de baterias	Modelo: JL-2PLUS, fabricado pela IDX Tensão de entrada: 100 V a 240 V CA Frequência: 50/60 Hz Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do carregador de baterias.
Consumo de energia	45 W
Suporte de gravação	Cartão SDHC e dispositivo de memória USB (para produtos recomendados, contacte a EVIDENT.)

Item	Especificações
Gravação de imagens fixas	
Resolução	Série IV94, série IV96 (apenas IV9635X1N): H768 x V576 (pixel) Série IV96 (exceto IV9635X1N): H1024 x V768 (pixel) Entrada externa NTSC: H640 x V480 (pixel) Entrada externa PAL: H768 x V576 (pixel)
Formato de gravação	Os ficheiros são armazenados em formato JPEG comprimido (compatível com Exif 2).
Reprodução de imagens fixas	
Restrições	As imagens gravadas pelo instrumento podem ser reproduzidas.
Gravação de filmes	
Resolução	Série IV94, série IV96 (apenas IV9635X1N): H768 x V576 (pixel) Série IV96 (exceto IV9635X1N): H1024 x V768 (pixel) Entrada externa NTSC: H640 x V480 (pixel) Entrada externa PAL: H768 x V576 (pixel)
Formato de gravação	Formatos MPEG-4 AVC (H.264). Podem ser reproduzidos no Windows Media Player. (Deve ser instalado o Windows Media Player 12 ou posterior.)
Reprodução de filmes	
Restrições	As imagens gravadas com o instrumento podem ser reproduzidas.
Saída de filme	
Formato	Saída VGA analógica
Resolução	H1024 x V768 (pixel)
Velocidade de fotogramas	60 fps
Fabricante	EVIDENT CORPORATION TOKYO, JAPÃO

DICA

- As imagens gravadas com o instrumento podem ser reproduzidas num computador etc., mas as imagens gravadas com dispositivos de gravação de imagens, como uma câmara digital ou computador pessoal não podem ser reproduzidas pelo instrumento.
- Todas as marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

2 Norma de aplicação externa

Informações de CEM	Este produto é aplicado em conformidade com os requisitos da norma IEC/EN61326-1 relativa a compatibilidade eletromagnética. <ul style="list-style-type: none"> · Emissão Classe A, em conformidade com os requisitos para ambientes industriais. · Imunidade Em conformidade com os requisitos para ambientes industriais. Podem ocorrer interferências caso este produto seja utilizado em ambientes domésticos.
Informações da FCC	Este produto está em conformidade com o seguinte. <ul style="list-style-type: none"> · NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento é operado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. A operação deste equipamento numa área residencial pode provocar interferências prejudiciais, caso no qual o utilizador deverá suprimir as interferências pelos seus próprios meios. · AVISO DA FCC Qualquer alteração ou modificação que não seja explicitamente aprovada pela entidade responsável pela conformidade pode revogar o direito de o utilizador operar o equipamento.
Diretiva REEE 	O seguinte aplica-se à marcação apresentada à esquerda. De acordo com a Diretiva europeia relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado como um resíduo urbano não triado, devendo ser recolhido em separado. Consulte o seu distribuidor local da EVIDENT relativamente a sistemas de devolução e/ou recolha disponíveis no seu país.
Diretiva RoHS da China 	Este logótipo é o logótipo a aplicar em produtos elétricos e eletrónicos comercializados na China com base nos "Métodos de gestão para a restrição da utilização de substâncias perigosas em produtos elétricos e eletrónicos" e nos "Requisitos do logótipo para a utilização restrita de substâncias perigosas em produtos elétricos e eletrónicos". (Nota) O número do logótipo indica o período de anos em que, em condições normais, não haverá mutações repentinas nem fuga das substâncias perigosas contidas nos produtos elétricos e eletrónicos. Não indica o período de anos em que é garantido o desempenho funcional do produto.

Apenas para a Coreia

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용

환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

3 Informações sobre a licença de software

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA LICENÇA DA CARTEIRA DE PATENTES VISUAIS MPEG-4 PARA A UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL POR PARTE DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO VISUAL MPEG-4 ("VÍDEO MPEG-4") E/OU (ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO ATRAVÉS DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEOS MPEG-4. NÃO ESTÁ IMPLÍCITA NEM FOI CONCEDIDA UMA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AS RESPEITANTES A UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E COMERCIAIS E LICENCIAMENTO ATRAVÉS DA MPEG LA, LLC. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM).

Este software é baseado em parte no trabalho do Independent JPEG Group.

4 Utilizar software de código aberto

Este produto pode incluir (i) software de código aberto e (ii) outro software cujo código fonte foi publicado de forma intencional (doravante mencionados de forma coletiva como "OSS").

O OSS incluído neste produto deve ser-lhe licenciado e distribuído de acordo com os termos e condições aplicáveis ao OSS. Consulte tais termos e condições do OSS no URL seguinte. Os detentores dos direitos de autor do OSS estão listados no URL seguinte.

NÃO EXISTE QUALQUER GARANTIA PARA O OSS, NA MEDIDA DO QUE FOR PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O OSS "TAL COMO ESTÁ" NÃO POSSUI QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. TODO O RISCO RESPEITANTE À QUALIDADE E DESEMPENHO DO OSS É ASSUMIDO PELO UTILIZADOR. SE FOR COMPROVADO QUE O OSS POSSUI DEFEITOS, O UTILIZADOR ASSUMIRÁ TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO OU CORREÇÃO.

Algumas das licenças de OSS associadas a este produto poderão permitir a obtenção do código fonte para determinado software que a EVIDENT tem obrigação de fornecer, de acordo com os termos e condições aplicáveis ao OSS. Pode obter uma cópia desse código fonte a partir do URL seguinte. Esta oferta é válida durante um período de três (3) anos a partir da data original de compra. A EVIDENT não assume qualquer responsabilidade em relação ao fornecimento do código fonte, à exceção do código fonte de determinado software.

<http://www.olympus-ims.com/rvi-products/iplex-nx/oss-license/>

Não deverá solicitar à EVIDENT informações respeitantes a códigos fonte obtidos no URL acima.

5 Licença da carteira de patentes AVC

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA LICENÇA DA CARTEIRA DE PATENTES AVC PARA A UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL POR PARTE DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU QUE TENHA SIDO OBTIDO ATRAVÉS DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PARA FORNECER VÍDEOS AVC. NÃO ESTÁ IMPLÍCITA NEM FOI CONCEDIDA UMA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS ATRAVÉS DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

11-3 Especificações do adaptador ótico

1 Para o modelo de 4 mm do tubo de inserção

Quando o adaptador ótico (opcional) está colocado no tubo de inserção.

Nome do adaptador		AT120D/NF -IV94	AT120D/FF -IV94	AT100S/NF -IV94N	AT100S/FF -IV94N
Abreviatura do produto		A120N	A120F	A100N	A100F
Cor do caracter		Vermelho	Verde	Vermelho	Verde
Sistema ótico	Campo de visão	120°	120°	100°	100°
	Direção da visualização	Vista frontal	Vista frontal	Vista lateral	Vista lateral
	Profundidade do campo*1	2 a 200 mm	17 a ∞ mm	2 a 15 mm	8 a ∞ mm
Extremidade distal	Diâmetro externo*2	Ø4,0 mm	Ø4,0 mm	Ø4,0 mm	Ø4,0 mm
	Comprimento da extremidade distal rígida*3	20,2 mm	20,1 mm	22,9 mm	22,9 mm

Nome do adaptador		AT80D/FF -IV94N	AT70D/70D -IV94N	AT50S/50S -IV94N
Abreviatura do produto		A80F	A70/70	A50/50
Cor do caracter		Verde	Azul	Azul
Sistema ótico	Campo de visão	80°	70°/70°	50°/50°
	Direção da visualização	Vista frontal	Vista frontal	Vista lateral
	Profundidade do campo*1	35 a ∞ mm	5 a 200 mm	3 a 150 mm
Extremidade distal	Diâmetro externo*2	Ø4,0 mm	Ø4,0 mm	Ø4,0 mm
	Comprimento da extremidade distal rígida*3	20,1 mm	22,3 mm	26,7 mm

*1 Indica o intervalo em que a imagem pode ser vista com nitidez.

*2 Pode ser inserido num orifício de Ø4,0 mm quando colocado no tubo de inserção.

*3 Indica o comprimento da parte rígida da extremidade distal quando colocado no tubo de inserção.

2 Para o modelo de 6 mm do tubo de inserção

Quando o adaptador ótico (opcional) está colocado no tubo de inserção.

Nome do adaptador		AT50D/FF -IV96N	AT80D/FF -IV96N	AT120D/NF -IV96N	AT120D/FF -IV96N
Abreviatura do produto		A50F	A80F	A120N	A120F
Cor do caracter		Branco	Verde	Vermelho	Verde
Sistema ótico	Campo de visão	50°	80°	120°	120°
	Direção da visualização	Vista frontal	Vista frontal	Vista frontal	Vista frontal
	Profundidade do campo*1	50 a ∞ mm	20 a ∞ mm	7 a 300 mm	19 a ∞ mm
Extremidade distal	Diâmetro externo*2	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm
	Comprimento da extremidade distal rígida*3	21,3 mm	21,3 mm	21,4 mm	21,4 mm

Nome		AT120S/NF -IV96N	AT120S/FF -IV96N	AT90D/90D -IV96N	AT70S/70S -IV96N
Abreviatura do produto		A120N	A120F	A90/90	A70/70
Cor do caracter		Vermelho	Verde	Azul	Azul
Sistema ótico	Campo de visão	120°	120°	90°/90°	70°/70°
	Direção da visualização	Vista lateral	Vista lateral	Vista frontal	Vista lateral
	Profundidade do campo*1	4 a 150 mm	20 a ∞ mm	5 a 250 mm	4 a 250 mm
Extremidade distal	Diâmetro externo*2	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm
	Comprimento da extremidade distal rígida*3	26,6 mm	26,6 mm	25,0 mm	31,2 mm

*1 Indica o intervalo em que a imagem pode ser vista com nitidez.

*2 Pode ser inserido num orifício de Ø6,0 mm quando colocado no tubo de inserção.

*3 Indica o comprimento da parte rígida da extremidade distal quando colocado no tubo de inserção

3

Para o modelo de 6,2 mm do tubo de inserção

Quando o adaptador ótico (opcional) está colocado no tubo de inserção.


Nome do adaptador		AT80D -IV96X1N	AT120D/NF -IV96X1N	AT120D/FF -IV96X1N	AT80S -IV96X1N
Abreviatura do produto		A80	A120N	A120F	A80
Cor do caracter		Preto	Vermelho	Verde	Preto
Sistema ótico	Campo de visão	80°	120°	120°	80°
	Direção da visualização	Vista frontal	Vista frontal	Vista frontal	Vista lateral
	Profundidade do campo* ¹	35 a ∞ mm	2 a 200 mm	17 a ∞ mm	30 a ∞ mm
Extremi- dade distal	Diâmetro externo* ²	Ø6,2 mm	Ø6,2 mm	Ø6,2 mm	Ø6,2 mm
	Comprimento da extremi- dade distal rígida* ³	20,6 mm	20,6 mm	20,5 mm	24,4 mm
Nome do adaptador		AT120S -IV96X1N	AT70D/70D -IV96X1N	AT60S/60S -IV96X1N	
Abreviatura do produto		A120	A70/70	A60/60	
Cor do caracter		Preto	Azul	Azul	
Sistema ótico	Campo de visão	120°	70°/70°	60°/60°	
	Direção da visualização	Vista lateral	Vista frontal	Vista lateral	
	Profundidade do campo* ¹	8 a ∞ mm	5 a 200 mm	3 a 150 mm	
Extremi- dade distal	Diâmetro externo* ²	Ø6,2 mm	Ø6,2 mm	Ø6,2 mm	
	Comprimento da extremi- dade distal rígida* ³	24,4 mm	22,7 mm	28,3 mm	

*¹ Indica o intervalo em que a imagem pode ser vista com nitidez.

*² Pode ser inserido num orifício de Ø6,2 mm quando colocado no tubo de inserção.

*³ Indica o comprimento da parte rígida da extremidade distal quando colocado no tubo de inserção.

Quadro do sistema

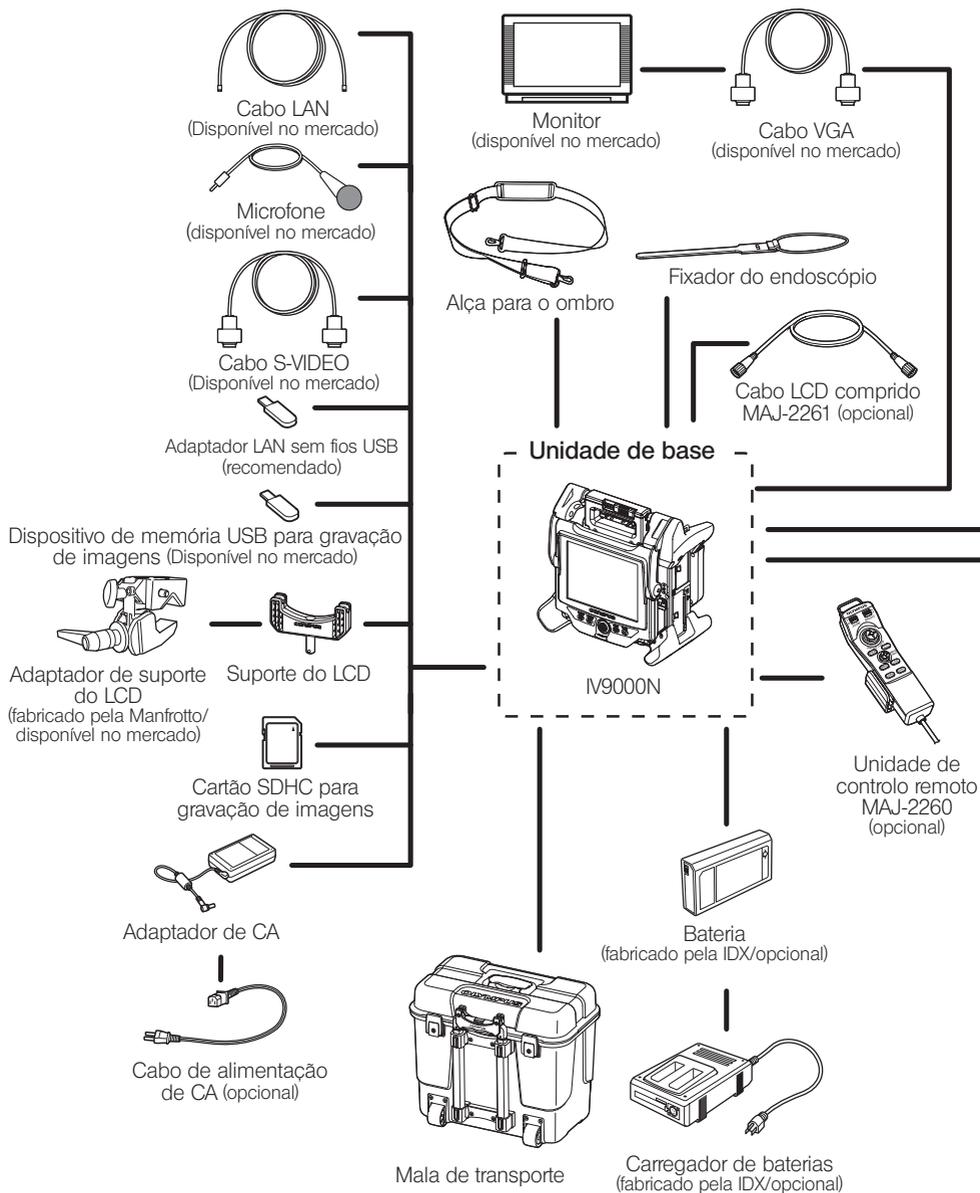

—Unidade endoscópica estéreo (opcional)—



Modelo de 4 mm

- IV9435N-MD*
- IV9450N-MD*
- IV9435N-MDS**
- IV9450N-MDS**

Modelo de 6 mm

- IV9635N-MD*
- IV9650N-MD*
- IV9675N-MD*
- IV9635N-MDS**
- IV9650N-MDS**
- IV9675N-MDS**

Modelo de 6,2 mm

- IV9635X1N-MD*
- IV9635X1N-MDS**

As ferramentas de verificação seguintes estão incluídas com a unidade endoscópica estéreo.

Modelo de 4 mm (em caso de adição de MAJ-2265)

Modelo de 6 mm (em caso de adição de MAJ-2264)

Modelo de 6,2 mm (em caso de adição de MAJ-2414)



* Os adaptadores óticos seguintes estão incluídos com a MD.

Modelo de 4 mm AT70D/70D-IV94N

Modelo de 6 mm AT90D/90D-IV96N

Modelo de 6,2 mm AT70D/70D-IV96X1N

** Os adaptadores óticos seguintes estão incluídos com a MDS.

Modelo de 4 mm

- AT70D/70D-IV94N
- AT50S/50S-IV94N

Modelo de 6 mm

- AT90D/90D-IV96N
- AT70S/70S-IV96N

Modelo de 6,2 mm

- AT70D/70D-IV96X1N
- AT60S/60S-IV96X1N

Os itens seguintes estão incluídos com a unidade endoscópica estéreo e a unidade endoscópica.

Modelo de 6,2 mm

- Estojo do conjunto do gancho
- Pega da abertura do canal

- Conjunto do gancho (em caso de adição de MAJ-1245)



- Gancho (em caso de adição de MB-910(B))

- Grampo de cinto

—Unidade endoscópica (opcional)—



Modelo de 4 mm

- IV9435N
- IV9450N

Modelo de 6 mm

- IV9635N
- IV9650N
- IV9675N

Modelo de 6,2 mm

- IV9635X1N



Estojo do endoscópio (opcional)

Modelo de 4 mm e de 6 mm

- MAJ-2262

Modelo de 4 mm, de 6 mm e de 6,2 mm

- MAJ-2501



Adaptador ótico (opcional)

Modelo de 4 mm

- AT120D/NF-IV94N
- AT120D/FF-IV94N
- AT100S/NF-IV94N
- AT100S/FF-IV94N
- AT80D/FF-IV94N

Modelo de 6 mm

- AT50D/FF-IV96N
- AT80D/FF-IV96N
- AT120D/NF-IV96N
- AT120D/FF-IV96N
- AT120S/NF-IV96N
- AT120S/FF-IV96N

Modelo de 6,2 mm

- AT80D-IV96X1N
- AT120D/NF-IV96X1N
- AT120D/FF-IV96X1N
- AT80S-IV96X1N
- AT120S-IV96X1N



Manga rígida (opcional)

Modelo de 4 mm

- MAJ-1737

Modelo de 6 mm e de 6,2 mm

- MAJ-1253

Ferramentas de recolha (opcionais)

Modelo de 6,2 mm

- Laço MAJ-1353 
- Grampo MAJ-1354 
- Cesto MAJ-1355 
- Garra MAJ-1356 
- Ímã MAJ-1357 

Manufactured by

EVIDENT CORPORATION

6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan

Distributed by

EVIDENT EUROPE GmbH

Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg, Germany

EVIDENT EUROPE GmbH UK Branch

Part 2nd Floor Part A, Endeavour House, Coopers End Road, Stansted CM24 1AL, U.K.

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.

48 Woerd Ave Waltham, MA 02453, U.S.A.

EVIDENT AUSTRALIA PTY LTD

97 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

Life science solutions

Service Center



[https://www.olympus-lifescience.com/
support/service/](https://www.olympus-lifescience.com/support/service/)

Official website



<https://www.olympus-lifescience.com>

Industrial solutions

Service Center



[https://www.olympus-ims.com/
service-and-support/service-centers/](https://www.olympus-ims.com/service-and-support/service-centers/)

Official website



<https://www.olympus-ims.com>