



OmniScan X3 a OmniScan X3 64 PA/UT Defektoskop

Uživatelská příručka

DMTA-20102-01CS — Rev. 8
Červen 2024

Tento návod k použití obsahuje informace, které jsou nezbytné k používání tohoto výrobku značky Evident bezpečným a účinným způsobem. Před zahájením používání tohoto výrobku se důkladně obeznamte s tímto návodem. Výrobek používejte v souladu s pokyny.

Tento návod uchovávejte na bezpečném a přístupném místě.

EVIDENT CANADA, INC.
3415, Rue Pierre-Ardouin Québec (QC) G1P 0B3 Canada

Autorská práva © 2024 společnosti Evident. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, překládána ani distribuována bez výslovného písemného svolení společnosti Evident.

Přeloženo z anglického vydání:
OmniScan X3 and OmniScan X3 64 – PA/UT Flaw Detector: User’s Manual
(DMTA-20102-01EN – Rev. 9, April 2024)
Copyright © 2024 by Evident.

Při přípravě a překládání tohoto dokumentu byla věnována obzvláštní pozornost zajištění přesnosti informací, které jsou v něm obsaženy a které odpovídají verzi výrobku vyrobené před datem uvedeným na titulní straně. Pokud však došlo k úpravě výrobku po tomto datu, mohou mezi návodem a výrobkem existovat rozdíly.

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Číslo dílu: DMTA-20102-01CS
Rev. 8
Červen 2024

Vytištěno v Kanadě

Výrazy HDMI, multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI) a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.

Logo SD je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.



Všechny značky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků a třetích stran.

Obsah

Seznam zkratk	7
Důležité informace – přečtěte si je před použitím	9
Určené použití	9
Návod k použití	9
Kompatibilita zařízení	10
Opravy a modifikace	10
Bezpečnostní symboly	10
Bezpečnostní signální slova	11
Signální slova na úrovni poznámek	12
Bezpečnost	12
Varování	12
Bezpečnostní opatření související s akumulátory a bateriemi	14
Nařízení týkající se odesílání produktů obsahujících lithium-iontové akumulátory a baterie	15
Likvidace zařízení, přístrojů a vybavení	15
BC (Nabíječka akumulátorů – Kalifornie, USA)	16
CE (Evropské společenství)	16
UKCA (Spojené království)	16
RCM (Austrálie)	17
Směrnice OEEZ	17
Čínská směrnice RoHS	17
Korea Communications Commission (Korejská komunikační komise – KCC)	19
Shoda se směrnicí EMK (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)	19
Shoda s předpisy FCC (USA)	19
Shoda s normou ICES-001 (Kanada)	20
Informace o záruce	21
Technická podpora	22

Úvod	23
1. Obsah balení	25
2. Přehled	27
2.1 Dotykový displej	28
2.2 Hlavní ovládací prvky	28
2.3 Tlačítko napájení	29
2.4 Tlačítko Nápověda	29
2.5 Funkční klávesy	29
2.6 Světelné ukazatele	29
2.6.1 Světelný ukazatel napájení	29
2.6.2 Světelný ukazatel záznamu	30
2.6.3 Výstražné světelné ukazatele (alarmy)	30
2.7 Levý boční panel	31
2.8 Pravý boční panel	33
2.9 Horní panel	33
2.10 Zadní panel	35
2.11 Kotevní body postroje	36
2.12 Speciální boční dvířka	37
3. Základní provoz	41
3.1 Zapnutí a vypnutí přístroje OmniScan X3	41
3.2 Aktivace automatického režimu spuštění	42
3.3 Provoz při střídavém napájení	43
3.4 Lithium-iontová baterie	44
3.4.1 Indikátory stavu baterií	45
3.4.2 Vyjmutí a vložení baterie	46
3.4.3 Nabíjení baterie	48
3.4.4 Skladování baterií a prodloužení životnosti	49
3.4.5 Likvidace použité baterie	51
3.4.6 Výstrahy týkající se použití baterie	51
3.5 Software	52
3.6 Globální polohový systém (GPS)	52
4. Údržba a řešení problémů	53
4.1 Preventivní údržba	53
4.2 Čištění přístroje	53
4.2.1 Čištění pouzdra	53
4.2.2 Čištění obrazovky a ochranné fólie	54
4.2.3 Čištění nebo výměna ventilátoru	54

4.3	Výměna ochranné fólie displeje	57
4.4	Řešení problémů	57
5.	Technické parametry	61
5.1	Všeobecné specifikace	61
5.2	Specifikace konektoru záznamu	63
5.2.1	Akustické specifikace	64
5.2.2	Specifikace záznamu	67
5.2.3	Specifikace dat	67
6.	Reference konektorů	69
6.1	Konektor kodéru skeneru	70
6.2	Alarm a konektor I/O	71
7.	Připojení k PC pomocí vzdáleného připojení WeldSight	73
7.1	Spouštění vzdáleného připojení WeldSight	73
7.2	Připojování OmniScan X3 k zařízení WeldSight	77
	Příloha: Příslušenství a náhradní díly	81
	Seznam obrázků	85
	Seznam tabulek	87

Seznam zkratek

AC	střídavý proud
AIM	Mapa akustického vlivu
CLK	hodiny
DC	stejnoseměrný proud
DIR	směr
EFUP	doba, po kterou je výrobek možno používat způsobem šetrným k životnímu prostředí
FMC	Full Matrix Capture
GPS	Globální polohový systém
I/O	vstup/výstup
LAN	místní síť
LCD	displej z tekutých krystalů
OEEZ	směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
P/N	objednací číslo
PA	phased array
RH	relativní vlhkost
SDHC	Zabezpečená digitální vysoká kapacita
TCG	časově korigovaný zisk
TFM	Total Focusing Method
TFT	tenkovrstvý tranzistor
TOFD	difrakce času doletu
TTL	tranzistorově-tranzistorová logika
UT	ultrazvukové testování
WLAN	bezdrátová místní síť

Důležité informace – přečtěte si je před použitím

Určené použití

Zařízení OmniScan X3 je určeno k provádění nedestruktivních kontrol průmyslových a komerčních materiálů.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení OmniScan X3 k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určeno. V žádném případě se nesmí použít ke kontrole či vyšetřování částí lidského nebo zvířecího těla.

Návod k použití

Tento návod obsahuje informace, které jsou nezbytné pro bezpečné a účinné používání tohoto výrobku. Předtím než začnete výrobek používat, důkladně se obeznamte s tímto návodem. Produkt používejte v souladu s pokyny. Tento návod uchovávejte na bezpečném a přístupném místě.

DŮLEŽITÉ

Některé detaily součástí znázorněné v tomto návodu se mohou lišit od součástí nainstalovaných na zařízení. Provozní principy však zůstávají stejné.

Kompatibilita zařízení

Toto zařízení používejte pouze se schváleným doplňkovým vybavením dodaným společností Evident. Vybavení dodávané společností Evident a schválené k použití s tímto zařízením je popsáno dále v tomto návodu.



UPOZORNĚNÍ

Vždy používejte pouze vybavení a příslušenství, které splňuje specifikace společnosti Evident. Používání nekompatibilního vybavení může způsobit nesprávnou funkci a/nebo poškození zařízení, případně zranění osob.

Opravy a modifikace

Toto zařízení neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Otevření zařízení může mít za následek ztrátu platnosti záruky.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zamezení zranění osob a/nebo poškození zařízení, zařízení nerozebírejte, neopravujte a nepokoušejte se jej opravovat.

Bezpečnostní symboly

Na zařízení a v návodu k použití lze najít následující bezpečnostní symboly:



Všeobecný symbol varování

Tento symbol upozorňuje uživatele na potenciální nebezpečí. Veškerá bezpečnostní sdělení, která následují za tímto symbolem, je nutno dodržovat, aby se zamezilo možnému újmě na zdraví nebo materiálním škodám.



Symbol varování upozorňující na vysoké napětí

Tento symbol se používá k varování uživatele a upozorňuje na hrozící nebezpečí úrazu elektrickým proudem při napětí vyšším než 1000 V. Veškerá bezpečnostní sdělení, která následují za tímto symbolem, je nutno dodržovat, aby se zamezilo možnému újmě na zdraví.

Bezpečnostní signální slova

V dokumentaci zařízení lze najít následující bezpečnostní symboly:



NEBEZPEČÍ

Signální slovo NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci. Vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost postupu, úkonu apod., jehož nesprávné provedení nebo nedodržení bude mít za následek vážné nebo dokonce smrtelné zranění osob. Narazíte-li na signální slovo NEBEZPEČÍ, nepokračujte v provádění příslušného postupu, dokud nebudou plně pochopeny a splněny uvedené podmínky.



VAROVÁNÍ

Signální slovo VAROVÁNÍ označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci. Vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost postupu, úkonu apod., jehož nesprávné provedení nebo nedodržení může mít za následek vážné nebo dokonce smrtelné zranění osob. Nepokračujte za signální slovo VAROVÁNÍ, dokud plně nepochopíte a nesplníte uvedené podmínky.



UPOZORNĚNÍ

Signální slovo UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně hrozící nebezpečnou situaci. Vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost postupu, úkonu apod., jehož nesprávné provedení nebo nedodržení by mohlo mít za následek lehčí nebo středně závažné zranění osob, věcnou škodu, zejména škodu na výrobku nebo zničení celého výrobku či některých jeho součástí, případně ztrátu dat. Narazíte-li na signální slovo UPOZORNĚNÍ, nepokračujte v provádění příslušného postupu, dokud plně nepochopíte a nesplníte uvedené podmínky.

Signální slova na úrovni poznámek

V dokumentaci k zařízení se mohou vyskytovat následující signální slova na úrovni poznámek:

DŮLEŽITÉ

Signální slovo DŮLEŽITÉ vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost poznámce, která poskytuje důležité informace nebo informace nezbytné k provedení určitého úkonu.

POZNÁMKA

Signální slovo POZNÁMKA upozorňuje na provozní proceduru, postup nebo podobné informace, které vyžadují zvláštní pozornost. Poznámka také označuje související doplňující informace, které jsou užitečné, ale ne nezbytně nutné.

PORADA

Signální slovo DOPORUČENÍ vyzývá k tomu, abyste věnovali pozornost poznámce, která vám pomůže použít techniky a postupy popsané v tomto návodu tak, aby vyhověly vašim specifickým potřebám, nebo poskytne rady, jak efektivně využívat možnosti výrobku.

Bezpečnost

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že byla přijata správná bezpečnostní preventivní opatření (viz následující varování). Kromě toho věnujte pozornost vnějším označením na zařízení, která jsou popsána v části „Bezpečnostní symboly“.

Varování



VAROVÁNÍ

Všeobecná varování

- Před zapnutím zařízení si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu.

- Tento návod uchovávejte na bezpečném místě pro pozdější použití.
- Dodržujte stanovené instalační a provozní postupy.
- Je bezpodmínečně nutné respektovat bezpečnostní výstrahy a varování uvedené na zařízení a v tomto návodu k použití.
- Pokud se zařízení a vybavení používá způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít ke zhoršení úrovně ochrany, kterou zařízení poskytuje.
- Do zařízení neinstalujte náhražkové díly, ani neprovádějte jakékoli neoprávněné úpravy zařízení.
- Servisní pokyny, kde jsou uvedeny, jsou určeny pro školený servisní personál. Abyste se vyhnuli nebezpečí zasažení elektrickým proudem, neprovádějte na zařízení žádné práce, pro které nemáte náležitou kvalifikaci. Máte-li jakýkoli problém nebo dotaz týkající se tohoto zařízení, kontaktujte společnost Evident nebo autorizovaného zástupce společnosti Evident.
- Nedotýkejte se konektorů přímo rukou. V opačném případě může dojít k funkční poruše nebo k zasažení elektrickým proudem.
- Zabraňte vniknutí kovových či jiných cizích částic do přístroje přes konektory či jiné otvory. V opačném případě může dojít k funkční poruše nebo k zasažení elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ

Varování týkající se elektrických částí

Zařízení je nutno připojovat pouze k takovému zdroji elektrického napájení, který odpovídá údajům na štítku uvádějícím jmenovité hodnoty zařízení.



UPOZORNĚNÍ

V případě použití neschváleného napájecího kabelu, který není určen pro výroby Evident, nemůže společnost Evident zajistit elektrickou bezpečnost zařízení.

Bezpečnostní opatření související s akumulátory a bateriemi



UPOZORNĚNÍ

- Před likvidací akumulátoru nebo baterie zkontrolujte příslušné místní zákony, pravidla a předpisy a řiďte se jejich požadavky.
- Přeprava lithium-iontových akumulátorů a baterií je regulována Organizací spojených národů v rámci Doporučení Organizace spojených národů o přepravě nebezpečného zboží. Očekává se, že vládní orgány, mezivládní organizace a další mezinárodní organizace budou dodržovat principy stanovené v těchto nařízeních a přispívat tak k celosvětové harmonizaci v této oblasti. Mezi tyto mezinárodní organizace patří International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), International Maritime Organization (IMO), ministerstvo dopravy USA (USDOT), Transport Canada (TC) a další. Před přepravou lithium-iontových akumulátorů a baterií kontaktujte dopravce a ověřte aktuální podobu nařízení.
- Pouze pro Kalifornii (USA):
Součástí tohoto zařízení může být CR baterie nebo akumulátor. CR baterie nebo akumulátor obsahuje chloristanový materiál a manipulace s nimi může vyžadovat speciální postupy. Viz <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.
- Akumulátory a baterie neotevírejte, nerozmačkávejte ani v nich nevytvářejte proděravění, toto počínání by mohlo způsobit zranění.
- Baterie nespalujte. Baterie uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od ohně i jiných zdrojů extrémního tepla. Vystavování baterií extrémním tepelným účinkům (teplotám nad 80 °C) by mohlo mít za následek výbuch nebo zranění osob.
- Baterii chraňte před pádem, nárazy nebo jinými způsoby násilného zacházení, jelikož následkem takového počínání by mohlo dojít k uvolnění obsahu článků, který je žíravý a výbušný.
- Nezkratujte svorky baterie. Zkrat může způsobit zranění a závažné poškození akumulátoru, který se pak stane nepoužitelným.
- Nevystavujte akumulátor nebo baterii vlhkosti ani dešti; mohlo by to mít za následek zasažení elektrickým proudem.
- K nabíjení akumulátorů OmniScan X3 použijte výhradně externí nabíječkou schválenou společností Evident.
- Používejte pouze akumulátory a baterie dodané společností Evident.

- Neskladujte akumulátory, jejichž zbývající úroveň nabití je nižší než 40 %. Před uskladněním je baterie třeba nabít na úroveň odpovídající 40 % až 80 % jejich kapacity.
- Během uskladnění je třeba udržovat nabití akumulátorů na úrovni odpovídající 40–80 % jejich kapacity.
- Během skladování zařízení neponechávejte akumulátor v jednotce OmniScan X3.

Nařízení týkající se odesílání produktů obsahujících lithium-iontové akumulátory a baterie

DŮLEŽITÉ

Při odesílání lithium-iontového akumulátoru nebo akumulátorů se ujistěte, že postupujete podle všech místních přepravních předpisů.



VAROVÁNÍ

Poškozené akumulátory nelze zasílat běžným způsobem – poškozené akumulátory společnosti Evident NEZASÍLEJTE. Kontaktujte místního zástupce společnosti Evident nebo odborníky v oblasti likvidace materiálu.

Likvidace zařízení, přístrojů a vybavení

Před likvidací OmniScan X3 se seznamte s místními zákony, předpisy a nařízeními a postupujte podle nich.

BC (Nabíječka akumulátorů – Kalifornie, USA)



Označení BC udává, že tento výrobek byl přezkoušen a splňuje požadavky Předpisů pro účinnost zařízení, jak je uvedeno v Kalifornské sbírce nařízení, část 20, oddíly 1601 až 1608 pro systémy nabíječek akumulátorů. Interní nabíječka akumulátorů, nacházející se uvnitř tohoto zařízení, byla zkoušena a certifikována podle požadavků California Energy Commission (CEC); toto zařízení je uvedeno v online databázi CEC (T20).

CE (Evropské společenství)



Toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí a směrnice 2015/863/EU doplňující směrnici 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek (RoHS). Označení CE je prohlášení o shodě tohoto výrobku se všemi platnými směrnicemi Evropského společenství.

UKCA (Spojené království)



Tento přístroj splňuje požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016, směrnice o (bezpečnosti) elektrických zařízení z roku 2016 a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012. Označení UKCA udává shodu s výše uvedenými směrnicemi.

RCM (Austrálie)



Štítek obsahující značku shody s předpisy (RCM) udává, že výrobek je ve shodě se všemi příslušnými normami a byl zaregistrován úřadem Australian Communications and Media Authority (ACMA) jako výrobek povolený k uvedení na australský trh.

Směrnice OEEZ



V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) tento symbol udává, že příslušný výrobek se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, nýbrž se musí odevzdávat ve sběrných místech jako tříděný odpad. Informace o způsobu odevzdávání vyřazených zařízení a/nebo o sběrných systémech dostupných ve vaší zemi vám poskytne příslušný místní distributor výrobků Evident.

Čínská směrnice RoHS

Čínská směrnice RoHS je pojem, který je v odvětví obecně používán tehdy, popisuje-li se legislativa realizovaná Ministerstvem informačního průmyslu (MII) v Čínské lidové republice v souvislosti s kontrolou znečišťování způsobovaného elektronickými informačními produkty (EIP).



Značka čínské směrnice RoHS udává dobu, po kterou je výrobek možno používat způsobem šetrným k životnímu prostředí (EFUP). Číslo EFUP je definováno jako počet roků, po který nebudou látky uvedené v seznamu kontrolovaných látek a obsažené ve výrobku unikat nebo se chemicky rozkládat. EFUP pro přístroj OmniScan X3 byla stanovena na 15 let.

Poznámka: Doba, po kterou je výrobek možno používat způsobem šetrným k životnímu prostředí (EFUP), nemá být chápána jako doba, po kterou je zajištěna funkčnost a výkonnost výrobku.



电器电子产品有害物质限制使用标志

本标志是根据“电器电子产品有害物质限制使用管理办法”以及“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”的规定，适用于在中国销售的电器电子产品上的电器电子产品有害物质使用限制标志。

（注意）电器电子产品有害物质限制使用标志内的数字为在正常的使用条件下有害物质等不泄漏的期限，不是保证产品功能性能的期间。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称		有害物质					
		铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主体	机构部件	×	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	电气部件	×	○	○	○	○	○
附件		×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

Korea Communications Commission (Korejská komunikační komise – KCC)



Prodejce i uživatel jsou tímto upozorněni na skutečnost, že tento přístroj je vhodný k použití jako kancelářské elektromagnetické zařízení (třídy A), tedy i k jinému než domácímu použití. Toto zařízení vyhovuje požadavkům na EMK platným v Koreji.

MSIP kód pro defektoskop OmniScan X3 je následující:
MSIP-R-R-OYN-OMNIX3.

Kód MSIP pro OmniScan X3 64 je následující: MSIP-R-R-OYN-OMNISCANX3-64.

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Shoda se směrnicí EMK (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)

Toto zařízení vytváří a používá vysokofrekvenční energii a není-li nainstalováno a používáno řádným způsobem (tedy v přísném souladu s pokyny výrobce), může způsobovat rušení. Přístroj OmniScan X3 byl testován a shledán jako vyhovující mezním hodnotám pro průmyslové zařízení v souladu s požadavky směrnice EMC.

Shoda s předpisy FCC (USA)

POZNÁMKA

Tento výrobek byl přezkoušen a shledán jako splňující mezní hodnoty stanovené pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto mezní hodnoty jsou stanoveny tak, aby výrobek poskytoval přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, je-li používán v komerčním prostředí. Tento výrobek vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalován a používán v souladu s návodem, mohl by způsobovat škodlivé rušení radiokomunikačních přenosů. Provoz tohoto výrobku v obytné oblasti bude pravděpodobně způsobovat škodlivé rušení. V takovém případě bude zapotřebí, abyste toto rušení odstranili na své vlastní náklady.

DŮLEŽITÉ

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za zajištění shody, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k používání výrobku.

Prohlášení dodavatele o shodě s FCC

Dodavatel tímto prohlašuje, že výrobek

Název výrobku: OmniScan X3

Model: OmniScan X3-MR/OmniScan X3-CW

Splňuje následující specifikace:

FCC část 15, hlava B, oddíl 15.107 a oddíl 15.109.

Doplňující informace:

Tento přístroj vyhovuje požadavkům části 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Tento přístroj musí být schopen snášet jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí funkci.

Jméno zodpovědné strany:

EVIDENT SCIENTIFIC, INC.

Adresa:

48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Telefon:

+1 781-419-3900

Shoda s normou ICES-001 (Kanada)

Tento digitální přístroj třídy A odpovídá kanadské směrnici ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

Informace o záruce

Společnost Evident ručí za to, že výrobek spol. Evident nebude po určenou dobu vykazovat materiálové a výrobní vady, a to v souladu s podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách společ. Evident, které naleznete na adrese <https://evidentscientific.com/evident-terms/>.

Záruka spol. Evident se vztahuje pouze na zařízení, které bylo používáno správným způsobem, podle popisu v tomto návodu k použití, které nebylo použito k jinému než určenému účelu a u něhož nedošlo k pokusu o neoprávněné opravy ani úpravy.

Při přijetí zásilky proveďte důkladnou prohlídku jejího obsahu se zaměřením na známky vnějšího nebo vnitřního poškození, ke kterému mohlo dojít během přepravy. O jakémkoli zjištěném poškození neprodleně uvědomte příslušného přepravce, protože za poškození vzniklé během přepravy obvykle nese odpovědnost právě přepravce. Uschovejte si obalové materiály, dodací listy a další přepravní dokumentaci, která je potřebná při případné reklamaci poškození. Po oznámení dopravci kontaktujte společnost Evident a požádejte případně o pomoc s reklamačním řízením a výměnou zařízení (je-li to nutné).

Tento návod k použití vysvětluje správný způsob používání výrobku Evident. Informace, které jsou zde obsaženy, jsou určeny výlučně k použití jako výuková pomůcka a při žádném konkrétním použití se nesmí používat bez nezávislého přezkoušení a/nebo ověření provozovatelem nebo odpovědným pracovníkem. Takové nezávislé ověření postupů nabývá na důležitosti se zvyšujícím se kritickým významem daného použití. Z těchto důvodů společnost Evident neposkytuje žádnou záruku, výslovnou ani předpokládanou, na to, že měřicí metody, příklady nebo procedury popsané v tomto dokumentu odpovídají průmyslovým standardům nebo že budou splňovat potřeby jakéhokoli konkrétního použití.

Společnost Evident si vyhrazuje právo na provedení úprav jakéhokoli výrobku, aniž by jí tím vznikla povinnost upravit také již dříve vyrobené výrobky.

Technická podpora

Společnost Evident považuje za svoji povinnost poskytovat nejvyšší úroveň zákaznických služeb a podpory. Setkáte-li se při používání našeho výrobku s jakýmikoliv potížemi nebo nefunguje-li tento výrobek tak, jak je popsáno v dokumentaci, nejprve nahlédněte do uživatelské příručky a poté, pokud nadále potřebujete pomoc, se obraťte na naše oddělení poprodejních služeb. Nejbližší servisní středisko můžete vyhledat na stránce Servisní střediska na webu spol. Evident Scientific <https://www.evidentscientific.com/service-and-support/service-centers/>.

Úvod

Společnost Evident má dlouhodobé vedoucí postavení v oblasti NDT testování. Tisíce jejích kontrolních zařízení jsou používány po celém světě. Nový phased array defektoskop OmniScan X3 nabízí technická vylepšení, která rozšiřují kontrolní možnosti v mnoha specializovaných oblastech užití.

Ultrazvukový phased array defektoskop OmniScan X3 a OmniScan X3 64, dále nazývaný OmniScan X3, pokud není uvedeno jinak.

POZNÁMKA

Informace o softwarových funkcích naleznete v *Uživatelské příručce softwaru OmniScan MXU*.

POZNÁMKA

Obrázky použité v této příručce byly připraveny s verzí přístroje, která byla dostupná v době vydání příručky, a mohou se mírně lišit od verze přístroje OmniScan X3, který používáte.

1. Obsah balení

Balení přístroje OmniScan X3 obsahuje následující položky:


- Defektoskop OmniScan X3
- Převážný kufřík
- Lithium-iontovou baterii (1)
- Ochranu displeje (1)
- Stejnoseměrný napájecí adaptér
- Napájecí kabel (model se liší podle země)
- Prázdný USB klíč pro přenos souborů
- Bezdrátový LAN dongle (model se liší dle země)
- USB klíč s nejnovější revizí softwaru OmniPC 5.x a uživatelskými manuály.
Obsahuje:
 - Software přístroje
 - *Příručku Začínáme s OmniScan X3 a OmniScan X3 64*
 - *Uživatelskou příručku pro OmniScan X3 a OmniScan X3 64*
 - *Uživatelskou příručku softwaru OmniScan MXU*

POZNÁMKA

Příklady typického příslušenství s čísly dílů naleznete v části „Příslušenství a náhradní díly“ na straně 81.

2. Přehled

Čelní panel defektoskopu OmniScan X3 obsahuje hlavní ovladače, tlačítka a ukazatele (Obrázek 2-1 na straně 27).

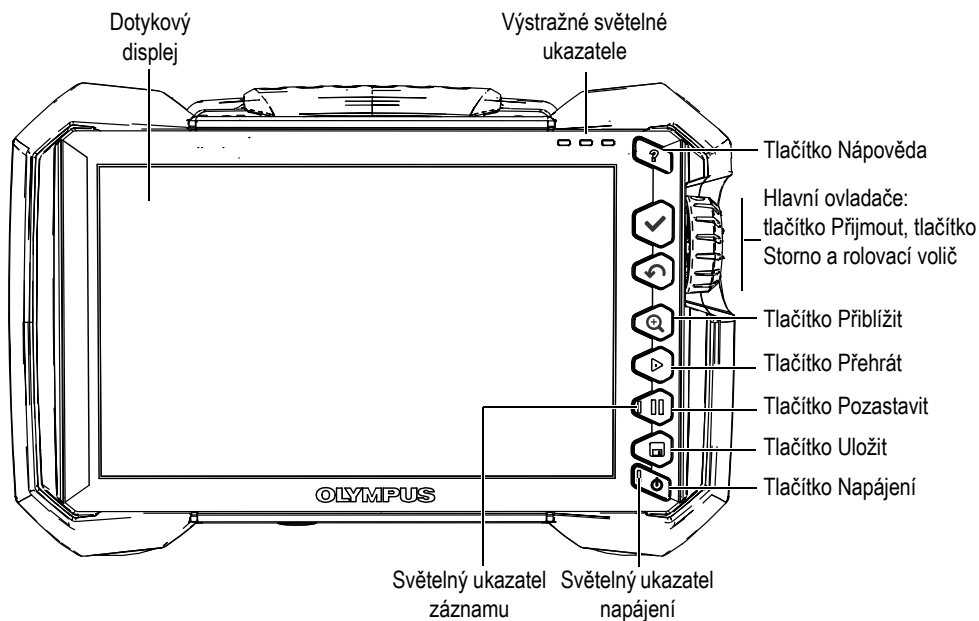

Obrázek 2-1 Ovladače na čelním panelu přístroje OmniScan X3




2.1 Dotykový displej

Dotykový displej se chová jako polohovací zařízení. Chcete-li vybrat prvek rozhraní, dotkněte se lehce prstem povrchu obrazovky. Rozšířené provozní pokyny týkající se dotykové obrazovky naleznete v *Uživatelské příručce softwaru OmniScan MXU*.


2.2 Hlavní ovládací prvky

Tři hlavní ovladače znázorněné v Tabulka 1 na straně 28 umožňují plný provoz softwaru OmniScan MXU.


Tabulka 1 Hlavní ovladače defektoskopu OmniScan X3

Obrázek	Název	Popis
	Rolovací volič	Pro volbu požadovaného softwarového tlačítka nebo změnu hodnoty parametru otáčejte rolovacím voličem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
	Tlačítko Přijmout	Pro aktivaci aktuálního výběru a přechod na další úroveň v hierarchii nabídky stiskněte tlačítko Přijmout. V poli alfanumerické hodnoty parametru stiskněte dvakrát tlačítko Přijmout (nebo dvakrát klepněte na parametr). Otevře se softwarová klávesnice.
	Tlačítko Storno	Pro zrušení aktuálního výběru a přesun zpět na předchozí úroveň v hierarchii nabídky stiskněte tlačítko Storno.





2.3 Tlačítko napájení

Tlačítko napájení () slouží ke spuštění nebo vypnutí defektoskopu OmniScan X3. Světelný ukazatel na tlačítku poskytuje informace o stavu napájení (viz „Světelný ukazatel napájení“ na straně 29).

2.4 Tlačítko Nápověda

Tlačítko Nápověda () je umístěno v pravé horní části čelního panelu přístroje OmniScan X3. Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte pomocné informace pro aktuálně zvolenou funkci, pokud jsou k dispozici.


2.5 Funkční klávesy

Tlačítka Přiblížit () , Přehrát () , Pozastavit () a Uložit () slouží k aktivaci konkrétních softwarových funkcí. Více informací je uvedeno v *Uživatelské příručce softwaru OmniScan MXU*.

2.6 Světelné ukazatele

Na čelním panelu defektoskopu OmniScan X3 se nachází tři typy světelných ukazatelů: napájení, záznam a výstraha. Níže je popsán každý světelný ukazatel.

2.6.1 Světelný ukazatel napájení

Světelný ukazatel napájení je umístěn na tlačítku Napájení () . Barva tohoto ukazatele označuje stav napájení přístroje OmniScan X3 (Tabulka 2 na straně 29).


Tabulka 2 Stavysvětelného ukazatele napájení

Světelný ukazatel	Stav
Vyp.	Přístroj OmniScan X3 je vypnutý.
Bliká oranžově	Přístroj OmniScan X3 je vypnutý. Baterie se nabíjí.

Tabulka 2 Stavysvětelného ukazatele napájení (pokračování)

Světelný ukazatel	Stav
Oranžová	Přístroj OmniScan X3 je vypnutý. Dobíjení baterie je dokončeno.
Zelená	<ul style="list-style-type: none"> Přístroj OmniScan X3 je zapnutý. Přístroj OmniScan X3 je zapnutý a baterie se nabíjí.
Bliká červeně	Některý z kritických faktorů (nadměrná teplota, velmi slabá baterie apod.) vyžaduje okamžitou pozornost.

2.6.2 Světelný ukazatel záznamu

Světelný ukazatel záznamu je umístěn na tlačítku Pozastavit () . Barva tohoto ukazatele označuje provozní stav defektoskopu OmniScan X3 (Tabulka 3 na straně 30).

Tabulka 3 Stavysvětelného ukazatele záznamu

Vyp.	Režim kontroly
Oranžová	Režim analýzy

2.6.3 Výstražné světelné ukazatele (alarmy)


V pravém horním rohu přístroje OmniScan X3 jsou umístěny tři výstražné světelné ukazatele. Tyto ukazatele blikají pouze jednou barvou (červená) a vyjadřují aktivační stav příslušných alarmů (softwarově nastavených).

POZNÁMKA

Více informací o tom, jak nastavit alarmy, které spouštějí výstražné světelné ukazatele, naleznete v *Uživatelské příručce softwaru OmniScan MXU*.

2.7 Levý boční panel

Levý boční panel defektoskopu OmniScan X3 (Obrázek 2-2 na straně 31) má dvířka, která umožňují přístup k bateriím, paměťové kartě a různým vstupním a výstupním portům.

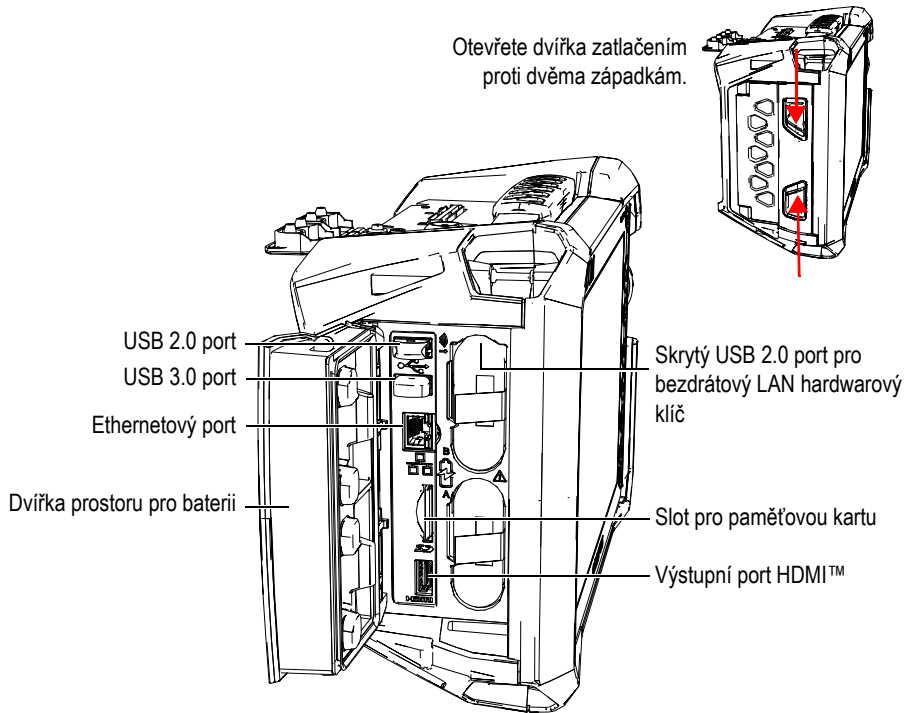

Obrázek 2-2 Levý boční panel přístroje OmniScan X3

Dvířka prostoru pro baterii

Tato dvířka poskytují přístup k bateriovému prostoru. Výměna baterií je popsána v části „Vyjmutí a vložení baterie“ na straně 46.

HDMI výstup

Defektoskop OmniScan X3 má zabudovanou HDMI konektivitu. K HDMI portu je možné připojit externí monitor, který bude zrcadlit displej přístroje OmniScan X3.

Slot pro paměťovou kartu

Slot pro vložení paměťové karty se zabezpečenou digitální vysokou kapacitou (SDHC).

Porty USB

Porty USB 2.0 a USB 3.0 pojmuou periferní zařízení, jako např. externí úložná zařízení nebo tiskárny.

POZNÁMKA

Pro zajištění kompatibility musí být karty SDHC a úložiště USB naformátovány na souborový systém FAT32 nebo NTFS.

Ethernetový port

Slouží k připojení přístroje OmniScan X3 k ethernetové síti.

Skrytý USB 2.0 port – pro bezdrátový LAN hardwarový klíč


Slouží k připojení hardwarového klíče pro získání přístupu k bezdrátové místní síti (WLAN). Bezdrátový LAN dongle je součástí standardní dodávky OmniScan X3. Přístup k portu získáte vyjmutím horní baterie, zatlačením proti krytu v horní části uvnitř prostoru pro baterie a jeho vytažením (Obrázek 2-3 na straně 32).



Obrázek 2-3 Zatlačte na kryt (*vlevo*) a vytáhněte skrytý port USB 2.0 (*vpravo*)

2.8 Pravý boční panel

Pravý boční panel defektoskopu OmniScan X3 (Obrázek 2-4 na straně 33) obsahuje konektor stejnosměrného napájecího adaptéru, který je chráněn pružným krytem. Konektor slouží k připojení externího stejnosměrného adaptéru napájení k přístroji OmniScan X3.

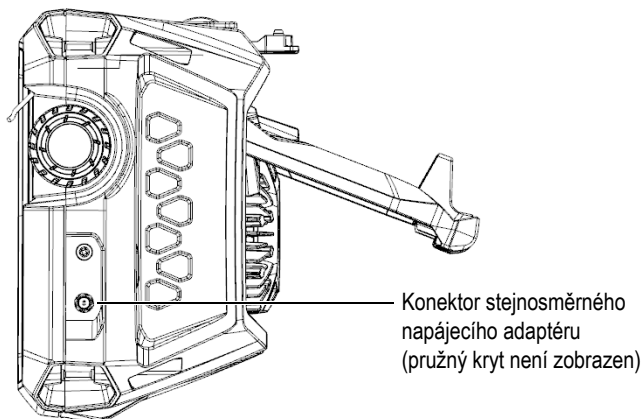

Obrázek 2-4 Pravý boční panel přístroje OmniScan X3

2.9 Horní panel



UPOZORNĚNÍ




- Nedotýkejte se vnitřního vodiče konektorů sondy, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Na vnitřním vodiči konektorů UT může být přítomno napětí až 350 V a na konektoru PA může být napětí až 120 V. Výstražný symbol v blízkosti konektorů PA a UT signalizuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Sondy připojené k defektoskopu OmniScan X3 musí být vybaveny zesílenou izolací.



UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo ke špatné funkci zařízení nebo jeho poškození, používejte pouze kompatibilní sondy Evident.

Horní panel přístroje OmniScan X3 obsahuje několik typů konektorů, viz Obrázek 2-5 na straně 34.

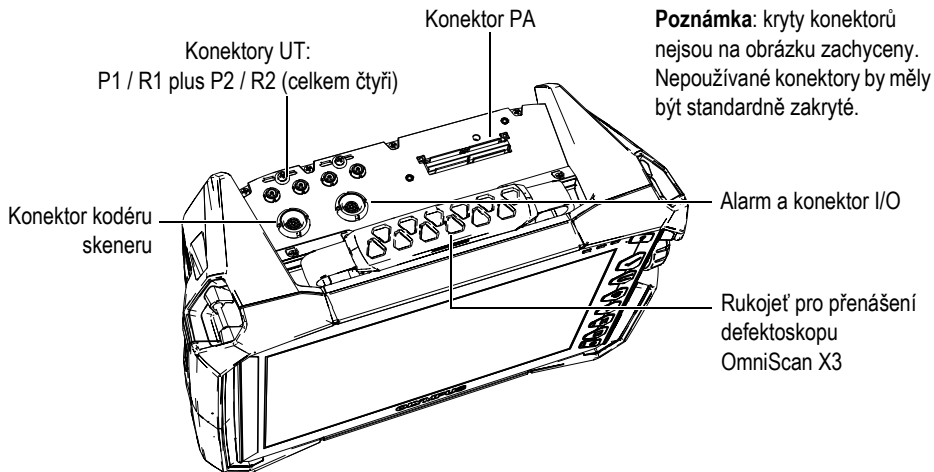

Obrázek 2-5 Horní panel přístroje OmniScan X3

Konektor přenosu a příjmu UT: P1 a P2

Konektor LEMO používaný pro vysílání ultrazvukových signálů při použití metody zkoušení pitch-catch. V pulzním režimu / režimu echo se P1 a P2 používají k vysílání a příjmu ultrazvukových signálů.

Konektor příjmu UT: R1 a R2

Konektor LEMO používaný pro příjem ultrazvukových signálů při použití metody zkoušení pitch-catch.

Alarm a konektor I/O

Konektor LEMO používaný pro připojení externího alarmu nebo přenos vstupních a výstupních signálů pro ostatní externí zařízení.


Konektor kodéru skeneru

Konektor LEMO používaný pro připojení skeneru vybaveného kodérem nebo přenos vstupních a výstupních signálů pro ostatní externí zařízení.

Konektor PA

Používá se k připojení sondy s technologií phased array a rozdělovače sondy nebo adaptéru.

Obrázek 2-6 na straně 35 zobrazuje konektory, které jsou kompatibilní s výše uvedenými.

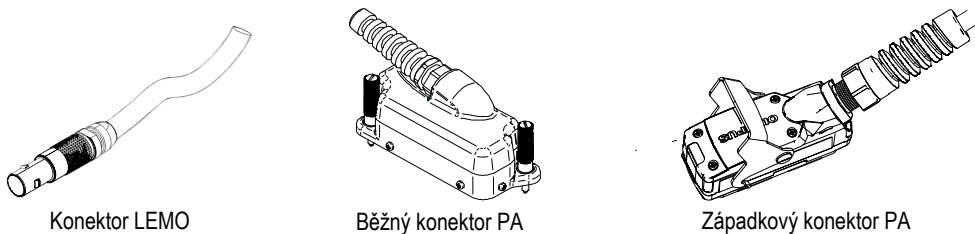

Obrázek 2-6 Konektor LEMO a konektor sondy PA


2.10 Zadní panel

Zadní panel obsahuje pasivní chladič s ventilátorem a opěrný stojan (Obrázek 2-7 na straně 36).



UPOZORNĚNÍ

Abyste zamezili nebezpečí špatného fungování přístroje nebo jeho poškození v důsledku přehřátí, nikdy nebraňte volnému pohybu vzduchu v oblasti kolem pasivního chladiče a ventilátoru. Nezakrývejte zadní část defektoskopu OmniScan X3 žádným předmětem, ani jej neumísťujte proti povrchu, který by mohl snížit pohyb vzduchu přes pasivní chladič nebo zablokovat ventilátor.

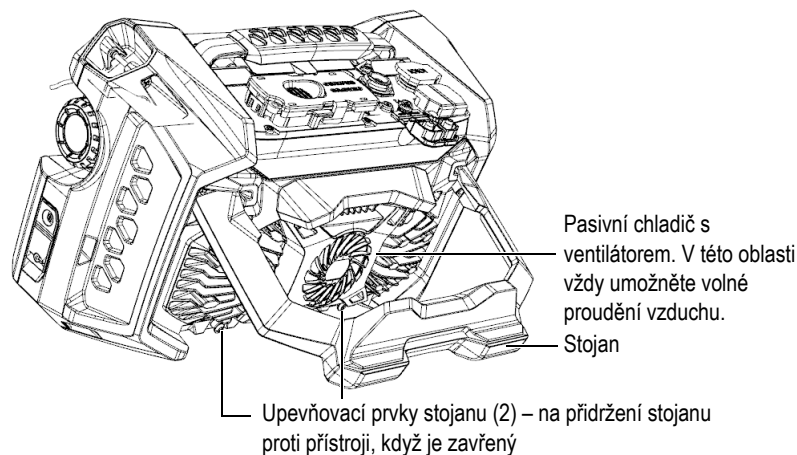

Obrázek 2-7 Zadní panel přístroje OmniScan X3




UPOZORNĚNÍ

- Aby nedošlo k přepadnutí přístroje OmniScan X3, když je podepřen na stole nebo podobném rovném povrchu, je potřeba zajistit, aby byl stojan otevřen v prostřední aretační poloze.
 - Nepoužívejte stojan jako rukojeť. Použitím stojanu jako rukojeti můžete poškodit přístroj nebo způsobit zranění osob.
-

2.11 Kotevní body postroje

Defektoskop OmniScan X3 má čtyři kotevní body pro připojení popruhů sloužících k jeho přenášení (Obrázek 2-8 na straně 37).

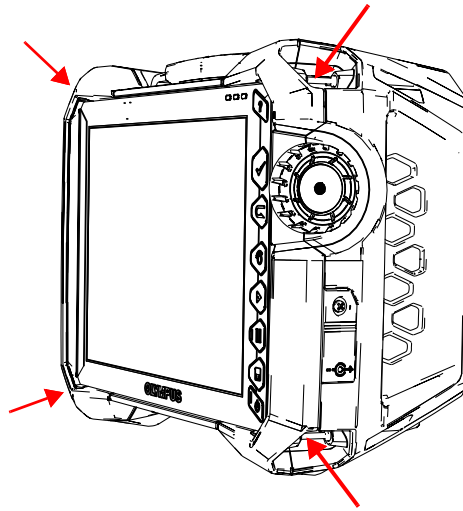

Obrázek 2-8 Čtyři kotevní body pro postroj

2.12 Speciální boční dvířka

Se speciálními bočními dvířky můžete používat kabely, když jsou dvířka zavřena a OmniScan X3 připojený k WeldSight (WeldSight Remote Connect). Můžete také připojit USB disk (30 cm USB prodloužení je součástí dvevní sady).

POZNÁMKA

Při použití dvířek pro zvláštní účely neplatí certifikace IP65.

POZNÁMKA


Speciální dveře nabízejí přiměřenou ochranu před předměty vnikajícími do OmniScan X3, ale nabízejí pouze minimální ochranu před deštěm nebo vodou. Chcete-li používat OmniScan X3 ve vlhkých nebo extrémních podmínkách, společnost Evident doporučuje používat standardní (utěsněné) dveře, které jsou součástí každého OmniScanu X3.

Montáž volitelných speciálních dvířek

K sestavení volitelných speciálních dvířek budete potřebovat křížový šroubovák.


Jak sestavit dvířka

1. Otevřete dvířka přihrádky na levém bočním panelu OmniScan X3 a pomocí křížového šroubováku odšroubujte čtyři šrouby a sejměte dvířka přihrádky (Obrázek 2-9 na straně 38).

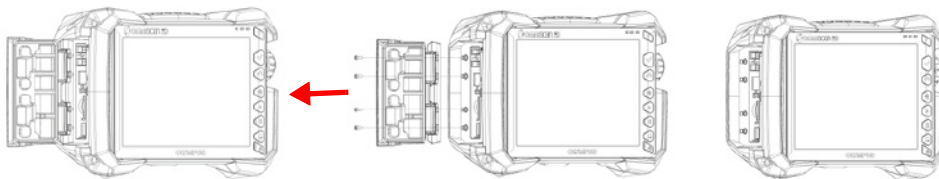


Obrázek 2-9 Odstranění dveří přihrádky

2. Připojte prodlužovací kabel Ethernet, USB a/nebo HDMI do příslušného portu (Obrázek 2-10 na straně 38).

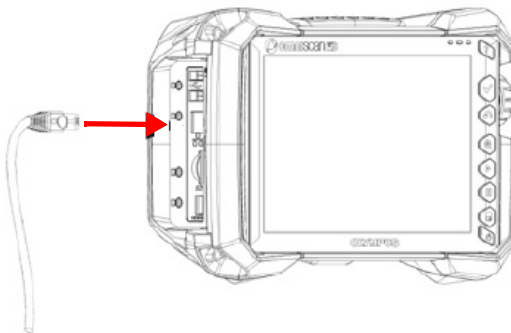


Obrázek 2-10 Zasunutí kabelu do jeho portu

3. Ujistěte se, že jsou kabely zarovnané ve štěrbině speciálních dvířek a posuňte dvířka dolů. (Obrázek 2-11 na straně 39).

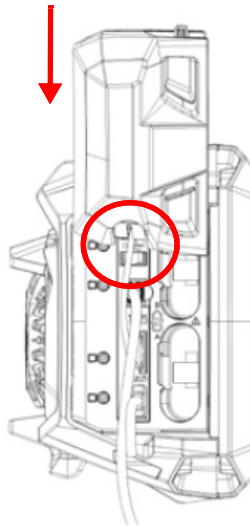

Obrázek 2-11 Posunutí dvířek přes zarovnané kabely

4. Zajistěte speciální dvířka bezpečně na místě (Obrázek 2-12 na straně 40).

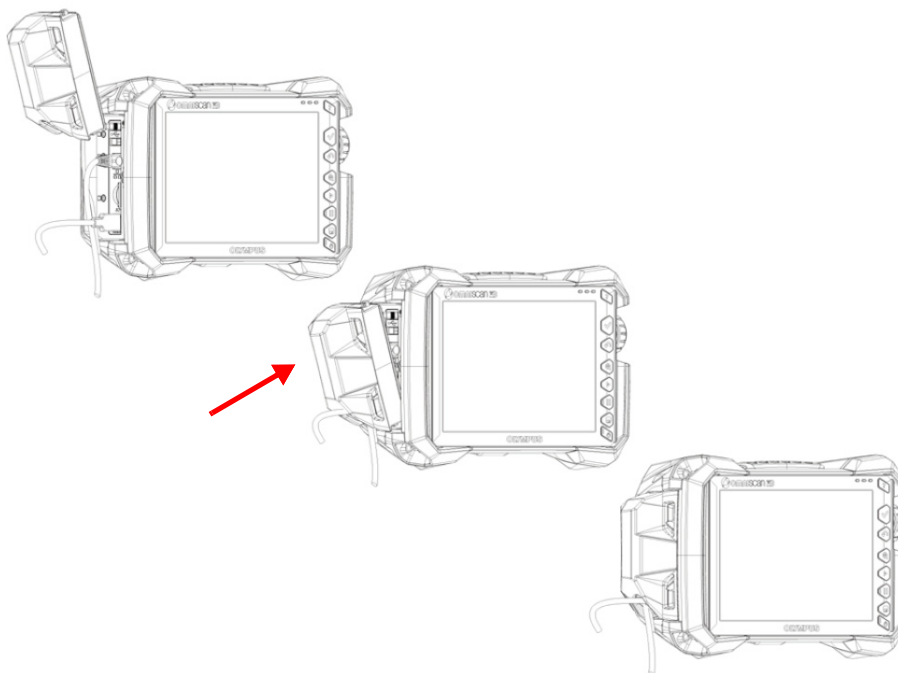

Obrázek 2-12 Zablokování speciálních dvířek na místě


3. Základní provoz

Tato kapitola popisuje základní principy a postupy pro provoz defektoskopu OmniScan X3.

3.1 Zapnutí a vypnutí přístroje OmniScan X3

V tomto oddíle je popsáno, jak zapnout a vypnout defektoskop OmniScan X3. Software MXU přístroje OmniScan se automaticky vypne, jakmile je vypnut defektoskop OmniScan X3.

Zapnutí přístroje OmniScan X3


1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení () po dobu jedné sekundy. Systém je spuštěn, provede kontrolu paměti a objeví se úvodní obrazovka.

POZNÁMKA

Pokud systém během spouštění detekuje problém, světelný ukazatel napájení zobrazí povahu problému pomocí barev (podrobnosti viz „Světelný ukazatel napájení“ na straně 29).

2. Klepněte na požadovanou aplikaci, kterou chcete spustit, případně nakonfigurujte připojení např. vyměnitelné jednotky, bezdrátové sítě nebo cloudu.

Vypnutí přístroje OmniScan X3

1. Krátce stiskněte tlačítko Napájení (.

2. Pro vypnutí defektoskopu OmniScan X3 klepněte v potvrzovacím okně na tlačítko **Vypnout**.


DŮLEŽITÉ

Pokud přístroj OmniScan X3 po krátkém stisknutí tlačítka napájení (nebo po volbě **Vypnout**) nereaguje, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu minimálně pěti vteřin. Tím spustíte vypínací sekvenci. Vaše nastavení ale NEBUDE uloženo.


**UPOZORNĚNÍ**

Nikdy nevypínejte přístroj OmniScan X3 odpojením všech zdrojů napájení. Takovýto způsob vypnutí by mohl mít negativní vliv na opětovné spuštění přístroje.

3.2 Aktivace automatického režimu spuštění

Defektoskop OmniScan X3 je vybaven funkcí automatického zavedení systému, která je také označována jako režim automatického bootování. Režim automatického bootování použijte k vzdálenému spuštění jednotky OmniScan X3. Je-li tento režim zapnut, není nutné pro spuštění přístroje OmniScan X3 stisknout tlačítko napájení () . Přístroj OmniScan X3 je automaticky spuštěn, když je připojen ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru. Tento režim je standardně vypnut.

Aktivace automatického režimu spuštění

1. Vypněte defektoskop OmniScan X3, vyjměte baterie a poté odpojte stejnosměrný napájecí adaptér.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení () .
3. Přístroj OmniScan X3 připojte ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
4. Počkejte, až světelný ukazatel vypínače dvakrát blikne, a potom uvolněte tlačítko napájení.
5. Chcete-li deaktivovat režim automatického bootování, opakujte kroky 1 až 4.

3.3 Provoz při střídavém napájení

Defektoskop OmniScan X3 můžete provozovat za použití střídavého napájení pomocí stejnosměrného napájecího adaptéru (obj. č.: OMNI-A-AC [U8767093]). OMNI-A-AC má univerzální vstup střídavého napětí, který pracuje s jakýmkoliv napětím od 100 VAC do 120 VAC nebo od 200 VAC do 240 VAC, při frekvenci 50 Hz až 60 Hz.



VAROVÁNÍ

Abyste zamezili nebezpečí úrazu nebo poškození zařízení, používejte stejnosměrný napájecí adaptér pouze v interiéru.


Provoz při střídavém napájení

1. Připojte napájecí kabel pro střídavý proud ke stejnosměrného napájecímu adaptéru (obj. č.: OMNI-A-AC [U8767093]) a vhodné zásuvce.
-




UPOZORNĚNÍ

- Abyste zamezili nebezpečí úrazu osob nebo poškození zařízení, používejte pouze síťový stejnosměrný napájecí kabel, který byl dodán s přístrojem OmniScan X3. Nepoužívejte napájecí šňůru pro střídavé napětí k napájení dalších zařízení.
 - Přístroj OmniScan X3 je nutno připojovat pouze k takovému zdroji elektrického napájení, který odpovídá údajům na typovém štítku přístroje. Proto používejte pouze stejnosměrný napájecí adaptér, který je dodáván s přístrojem OmniScan X3.
-
2. Na pravé straně přístroje OmniScan X3 zdvihněte pružný gumový kryt, abyste získali přístup ke konektoru stejnosměrného napájecího adaptéru (Obrázek 3-1 na straně 44).

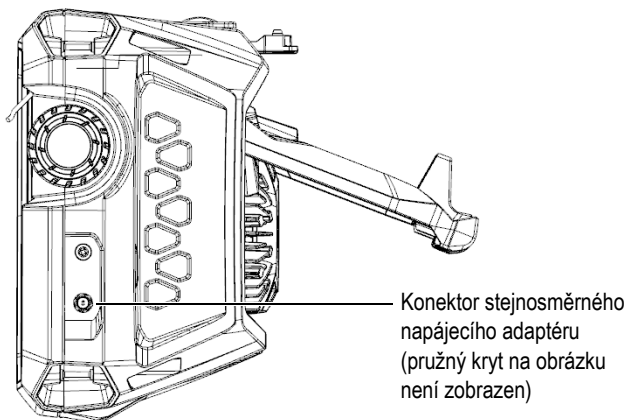

Obrázek 3-1 Konektor stejnosměrného napájecího adaptéru

3. Připojte stejnosměrný napájecí adaptér ke konektoru na přístroji OmniScan X3.
4. Přístroj OmniScan X3 spustíte stisknutím tlačítka napájení ().

3.4 Lithium-iontová baterie

Defektoskop OmniScan X3 obsahuje dvě lithium-iontové baterie (obj. č.: OMNI-A-BATT [U8760010]). Lithium-iontové baterie lze vložit a vyjmout bez vypnutí přístroje OmniScan X3, pokud zůstane připojený k jinému vhodnému zdroji napájení (stejnosměrný napájecí adaptér).

Přístroj OmniScan X3 také obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii, kterou uživatel nemusí vyjímat ani vyměňovat. Knoflíková baterie v přístroji zajišťuje hodiny s reálným časem.




UPOZORNĚNÍ

Abyste zamezili nebezpečí úrazu a/nebo poškození zařízení, používejte v zařízení OmniScan X3 pouze baterie Evident (obj. č.: OMNI-A-BATT [U8760010]).

3.4.1 Indikátory stavu baterií

Ukazatele stavu baterií v horní části displeje označují množství zbývající energie v bateriích:

- Vedle indikátorů se zobrazuje procento zbývající energie. Defektoskop OmniScan X3 musí být zapnutý přibližně po dobu 15 minut, teprve poté je schopen tyto informace správně zobrazit.
- Délka proužku ukazatele stavu baterií představuje přibližné množství zbývající energie v každé baterii (například 70 % ).


DŮLEŽITÉ

Maximální okolní teplota pro vybíjení baterií přístroje OmniScan X3 je 45 °C (maximální provozní teplota přístroje OmniScan X3).

POZNÁMKA

Pokud se pokusíte zapnout přístroj OmniScan X3 a jedna nebo obě baterie mají příliš málo energie k provozu, světelný indikátor napájení bude rychle červeně blikat po dobu přibližně tří sekund. Abyste mohli přístroj OmniScan X3 používat, vyměňte baterii či baterie, nebo připojte stejnosměrný napájecí adaptér.

Obrázek 3-2 na straně 46 uvádí informace týkající se variant ukazatele stavu nabití.

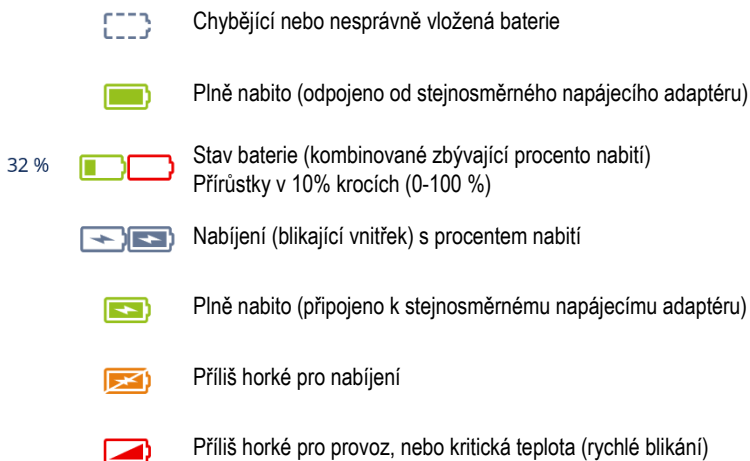


Obrázek 3-2 Variace indikátoru baterií

3.4.2 Vyjmutí a vložení baterie

Jak vyjmout a vložit baterii

1. Zatlačením na dvě západky na levém bočním panelu otevřete dvířka prostoru pro baterie.
2. Zatlačte baterii směrem dovnitř, zatáhněte směrem doleva za poutko baterie a vyjměte baterii (Obrázek 3-3 na straně 47).

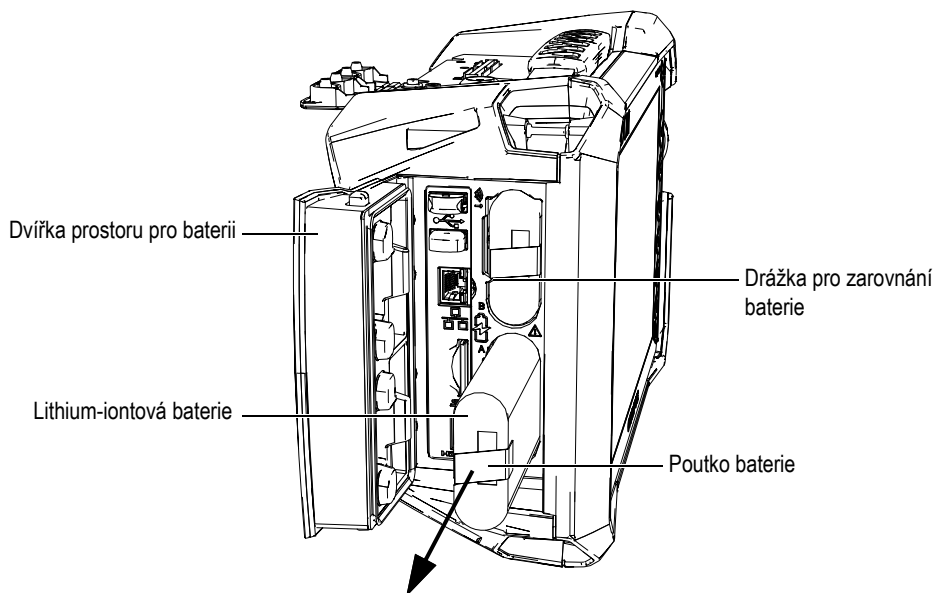

Obrázek 3-3 Vyjmutí lithium-iontové baterie

3. Zarovnejte drážku na nové baterii s tlačítkem v prostoru pro baterie, zatlačte baterii do prostoru až na konec a poté zatáhněte směrem doprava a zajistěte ji.
4. Zavřete dvířka bateriového prostoru.

Po zavření dvířek se ujistěte, že jsou obě západky zajištěny.

Je-li OmniScan X3 připojen ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru, dochází k nabíjení baterie uvnitř přístroje. Připojení adaptéru zahájí automaticky proces nabíjení. Baterie lze nabít pomocí volitelné externí nabíječky (obj. č.: OMNI-A-CHRG [U8767077]).

3.4.3 Nabíjení baterie

DŮLEŽITÉ

Maximální teplota okolí pro nabíjení přístroje OmniScan X3 je 30 °C. Pokud je teplota vyšší, baterie se nebude nabíjet, ačkoliv defektoskop OmniScan X3 je možné provozovat při maximální teplotě prostředí do 45 °C.

**VAROVÁNÍ**

Stejnoseměrný napájecí adaptér OmniScan X3 (obj. č.: OMNI-A-AC [U8767093]) je určen pouze pro napájení přístroje OmniScan X3 a nabíjení lithium-iontových baterií (obj. č.: OMNI-A-BATT [U8760010]). Nenabíjejte žádný jiný typ baterií, ani nepoužívejte jiné nabíječky/adaptéry (s výjimkou zařízení doporučených společností Evident - například volitelné externí nabíječky obj. č.: OMNI-A-CHRG [U8767077]). V opačném případě hrozí riziko výbuchu či poranění. Stejnoseměrný napájecí adaptér (obj. č.: OMNI-A-AC [U8767093]) ani externí nabíječku (obj. č.: OMNI-A-CHRG [U8767077]) nepoužívejte k napájení nebo nabíjení jiných elektronických zařízení, pokud není v příručce výslovně uvedeno jinak. Nesprávné použití stejnosměrného napájecího adaptéru nebo externí nabíječky může způsobit explozi jiných baterií a/nebo přístrojů, což může vést k závažným zraněním nebo úmrtí.

DŮLEŽITÉ

Lithium-iontové baterie nejsou při dodání přístroje OmniScan X3 plně nabity. Před jejich použitím pro provoz přístroje OmniScan X3 je nutné baterie nabíjet po dobu dvou až tří hodin.

Jak nabít baterii

- ◆ Připojte defektoskop OmniScan X3 k stejnosměrnému napájecímu adaptéru, který je připojen k vhodnému střídavému zdroji napájení.
NEBO
Vložte baterii do volitelné externí nabíječky (obj. č.: OMNI-A-CHRG [U8767077]), která je připojena ke vhodnému zdroji střídavého napájení.
-

Nabíjení baterie v defektoskopu OmniScan X3 se provádí následovně:

- Když je přístroj OmniScan X3 vypnutý:

Pokud je přístroj OmniScan X3 připojený ke vhodnému stejnosměrnému zdroji napájení a je vypnutý, baterie se bude automaticky nabíjet.

Během nabíjení baterie bliká světelný ukazatel napájení. Po skončení nabíjení začne světelný ukazatel napájení svítit nepřerušovaným oranžovým světlem. Úplné nabití baterie ze zcela vybitého stavu (méně než 5 % energie) může trvat až 3 hodiny.

- Když je přístroj OmniScan X3 zapnutý:

Pokud je přístroj OmniScan X3 v provozu a je připojen ke vhodnému stejnosměrnému zdroji napájení, baterie se bude automaticky nabíjet. Světelný ukazatel napájení svítí během nabíjení zeleně (v zapnutém stavu).

Protože je přístroj OmniScan X3 zapnutý, je k dispozici méně energie pro nabíjení baterie. Proto může nabíjení úplně vybité baterie trvat až 8 hodin. Pro více informací o stavech nabíjení baterií viz „Indikátory stavu baterií“ na straně 45.

3.4.4 Skladování baterií a prodloužení životnosti

Tento oddíl popisuje péči o lithium-iontové baterie a jejich údržbu.

Jak uchovávat baterie

1. Vybijte, nabijte a skladujte podle následujícího postupu:

- ◆ Před opětovným nabíjením vybijte baterii provozem přístroje OmniScan X3 v režimu napájení na baterie tak dlouho, dokud se přístroj nevypne, případně dokud se neobjeví výstražné upozornění na přílišné vybití baterie. Nenechávejte baterii dlouhou dobu mimo provoz. Společnost Evident doporučuje používat baterii alespoň jednou za dva až tři týdny. Pokud není baterie delší dobu používána, proveďte kroky uvedené v části „Jak prodloužit životnost baterií“ na straně 50.

Pokud neplánujete přístroj OmniScan X3 používat po dobu tří nebo více týdnů, nabijte baterii na úroveň mezi 40 % a 80 % kapacity (tři nebo čtyři proužky na ukazateli nabití na baterii) a potom baterii vyjměte a uskladněte na čistém, chladném a suchém místě).

POZNÁMKA

I když je přístroj OmniScan X3 vypnutý a odpojený, odebírá malé množství energie z baterie, čímž může při pokojové teplotě (25 °C) úplně vybit baterii za zhruba 3 měsíce.

2. Zkontrolujte zbývající energii všech skladovaných baterií zhruba jednou za měsíc, abyste se ujistili, že jim zbývá 40 % až 80 % kapacity, a v případě potřeby je nabíjete. Je to nezbytné, protože lithium-iontové baterie se v průběhu času samy vybíjejí. Pokud tak neučiníte a energie v baterii klesne pod kritickou úroveň (méně než 1 %), může dojít k trvalému poškození baterie.
3. Když se chystáte použít baterii, která byla po nějakou dobu skladována, vždy ji před použitím nabíjete.

Jak prodloužit životnost baterií

1. Vždy, když koupíte novou nabíjecí lithium-iontovou baterii, použijte ji v přístroji OmniScan X3 čtyřikrát až osmkrát za sebou, a ujistěte se, že ji při každém použití úplně vybijete a následně zcela nabijete. Tímto způsobem dosáhne baterie svojí maximální kapacity a zajistí maximální dobu provozu přístroje.
2. Po prvních 10 až 15 obdobích běžného používání (nebo po dvou až třech týdnech) doporučujeme baterii úplně vybit a nabít, abyste zachovali její dobu provozu a maximalizovali její životnost.

POZNÁMKA

Časté přepínání z externího zdroje na stejnosměrné napájení z baterie a naopak může mít za následek zkrácení životnosti baterie, protože počet cyklů nabití/vybití je omezený (cca 300 cyklů). I částečné vybití a nabití baterie představuje jeden cyklus.

3. Pro maximalizaci životnosti baterie vždy vybijte baterii provozem přístroje OmniScan X3 natolik, až dojde k vypnutí přístroje, nebo až se objeví výstražné upozornění, že baterie je příliš vybitá. Pro kratší dobu nabíjení nabíjete baterii v přístroji OmniScan X3, když je vypnutý, nebo nabíjení proved'te pomocí volitelné externí nabíječky (tlačítko **Překalibrovat**).

3.4.5 Likvidace použité baterie

Ačkoliv lithium-iontové baterie neobsahují žádné látky nebezpečné pro životní prostředí, jako např. olovo nebo kadmium, měly by být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Baterie zlikvidujte ve vybitém stavu, abyste předešli vzniku tepla, případně v souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Informace týkající se systému zpětného odběru nebo sběrných dvorů dostupných ve vaší zemi získáte od místního distributora společnosti Evident. Také viz „Nařízení týkající se odesílání produktů obsahujících lithium-iontové akumulátory a baterie“ na straně 15.

3.4.6 Výstrahy týkající se použití baterie

Pozorně si přečtěte a dodržujte následující pokyny týkající se použití baterie.



VAROVÁNÍ

- Baterie neotevírejte, nerozmačkávejte ani nedrťte; toto počínání by mohlo způsobit zranění osob.
- Baterie nespalujte. Baterie uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od ohně i jiných zdrojů extrémního tepla. Vystavování baterií extrémním tepelným účinkům (teplotám nad 80 °C) by mohlo mít za následek výbuch nebo zranění osob.
- Akumulátor chraňte před pádem, nárazy nebo jinými způsoby násilného zacházení, jelikož následkem takového počínání by mohlo dojít k uvolnění obsahu článků, který je žíravý a výbušný.
- Nezkratujte svorky baterie. Zkrat může způsobit zranění a závažné poškození baterie, která se pak stane nepoužitelnou.
- Nevystavujte akumulátor vlhkosti ani působení deště – může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pro nabíjení baterií používejte pouze nabíječku defektoskopu OmniScan X3 nebo externí nabíječku baterií schválenou společností Evident.
- Nedobíjejte baterii dříve, než když se po stlačení tlačítka kontroly kapacity na baterii rozsvítí kontrolka. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci.
- Neskladujte baterie, jejichž zbývající úroveň nabití je menší než 40 %. Před uskladněním je baterie třeba nabít na úroveň odpovídající 40 % až 80 % jejich kapacity.
- Během uskladnění je třeba udržovat nabití baterií na úrovni odpovídající 40 % a 80 % jejich kapacity.

- Během skladování přístroje OmniScan X3 v něm nenechávejte vložené baterie.
-

3.5 Software

Defektoskop OmniScan X3 používá software OmniScan MXU, který může být pravidelně aktualizován. Více informací je uvedeno v *Uživatelské příručce softwaru OmniScan MXU*. Aktuální verzi softwaru MXU si můžete stáhnout na adrese EvidentScientific.com.

3.6 Globální polohový systém (GPS)

Defektoskop OmniScan X3 má zabudovaný systém GPS, který poskytuje zeměpisné souřadnice (polohu) přístroje. Systém GPS je automaticky aktivován, když je přístroj OmniScan X3 zapnut. Po zapnutí přístroje OmniScan X3 může získání souřadnic trvat až dvě minuty.

POZNÁMKA

Funkce GPS není k dispozici ve všech zemích. Další informace vám poskytne místní zástupce společnosti Evident.

4. Údržba a řešení problémů

Defektoskop OmniScan X3 vyžaduje pouze minimální údržbu, která zajistí, aby zůstal v dobrém fyzickém a provozním stavu.

4.1 Preventivní údržba

Přístroj OmniScan X3 nemá žádné pohyblivé části, proto vyžaduje pouze minimální preventivní údržbu. Pro udržení přístroje OmniScan X3 v bezvadném stavu stačí provádět pravidelné kontroly. Opatrně otřete jakýkoliv prach, který se usadí na ventilátoru. Pokud je ventilátor poškozen nebo nefunguje správně, je možné jeho součásti vyměnit. Ochrannou fólii dotykového displeje lze vyměnit, pokud je příliš znečištěná nebo poškozená. Následující část podrobně popisuje postup údržby.

4.2 Čištění přístroje

Vnější povrchy defektoskopu OmniScan X3 je možné podle potřeby čistit. Tento oddíl popisuje postup čištění přístroje.

4.2.1 Čištění pouzdra

Jak čistit pouzdro

1. Ujistěte se, že je defektoskop OmniScan X3 vypnutý a je odpojen napájecí kabel.
2. Odpojte všechny kabely a konektory a ujistěte se, že všechny externí porty a konektory (včetně konektoru sondy PA) na přístroji OmniScan X3 jsou zakryty příslušnými krytkami.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka bateriového prostoru řádně uzavřena.

4. Pro obnovení původního vzhledu čistěte pouzdro přístroje měkkým hadříkem.
5. Potřebujete-li odstranit odolné skvrny, které ulpěly na povrchu, použijte hadřík navlhčený v jemném mýdlovém roztoku. Nepoužívejte abrazivní přípravky ani silná rozpouštědla, která by mohla povrch poškodit.
6. Pokud jste dokončili čištění a ochranné prvky konektorů jsou vyjmuty, ujistěte se před připojením konektorů, že jsou konektory suché. Pokud jsou vlhké, opatrně je osušte nebo je nechte oschnout.

4.2.2 Čištění obrazovky a ochranné fólie

K čištění dotykové obrazovky a ochranné fólie obrazovky přístroje OmniScan X3 nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo silná rozpouštědla. Dotykovou obrazovku a ochrannou fólii očistěte vlhkým hadříkem navlhčeným ve standardním čističi na sklo, který se pak vypaří. V případě nutnosti odstraňte zbytky papíru jemným štětečkem.

4.2.3 Čištění nebo výměna ventilátoru

Pokud je ventilátor znečištěný nebo nefunguje správně, může docházet k přehřátí defektoskopu OmniScan X3.

Jak čistit nebo vyměnit ventilátor


1. Prověřte přítomnost prachu či nečistot v otvorech ventilátoru a opatrně je ofoukněte pomocí stlačeného vzduchu z vnější části krytu (maximální tlak 207 kPa), ale nefoukejte přímo do otvoru pro kabel v krytu ventilátoru (Obrázek 4-1 na straně 55).



UPOZORNĚNÍ


Aby nedošlo k poškození těsnění přístroje, nefoukejte stlačený vzduch přímo do otvoru pro kabel v krytu ventilátoru.

Pozor na tento otvor pro kabel
(za krytem, který není
znázorněn na tomto obrázku,
aby bylo lépe možné zachytit
polohu otvoru)

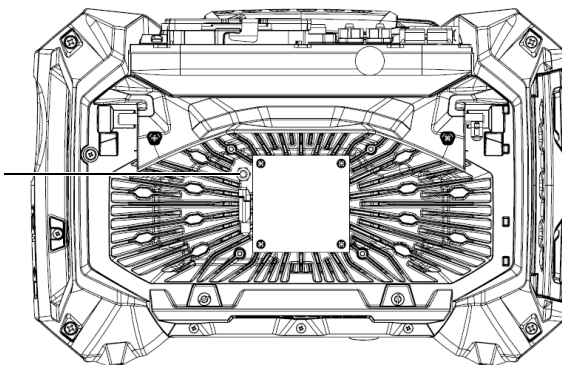



Obrázek 4-1 Vnitřní část chladičho ventilátoru (kryt odstraněn kvůli zobrazení otvoru pro kabel)

2. Pokud není možné ventilátor očistit z vnější část krytu nebo pokud potřebuje servis, demontujte kryt ventilátoru, v případě potřeby i ventilátor, a opatrně očistěte potřebné povrchy částí (Obrázek 4-2 na straně 56).
3. Pokud je ventilátor poškozený nebo nefunguje správně, opatrně odpojte kabel (Obrázek 4-3 na straně 56) a vyměňte ventilátor za nový.
4. Pokud byl kabel ventilátoru odpojen nebo přesunut, ujistěte se, že je řádně připojen a umístěn pro opětovné sestavení (Obrázek 4-3 na straně 56).
5. Díly sestavte v opačném pořadí a všechny šrouby dostatečně utáhněte.

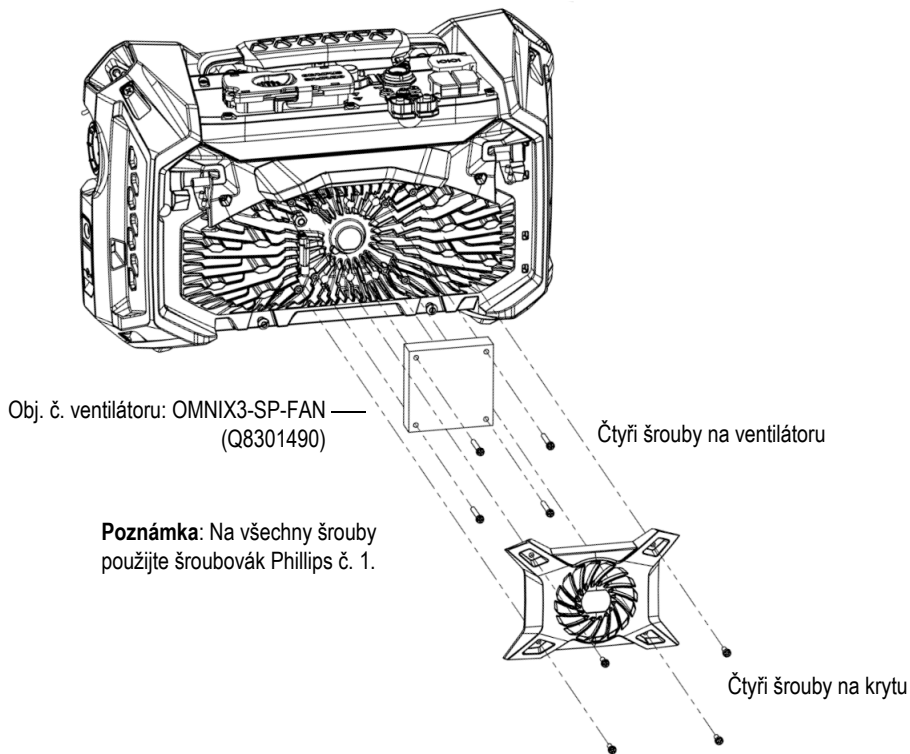

Obrázek 4-2 Sestavení ventilátoru a krycích částí

K vytažení poutka použijte plochý šroubovák, pak odpojte kabel.

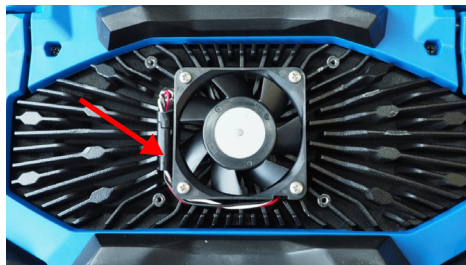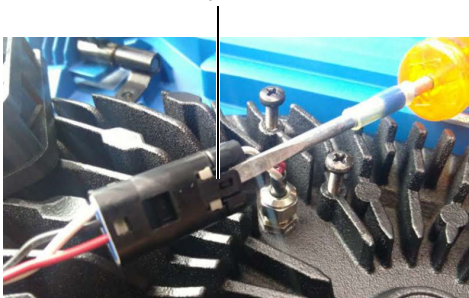

Obrázek 4-3 Odpojení kabelu ventilátoru (vlevo) a konečné umístění (vpravo)

4.3 Výměna ochranné fólie displeje

Tato část popisuje výměnu ochranné fólie dotykového displeje.

Jak vyměnit ochrannou fólii displeje

1. Odstraňte veškerý prach a nečistoty z dotykové obrazovky (prach a nečistoty způsobují vzduchové bubliny, které se objeví na ochranné fólii). Viz „Čištění obrazovky a ochranné fólie“ na straně 54.

PORADA

K odstranění prachových částic, které mohou být usazeny na dotykové obrazovce a ochranné fólii, použijte stlačený vzduch.

2. Odstraňte štítek označený č. 1 a odloupněte ochranný film na zadní straně.

POZNÁMKA


Po odstranění ochranného filmu ze zadní části ochranné fólie obrazovky se nedotýkejte zadní části této fólie. Pokud tak učiníte, mohou na ní zůstat otisky prstů.

3. Přiložte ochrannou fólii do správné polohy na obrazovku a pomalými pohyby ji upevněte.
4. Odstraňte štítek označený č. 2, a odloupněte film z přední strany. Není-li pod fólií žádný prach, všechny malé bubliny zmizí během 48 hodin.

4.4 Řešení problémů

Tabulka 4 na straně 58 uvádí seznam problémů, které se mohou během provozu objevit, a stanovuje možné příčiny a navrhovaná řešení. Předpokládá se, že defektoskop OmniScan X3 nebyl upravován a že je používán pouze s kabely a konektory, které byly poskytnuty a zdokumentovány společností Evident.

Tabulka 4 Průvodce řešením problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Defektoskop OmniScan X3 nelze spustit.	Stejnoseměrný napájecí konektor	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen k přístroji OmniScan X3 a zasunut do elektrické zásuvky se správným napětím. Používejte pouze adaptér dodaný s přístrojem OmniScan X3.
	Připojení baterie nebo nabíjení	Zajistěte, aby baterie byla nabitá alespoň na 10 % kapacity a byla správně vložena do bateriového prostoru.
	Stisknutí tlačítka napájení ()	Stiskněte tlačítko napájení a podržte ho stisknuté po dobu tří vteřin nebo déle.
Baterie přístroje OmniScan X3 se nenabíjí.	Nekompatibilní baterie	Zajistěte, aby model baterie použitý v přístroji OmniScan X3 byl kompatibilní s modelem doporučeným společností Evident. Nekompatibilní baterie mohou sice přístroj napájet, ale nabíjecí protokol je nemusí rozpoznat.
	Připojení stejnosměrného napájecího adaptéru	Zajistěte, aby byl stejnosměrný napájecí adaptér správně připojen.
	Nabíjení	Dobijte baterii pomocí externí nabíječky. Baterie se nabíjí mnohem rychleji, když je přístroj OmniScan X3 mimo provoz. V případě, že je spotřeba energie příliš vysoká, se bude baterie dobíjet jen velmi pomalu nebo vůbec.
	Zvýšená teplota	Vypněte přístroj OmniScan X3 a počkejte, dokud nevychladne. Nabíjení baterie se zastaví, pokud teplota baterie nebo vnitřní teplota systému bude příliš vysoká. Tento stav bude zobrazen na ukazateli stavu baterií (pro více informací viz „Indikátory stavu baterií“ na straně 45). Zkontrolujte, zda ventilátor přístroje funguje správně, a v případě potřeby jej vyčistěte nebo vyměňte (viz „Čištění nebo výměna ventilátoru“ na straně 54).

Tabulka 4 Průvodce řešením problémů (pokračování)

Problém	Možná příčina	Řešení
Nízká životnost baterie (nevydrží jako dříve)	Vybití baterie před nabíjením	Baterii před nabíjením zcela vybijte – prodloužíte tím její životnost.
	Baterie vyžaduje dobití	Baterii dobijte jednou za měsíc pomocí externí nabíječky (tlačítko Překalibrovat), podle pokynů v části „Skladování baterií a prodloužení životnosti“ na straně 49. Přestože lithium-iontová baterie přístroje OmniScan X3 netrpí „paměťovým efektem“ běžně ovlivňujícím jiné typy baterií, měla by být nabita, aby byla zachována optimální účinnost.
	Konfigurace přístroje	Ověřte aktuální konfiguraci. Existuje jedna možnost nebo kombinace možností, které způsobují, že baterie se vybijí příliš rychle. Mezi takové možnosti patří nastavení jasu, úrovně napětí a rychlost sběru dat.

5. Technické parametry

Tato kapitola popisuje všeobecné specifikace defektoskopu OmniScan X3 včetně akustických, záznamových a technických specifikací záznamových konektorů.

5.1 Všeobecné specifikace

Obecné specifikace jsou uvedeny v Tabulka 5 na straně 61.

Tabulka 5 OmniScan X3 všeobecné specifikace

Pouzdro přístroje	
Velikost (šířka x výška x hloubka)	335 mm × 221 mm × 151 mm
Hmotnost	5,7 kg [s jednou vloženou baterií]
Podmínky použitelnosti v okolním prostředí	
Provozní teplota	-10 až 45 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C (s vloženou baterií) -20 °C až 70 °C (bez baterie)
Relativní vlhkost (RH)	Max. 70% relativní vlhkost při 45 °C, bez kondenzace
Nadmořská výška	Až 2000 m
Venkovní použití	Ano: je třeba použít energii baterie, dvířka musí být zavřená, konektory musí být zakryté nebo připojené.
Krytí IP	S certifikací IP65
Tepelný šok	Standard MIL-STD 810G metoda 503.5 procedura I-C, obrázek 503.5-3
Náhodné vibrace	Standard MIL-STD 810G metoda 514.6 procedura I, kategorie 7

Tabulka 5 OmniScan X3 všeobecné specifikace (pokračování)

Sinusové vibrace (test volného nákladu)	Standard MIL-STD 810G metoda 514.6 procedura II, kategorie 5
Mechanický šok	Modifikovaná MIL-STD 810G metoda 516.6 procedura I: zrychlení 15 g namísto trvání 11 ms
Pokles při přenosu	Standard MIL-STD 810G metoda 516.6 procedura IV, tabulka 516.6-VI
Úroveň znečištění	2
Instalační kategorie	II
Baterie	
Model baterie	OMNI-A-BATT (U8760010)
Typ baterie	Inteligentní lithium-iontová baterie
Počet baterií	2
Skladovací teplota baterie	-20 °C až 60 °C při 80% relativní vlhkosti
Doba nabíjení baterie	Běžně 3 hodiny na baterii, v závislosti na okolní teplotě (max. 30 °C), za použití interní nabíječky nebo volitelné externí nabíječky
Životnost baterie	5 hodin nepřetržitého provozu přístroje za použití dvou baterií
Velikost	Přibližně 214 mm × 58,7 mm × 21,9 mm
Externí stejnosměrné napájení (stejnosměrný napájecí adaptér)	
Vstupní stejnosměrné napětí	15 Vss. až 18 Vss. (min. 50 W)
Konektor	Kruhový, průměr kolíku 2,5 mm, na středu kladný pól
Model	OMNI-A-AC (U8767093)
Displej	
Velikost displeje (úhlopříčka)	269 mm
Rozlišení	1 280 × 768 pixelů
Počet barev	16 miliónů
Typ	Odporová dotyková obrazovka TFT LCD
Pozorovací úhly	Horizontální: -85° až 85° Vertikální: -85° až 85°
Datové úložiště	
Externí zařízení pro ukládání dat	Podporuje standardní úložiště USB, SDHC a SDXC. Podporuje zařízení naformátovaná na souborový systém FAT32 nebo NTFS.

Tabulka 5 OmniScan X3 všeobecné specifikace (pokračování)

Maximální velikost datového souboru	25 GB
Palubní úložiště	SSD Drive, 64 GB (OmniScan X3) nebo 1 TB (OmniScan X3 64).
Porty I/O	
Porty USB	Dva porty USB 2.0 (jeden skrytý za baterií) Jeden port USB 3.0
Video výstup	Video výstup (HDMI)
Paměťová karta	Port SDHC
Komunikace	Ethernet
Linky I/O	
Vstupy kodéru	Aktuálně podporovány 2 osy (kvadratura nebo hodiny/směr) Možnost třetího kodéru (budoucí rozšíření)
Digitální vstup	6 digitálních vstupů, TTL
Digitální výstup	5 digitálních výstupů, TTL
Spínač pro aktivaci/deaktivaci záznamu dat	Pomocí konfigurace digitálního vstupu
Výstup napájení	5 V nominální, 1 A (chráněno proti zkratu) a 12 V výstup při 1 A (chráněno proti zkratu)


5.2 Specifikace konektoru záznamu



UPOZORNĚNÍ



- Nedotýkejte se vnitřního vodiče konektorů LEMO, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Na vnitřním vodiči konektorů UT může být přítomno napětí až 350 V a na konektoru PA může být napětí až 120 V. Výstražný symbol v blízkosti konektorů LEMO signalizuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem (Obrázek 5-1 na straně 64).
- Sondy připojené k přístroji musí být vybaveny zesílenou izolací.

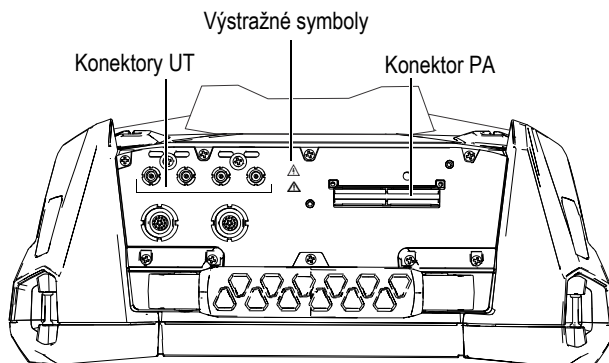

Obrázek 5-1 Záznamové konektory

Když je kanál UT jediným použitým kanálem, zakryjte konektor PA krytem, abyste jej ochránili před vniknutím nečistot a vody.

POZNÁMKA

Před použitím sondy s technologií phased array, která není vybavena západkovým konektorem PA (zachyceno na Obrázek 2-6 na straně 35), vyjměte kotevní základnu, jež je zajištěna pomocí dvou šroubů.

5.2.1 Akustické specifikace

Tento oddíl uvádí akustické specifikace pulzátoru, přijímače a formování paprsku, jak pro režim UT, tak pro režim PA (Tabulka 6 na straně 64 a Tabulka 7 na straně 65).

Tabulka 6 Akustické specifikace – kanál UT používající konektor UT

Certifikace	
Kalibrační certifikace	ISO 22232
Generátor impulzů	
Napětí	85 V, 155 V a 295 V
Šířka impulzu	Nastavitelná od 30 ns do 1000 ns, rozlišení po 2,5 ns

Tabulka 6 Akustické specifikace – kanál UT používající konektor UT

Doba poklesu	<10 ns
Tvar impulzu	Negativní čtvercový puls
Výstupní impedance	<30 Ω
Přijímač	
Rozsah zesílení	0 dB až 120 dB, maximální vstupní signál 30 V _{p-p} (při plné výšce obrazovky)
Vstupní impedance	50 Ω v režimu odrazu (pulse-echo) 50 Ω v tandemovém režimu (pitch-catch)
Šířka pásma systému	0,25 MHz až 28,5 MHz

POZNÁMKA

Je-li u kanálu UT použita odrazová metoda, impulzy budou přítomny na konektoru P1 i R1. Pokud zvolíte odrazový režim, společnost Evident doporučuje použít na konektoru P1 pouze jednu sondu.

Tabulka 7 Akustické specifikace – kanál PA

	OmniScan X3	OmniScan X3 64
Certifikace		
Kalibrační certifikace	ISO 18563-1:2015	
Generátor impulzů		
Napětí	40 V, 80 V a 115 V	10 V _{pp} , 20 V _{pp} , 40 V _{pp} , 80 V _{pp} , 120 V _{pp} a 160 V _{pp}
Šířka impulzu	Nastavitelná od 30 ns do 500 ns, rozlišení po 2,5 ns	Nastavitelné od 30 ns do 1000 ns (polovina periody bipolárního pulzu nebo trvání záporného pulzu); rozlišení 5 ns
Doba poklesu	<10 ns	
Tvar impulzu	Negativní čtvercový puls	Bipolární negativní-pozitivní čtvercový puls, negativní čtvercový puls

Tabulka 7 Akustické specifikace – kanál PA (pokračování)

Výstupní impedance	28 Ω v pulse-echo 24 Ω v režimu pitch-catch	35 Ω
Přijímač		
Rozsah zesílení	0 dB až 80 dB, maximální vstupní signál 800 mVp-p (při plné výšce obrazovky).	0 dB až 80 dB, maximální vstupní signál 900 mVp-p (při plné výšce obrazovky).
Vstupní impedance	57 $\Omega \pm 10\%$ při frekvenci 9 MHz v ozvěně pulzu 100 $\Omega \pm 10\%$ při frekvenci 9 MHz v režimu pitch-catch	120 $\Omega \pm 10\%$ ve 13 MHz
Šířka pásma systému	0,5 MHz až 18 MHz	0,2 MHz až 26,5 MHz
Tvarování paprsku		
Typ skenování	Jednoduché, lineární, sektorové, složené a TFM (včetně FMC a AIM)	
Pulzní maximální clona	OMNIX3-PATFM1664PR = 16 elementů OMNIX3-PATFM16128PR = 16 elementů OMNIX3-PATFM32128PR = 32 elementů	OMNIX3-PATFM64128PR = 64 elementů
Celkový počet přijímacích elementů	OMNIX3-PATFM1664PR = 64 elementů OMNIX3-PATFM16128PR = 128 elementů OMNIX3-PATFM32128PR = 128 elementů	OMNIX3-PATFM64128PR = 128 elementů
Počet fokálních zákonů	Maximálně 1024 celkem (maximálně 512 na skupinu)	
Rozsah prodlevy při přenosu	0 μ s až 10 μ s v krocích po 2,5 ns	0 μ s až 10 μ s v krocích po 5 ns
Rozsah prodlevy při příjmu	0 μ s až 6.4 μ s v krocích po 2,5 ns	

5.2.2 Specifikace záznamu

Tento oddíl uvádí specifikace záznamu pro frekvenci, zobrazení dat a synchronizaci (Tabulka 8 na straně 67).

Tabulka 8 Specifikace záznamu

Frekvence	
Efektivní digitalizační frekvence	Až 100 MHz (16 bitů)
Maximální frekvence impulzů	Až 20 kHz
Displej	
Obnovovací frekvence	A-sken: 60 Hz; S-sken: 20 Hz do 30 Hz
Synchronizace	
Podle vnitřních hodin	1 Hz až 10 kHz
Na enkodéru	Na 2 osách: od 1 do 65 536 kroků

5.2.3 Specifikace dat

Tato část uvádí specifikace dat zpracování, TCG a TFM/FMC (viz Tabulka 9 na straně 67).

Tabulka 9 Specifikace dat

Zpracování	
Maximální počet datových bodů A-skenování	Až 16384
Průměrování v reálném čase	PA: 2, 4, 8, 16 UT: 2, 4, 8, 16, 32, 64
Usměrňování	RF, plná vlna, polovina vlny +, polovina vlny --

Tabulka 9 Specifikace dat (pokračování)

Filtrování	Kanál PA (OmniScan X3): 8 nízkopásmových, 6 pásmových a 4 širokopásmové filtry Kanál PA (OmniScan X3 64): 9 pásmových a 7 širokopásmových filtrů Kanál UT: 8 nízkopásmových, 6 pásmových a 4 širokopásmové filtry (3 dodatečné filtry při konfiguraci v TOFD)
Filtrování obrazového signálu	Vyhlazování (nastaveno podle frekvenčního rozsahu sondy)
Programovatelný TCG	
Počet datových bodů	32: Jedna křivka TCG (časově korigovaná zisková) na každé nastavení zaostření
Rozsah	PA: 40 dB v krocích po 0,1 dB UT: 100 dB v krocích po 0,1 dB
Maximální sklon	PA: 40 dB / 10 ns UT: 40 dB/10 ns
TFM/FMC	
Podporované režimy	Ozvěna pulzu: L-L, TT a TT-TT Vlastní tandemový: TT-T, LL-L, LT-T, TL-T, TT-L a TL-L
Paralelní multirežim TFM	4 simultánní skupiny TFM (sady vln)
Živé zpracování obálky	Ano
Maximální clona	64elementová clona pro 64:128PR Rozšířená clona s 64 elementy (pouze 32:128PR). Rozšířená clona s 32 elementy pro 16:64PR a 16:128PR Rozšířená clona se 128 elementy pro 64:128PR
Rozlišení snímku	Až 1024 × 1024 bodů [pro každou sadu vln TFM]

6. Reference konektorů



VAROVÁNÍ


Používejte výhradně zařízení a příslušenství, která vyhovují specifikacím společnosti Evident. Použitím nekompatibilního vybavení může dojít k poruše funkce, poškození vybavení nebo zranění osob.

Tato kapitola uvádí technický popis následujících dvou konektorů OmniScan X3:

- Konektor kodéru skeneru
- Alarm a konektor I/O

Pro oba konektory jsou k dispozici následující informace: stručný popis, výrobní číslo, číslo příslušného konektoru kabelu, obrázek a tabulka se schématem zapojení signálů na vývody konektoru.

Následující konektory OmniScan X3 splňují příslušné normy:

- SDHC (slot pro paměťovou kartu)
- Kruhový stejnosměrný napájecí konektor, 2,5 mm průměr kolíku, 15 VDC až 18 VDC (polarita: )
- USB 2.0 a USB 3.0
- Ethernet
- HDMI

6.1 Konektor kodéru skeneru

Popis


LEMO, 16-kolíkový kruhový konektor (samice)

Výrobce, číslo

LEMO, EEG.1K.316.CLL

Doporučený konektor kabelu

LEMO, FGG.1K.316.CLAC65Z



Obrázek 6-1 Konektor LEMO kodéru skeneru (kontaktní pohled)

Tabulka 10 Základní diagram pro konektor LEMO kodéru skeneru

Kolík	I/O	Signál	Popis
1			NC ^a
2	Výstup	+5 V	Externí napájení, 1 A ^b , +5 V
3	Vstup	DIN1	Digitální vstup 1, TTL
4	Vstup	DIN2	Digitální vstup 2, TTL
5	Vstup	DIN3	Digitální vstup 3, TTL
6	Vstup	DIN4	Digitální vstup 4, TTL
7	Výstup	DOUT1	Digitální výstup 1, ±20 mA, TTL
8	Výstup	DOUT2	Digitální výstup 2, ±20 mA, TTL

Tabulka 10 Základní diagram pro konektor LEMO kodéru skeneru (pokračování)

Kolík	I/O	Signál	Popis
9	Vstup	PhA1	Kodér 1 / Fáze A_CLK, TTL
10	Vstup	PhB1	Kodér 1 / Fáze B_DIR, TTL
11	Vstup	PhB2	Kodér 2 / Fáze B_DIR, TTL
12	Vstup	PhA2	Kodér 2 / Fáze A_CLK, TTL
13	Výstup	DOUT3	Digitální výstup 3, ± 20 mA, TTL
14	–	_c	–
15	–	_d	–
16	–	GND	Uzemnění

- a. NC = nepřipojeno.
- b. Sdíleno s alarmem a konektorem I/O.
- c. Rezervovaný pro budoucí použití
- d. Rezervovaný pro budoucí použití

6.2 Alarm a konektor I/O

Popis


LEMO, 14-kolíkový kruhový konektor (samice)

Výrobce, číslo

LEMO, HMA.1K.314.CLLP

Doporučený konektor kabelu

LEMO, FGA.1K.314.CLAC65Z



Obrázek 6-2 Konektor alarmu a LEMO I/O (kontaktní pohled)

Tabulka 11 Základní diagram pro alarm a konektor I/O

Kolík	I/O	Signál	Popis
1	-	NU ^a	-
2	-	NU	-
3	-	NU	-
4	-	NU	-
5	-	NU	-
6	-	NU	-
7	Výstup	5 V	Externí napájení 5 V, 1 A ^b
8	-	NU	-
9	-	NU	-
10	-	NC ^c	
11	-	NC	
12	-	NU	-
13	Výstup	12 V	Externí napájení 12 V, 1 A
14	-	GND	Uzemnění

- a. NU = není použito
b. Sdílené s konektorem kodéru.
c. NC = nepřipojeno.


7. Připojení k PC pomocí vzdáleného připojení WeldSight

Tato kapitola popisuje, jak připojit defektoskop OmniScan X3 k PC (vzdálené připojení WeldSight).

7.1 Spouštění vzdáleného připojení WeldSight

Provést před prvním spuštěním

1. Nainstalujte si WeldSight na váš počítač, pokud jste tak již neučinili. K získávání dat ve WeldSight je vyžadována licence WeldSight. S licencí WeldSight Analysis budete moci analyzovat pouze datové soubory získané na palubním softwaru MXU.
2. Nakonfigurujte síťovou kartu Ethernet na počítači s pevnou IP adresou.
 - a) Otevřete seznam síťových připojení v Ovládacích panelech Windows a identifikujte připojení použité k připojení k OmniScan X3. Najděte síť ethernetové karty, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte **Vlastnosti**.
 - b) Dvakrát klikněte na **TCP/IPv4** nastavení (Obrázek 7-1 na straně 74).

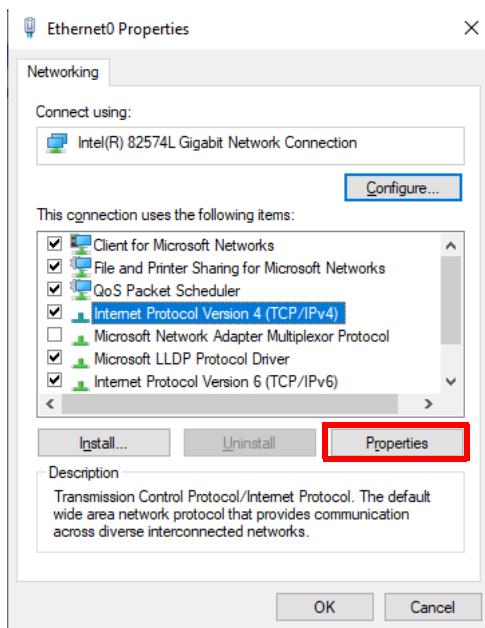

Obrázek 7-1 Dialogové okno Vlastnosti sítě Ethernet


- c) Zaškrtněte políčko **Použit následující IP adresu** a nastavte ji na:
- **IP adresa: 192.168.0.1**
 - **Maska podsítě: 255.255.255.0**
- d) Klikněte na **Ok** pro přijetí změn.

POZNÁMKA

IP adresa se může lišit od navrhované adresy, ale musí být ve stejné podsíti jako OmniScan X3. Výchozí IP adresa přístroje je **192.168.0.2**, ale pokud potřebujete použít jinou podsít, změňte ji v aplikaci pro vzdálené připojení WeldSight, v nastavení síťové karty a také ve WeldSight (nastavení přístroje).


- e) Pro optimální výkon, a aby nedošlo ke ztrátě dat, ve vlastnostech **Properties** stejné síťové karty klikněte na **Configure** (Obrázek 7-1 na straně 74), pak jděte do karty **Advanced**.

- V kartě **Advanced**, v odrážce **Properties** vyberte **Jumbo Packet** nebo **Jumbo Frames** a pak v odrážce **Value** změňte hodnotu na **9014 bajtů** (Obrázek 7-2 na straně 75).

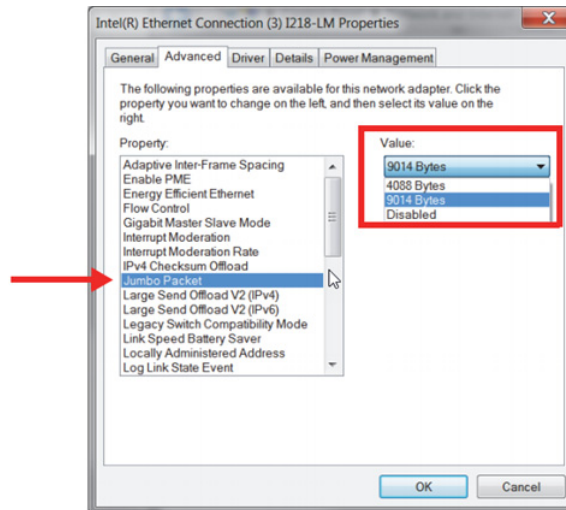




Obrázek 7-2 Nastavení Jumbo Packet

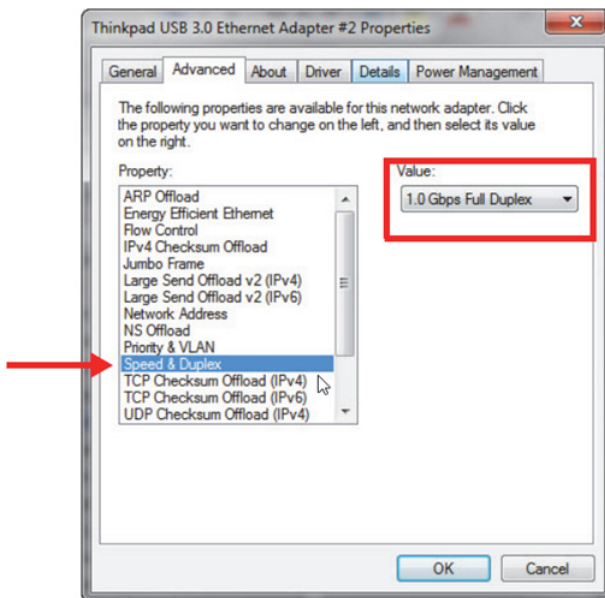- V kartě **Advanced** v odrážce **Properties**, vyberte **Speed & Duplex** a pak v odrážce **Value**, změňte hodnotu na **1.0 Gpbs plně duplexní** nebo **Automatické vyjednávání** (Obrázek 7-3 na straně 76).



Obrázek 7-3 Nastavení Speed & Duplex

- f) Na svém PC otevřete WeldSight  a dvakrát klikněte na ikonu  (Obrázek 7-4 na straně 77) umístěnou v pravém dolním rohu obrazovky. Klikněte na **Advanced Settings** a ujistěte se, že:
- Hodnota **IP adresy síťové karty** je také nastavena na **192.168.0.1**.
 - **Režim zjišťování zařízení** je nastaven na **Jedno zařízení**.

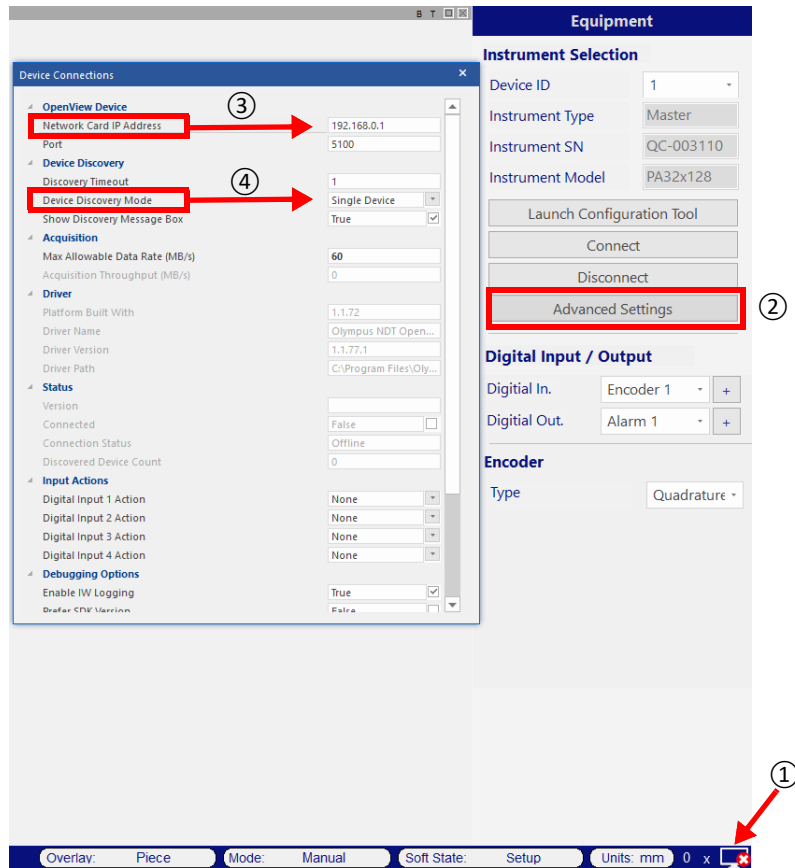

Obrázek 7-4 Konfigurace ve WeldSight


g) Když je vše nakonfigurováno, zavřete WeldSight.

7.2 Připojování OmniScan X3 k zařízení WeldSight

Připojit OmniScan X3 k zařízení WeldSight


1. Spusťte OmniScan X3.
2. Připojte ethernetový kabel mezi počítač a OmniScan X3. Kabel musí být minimálně CAT 5e.

3. Spusťte Vzdálené připojení WeldSight na OmniScan X3.
4. Spusťte aplikaci Vzdálené připojení WeldSight na OmniScan X3.
5. Stav Vzdáleného připojení WeldSight by měl přejít z **Nepřipraveno** do **Připraveno**, když OmniScan X3 detekuje platné připojení k PC (Obrázek 7-5 na straně 78).

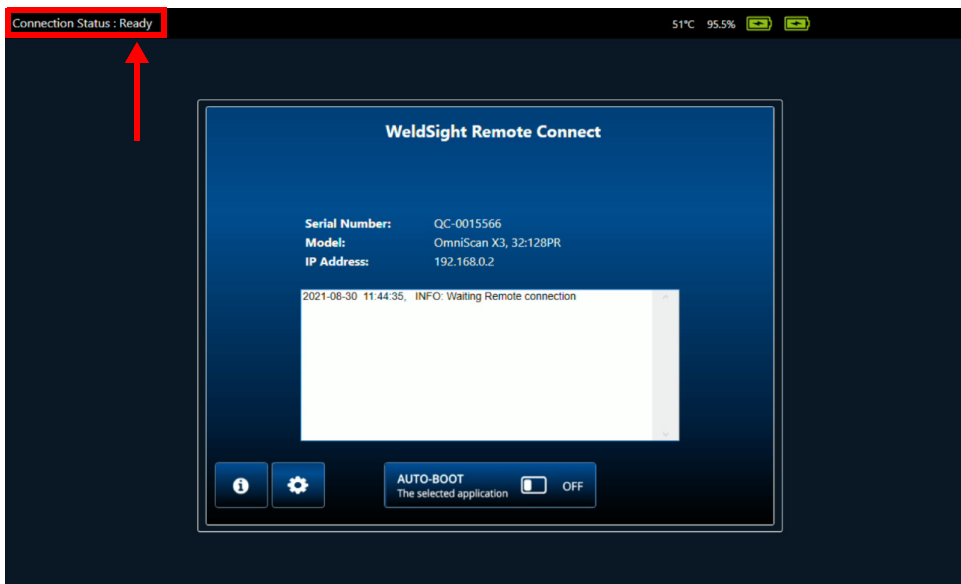


Obrázek 7-5 Stav připojení – Připraveno

6. Spusťte WeldSight na PC.
7. Pokud je vše správně nakonfigurováno, stav Vzdáleného připojení WeldSight by měl přejít z **Připraveno** na **Připojeno** (Obrázek 7-6 na straně 79).

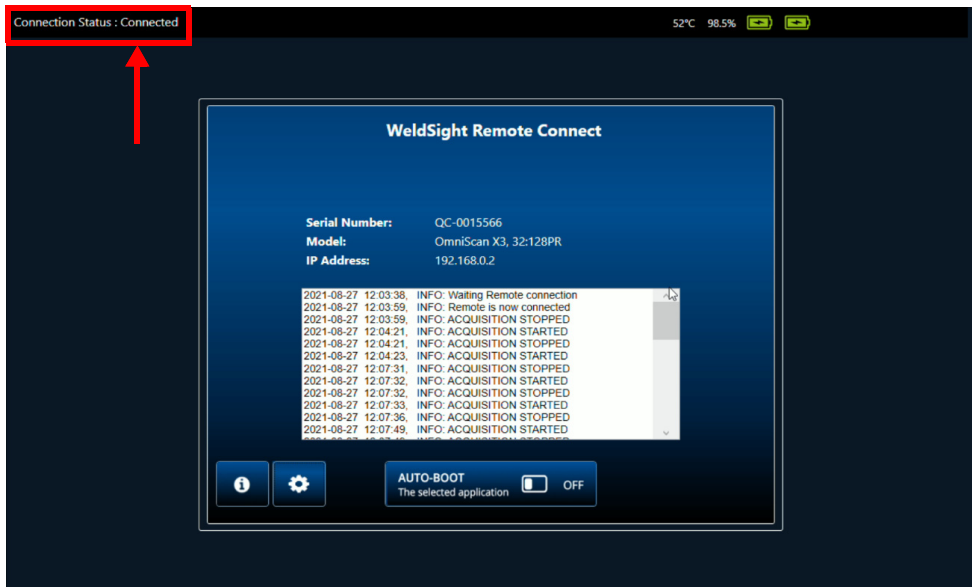

Obrázek 7-6 Stav připojení — Připojeno

Ikona PC v pravé dolní části obrazovky WeldSight by měla mít zelené zaškrtnutí .

Příloha: Příslušenství a náhradní díly

Tabulka 12 na straně 81 a Tabulka 13 na straně 82 uvádí typické příslušenství kompatibilní s defektoskopem OmniScan X3. Nejedná se však o úplný seznam, kompatibilní příslušenství není omezeno pouze na zde uvedené položky. Tabulka 14 na straně 83 uvádí seznam náhradních dílů přístroje OmniScan X3.

Tabulka 12 Volitelné položky (prodávají se samostatně na vyžádání)

Volitelná položka (marketingový kód)	Objednací číslo dílu	Popis
OMNI-A-BATT	U8760010	Lithium-Iontová baterie pro OmniScan MX / MX2 / SX / X3
OMNI-A-CHRG	U8767077	Externí nabíječka baterií
OMNIX3-A-SCREENPROTEC	Q7800069	Sada 5 antireflexních chráničů dotykové obrazovky pro Omniscan X3
OMNIX3-A-HCASE	Q7640011	Pevné přepravní pouzdro pro OmniScan X3
OMNIX3-A-SDCARD	Q7800068	Doporučená náhradní SDHC karta pro OmniScan X3
OMNIX3-A-USBKEY	Q7750166	Doporučený náhradní USB klíč pro OmniScan X3
OMNI-A-BST	U8780089	Zádový popruh pro OmniScan
PAPROBE-A-BASECAP	U8100138	Kryt konektoru sondy PA
60ND0001	U8840124	Ethernetový křížový kabel RJ45 (3 metry)
WELDSIGHT-A	Q1480003	Licenční klíč softwaru WeldSight Analysis (kompatibilní s datovými soubory z řady FOCUS PX a OmniScan X3). Zahrnuje pouze funkce analýzy dat. NEZAHHRNUJE funkce sběru dat. Dodává se s jedním pevným USB klíčem. V případě ztráty nejsou k dispozici ŽÁDNÉ náhradní klíče.

Tabulka 12 Volitelné položky (prodávají se samostatně na vyžádání) (pokračování)

Volitelná položka (marketingový kód)	Objednací číslo dílu	Popis
WELDSIGHTESBT-I	Q1480007	Licenční klíč softwaru WeldSight Inspection (kompatibilní se sériemi FOCUS PX a OmniScan X3). Zahrnuje funkce pro získávání a analýzu dat a licenci ES BeamTool. Dodává se se dvěma pevnými USB klíči (WeldSight-I a ESBeamTool). NEOBSAHUJE vyhrazený klíč pro analýzu. V případě ztráty nejsou k dispozici ŽÁDNÉ náhradní klíče.
OMNI-A-X3-SPDOOR	Q1000230	Speciální sada pro upgrade bočních dvířek řady OmniScan X3 – umožňuje použití kabelů, když jsou dvířka zavřena. Obsahuje: (1 pro každého) Speciální ochranná boční dvířka řady OmniScan X3 s prostorem pro příslušenství (1 pro každého) USB 3.0, 30 cm (1 stopa) prodloužení a (1 pro každého.) tištěné vizuální montážní pokyny. POZNÁMKA: Speciální dvířka nabízejí přiměřenou ochranu předmětům před vniknutím do OmniScan X3, ale nabízejí pouze minimální ochranu před deštěm nebo vodou. Pro použití OmniScan X3 ve vlhkých nebo extrémních podmínkách společnost Evident doporučuje používat standardní (utěsněná) dvířka, která jsou součástí každého OmniScanu X3.

Tabulka 13 Kompatibilní příslušenství

Příslušenství (prodejní kód)	Objednací číslo dílu	Popis
OMNI-A2-SPLIT128	U8100133	Adaptér „Y“ (splitter) pro konektory OmniScan na podporu dvou sond s technologií phased array s maximálně 64 elementy na 128kanálovém defektoskopu OmniScan X3.
OMNI-A2-SPLIT128-4UT	U8100134	Adaptér „Y“ (splitter) pro konektory OmniScan na podporu dvou sond s technologií phased array s maximálně 62 elementy a 4 kanály UT s konektory LEMO 00 na 128kanálovém defektoskopu OmniScan X3. Kanály UT jsou připojeny k elementům: 63, 64, 127, 128
OMNI-A2-ADP03	U8775202	Adaptér pro připojení sondy PA s konektorem Hypertronic k defektoskopu OmniScan X3 s konektorem OmniScan.

Tabulka 13 Kompatibilní příslušenství (pokračování)

Příslušenství (prodejní kód)	Objed- nací číslo dílu	Popis
EIB-T-8-M-5-OM	U8775086	Rozšíření a rozbočovače Interbox se dvěma konektory PA a dvěma páry konektorů TOFD, které používají zesilovač TRPP. K dispozici je několik modelů. Například kód příslušenství EIB-T-8-M-5-OM označuje následující charakteristiku: <ul style="list-style-type: none"> EIB: Rozšíření Interbox T: TRPP součástí či nikoliv (NT = ne, T = ano) 8: Počet konektorů UT M: Typ opláštění kabelu (P = PVC, M = kov) 5: Délka kabelu v metrech (0 = 0,5 m) OM: Konektor přístroje (OM = konektor OmniScan, HY = konektor Hypertronic)
EIB-NT-0-P-10-OM	U8779855	
E128P0-0202-OM	U8800635	Prodlužovací kabel s konektorem OmniScan na obou koncích. Může být vybaven čtyřmi konektory LEMO 00 umožňujícími současné použití běžných sond UT a PA s přístrojem PA. K dispozici je několik modelů. Například kód příslušenství E128P0-0202 OM označuje následující charakteristiku: <ul style="list-style-type: none"> E: Prodlužovací kabel 128: Počet elementů P: Typ opláštění kabelu (P = PVC, M = kov) 0: Délka kabelu v metrech (0 = 0,5 m) 0202: Konfigurace konektorů UT OM: Konektory OmniScan
E128P0-0004-OM	U8800429	
E128P5-0202-OM	U8800442	
E128P10-0004-OM	U8800431	
E128P10-0202-OM	U8800432	
OMNI-A2-ADP20	U8775201	Kabel s adaptérem kodéru skeneru pro připojení kabelů kodérů skeneru s konektorem DE15 k defektoskopu OmniScan X3, který má konektor kodéru skeneru LEMO.

Tabulka 14 Náhradní díly

Náhradní díl (prodejní kód)	Objed- nací číslo dílu	Popis
OMNIX3-SP-FAN	Q8301490	Ventilátor (bez krytu ventilátoru)
OMNIX3-SP-BATTERYDOOR	Q8301491	Dvířka bateriového prostoru

Tabulka 14 Náhradní díly (pokračování)

Náhradní díl (prodejní kód)	Objed- nací číslo dílu	Popis
OMNIX3-SP-STAND	Q8301492	Stojan
OMNIX3-SP-KNOB	Q8301493	Otočný volič (se stavěcím šroubem)
OMNIX3-SP-DUSTCAPS	Q8301494	Sada konektorových krytek, včetně šroubů a podložek (bez krytu konektoru PA)
PAPROBE-A-BASECAP	U8100138	Kryt konektoru sondy PA
OMNIX3-SP-HANDLE	Q8301495	Rukojeť pro přenášení defektoskopu OmniScan X3
OMNI-A-WIRELESS-NA	Q7670059	Bezdrátový LAN USB adaptér LM Technologies LM808-0407 pro USA a Kanadu
OMNI-A-WIRELESS-INTL	Q7670060	Bezdrátový LAN USB adaptér LM Technologies LM808-0407 pro jiné země než USA a Kanada

Seznam obrázků

Obrázek 2-1	Ovladače na čelním panelu přístroje OmniScan X3	27
Obrázek 2-2	Levý boční panel přístroje OmniScan X3	31
Obrázek 2-3	Zatlačte na kryt (<i>vlevo</i>) a vytáhněte skrytý port USB 2.0 (<i>vpravo</i>)	32
Obrázek 2-4	Pravý boční panel přístroje OmniScan X3	33
Obrázek 2-5	Horní panel přístroje OmniScan X3	34
Obrázek 2-6	Konektor LEMO a konektor sondy PA	35
Obrázek 2-7	Zadní panel přístroje OmniScan X3	36
Obrázek 2-8	Čtyři kotevní body pro postroj	37
Obrázek 2-9	Odstranění dveří přihrádky	38
Obrázek 2-10	Zasunutí kabelu do jeho portu	38
Obrázek 2-11	Posunutí dvířek přes zarovnané kabely	39
Obrázek 2-12	Zablokování speciálních dvířek na místě	40
Obrázek 3-1	Konektor stejnosměrného napájecího adaptéru	44
Obrázek 3-2	Variace indikátoru baterií	46
Obrázek 3-3	Vyjmutí lithium-iontové baterie	47
Obrázek 4-1	Vnitřní část chladicího ventilátoru (kryt odstraněn kvůli zobrazení otvoru pro kabel)	55
Obrázek 4-2	Sestavení ventilátoru a krycích částí	56
Obrázek 4-3	Odpojení kabelu ventilátoru (<i>vlevo</i>) a konečné umístění (<i>vpravo</i>)	56
Obrázek 5-1	Záznamové konektory	64
Obrázek 6-1	Konektor LEMO kodéru skeneru (kontaktní pohled)	70
Obrázek 6-2	Konektor alarmu a LEMO I/O (kontaktní pohled)	72
Obrázek 7-1	Dialogové okno Vlastnosti sítě Ethernet	74
Obrázek 7-2	Nastavení Jumbo Packet	75
Obrázek 7-3	Nastavení Speed & Duplex	76
Obrázek 7-4	Konfigurace ve WeldSight	77
Obrázek 7-5	Stav připojení — Připraveno	78
Obrázek 7-6	Stav připojení — Připojeno	79

Seznam tabulek

Tabulka 1	Hlavní ovladače defektoskopu OmniScan X3	28
Tabulka 2	Stavy světelného ukazatele napájení	29
Tabulka 3	Stavy světelného ukazatele záznamu	30
Tabulka 4	Průvodce řešením problémů	58
Tabulka 5	OmniScan X3 všeobecné specifikace	61
Tabulka 6	Akustické specifikace – kanál UT používající konektor UT	64
Tabulka 7	Akustické specifikace – kanál PA	65
Tabulka 8	Specifikace záznamu	67
Tabulka 9	Specifikace dat	67
Tabulka 10	Základní diagram pro konektor LEMO kodéru skeneru	70
Tabulka 11	Základní diagram pro alarm a konektor I/O	72
Tabulka 12	Volitelné položky (prodávají se samostatně na vyžádání)	81
Tabulka 13	Kompatibilní příslušenství	82
Tabulka 14	Náhradní díly	83

