

OLYMPUS

インストールマニュアル

PRECiV [Ver.1.1]

お願い

このたびは、PRECiV ソフトウェアをご購入いただき、ありがとうございます。

本ソフトウェアの性能を十分に活用していただくため、およびお客様の安全確保のため、ご使用前に必ずこのインストールマニュアルをお読みください。

本ソフトウェアインストール時には、本マニュアルを常に手元に置いていただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

目次

1. はじめに	1
2. 本ソフトウェアのインストール	4
2.1 インストーラーの起動	4
2.2 本ソフトウェアのアクティベーション	6
2.2.1 ソフトウェアをアクティベートする目的	6
2.2.2 アクティベートする方法	6
2.2.3 いくつかのソフトウェアをアクティベートするか	7
2.2.4 インターネットベースでの本ソフトウェアのアクティベーション	8
2.2.5 ファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション	9
2.2.6 コードベースでの本ソフトウェアのアクティベーション	14
2.3 インストール	18
2.3.1 本ソフトウェアのインストール	18
2.3.2 カメラの接続とドライバのインストール	21
2.4 本ソフトウェアのアップデート / アップグレード / ソリューション追加	22
2.4.1 アップデートのインストール	22
2.4.2 ソリューションの追加	22
2.4.3 デジタルチャートのインストール	23
2.5 本ソフトウェアのディアクティベーション	24
2.5.1 インターネットベースでのディアクティベーション	25
2.5.2 ファイルベースでの本ソフトウェアのディアクティベーション	26
2.5.3 コードベースでの本ソフトウェアのディアクティベーション	31
2.6 サービスのアップデート	35
2.6.1 サービスアップデートを表示してダウンロードする	35
2.6.2 サービスアップデートの有無を確認する	35
2.6.3 既にインストール済みのサービスアップデートを表示する	35
2.6.4 サービスアップデートのインストール (インターネットにアクセスできる場合)	35
2.6.5 サービスアップデートのインストール (インターネットにアクセスできない場合)	37
3. 本ソフトウェアの開始と設定	38
3.1 本ソフトウェアの開始	38
3.2 本ソフトウェアの設定	39
3.2.1 コード式または電動式の顕微鏡使用時の設定における前提条件	39
3.2.2 使用するハードウェアの指定	39
3.2.3 指定したハードウェアの設定	39
3.2.4 システムのキャリブレーション	40
3.2.5 システム復元ポイントを利用する	40
3.2.5.1 システム復元ポイントに保存される情報	41
3.2.5.2 システム復元ポイントを作成する	41
3.2.5.3 システム復元ポイントを使用して復元する	42
3.3 初の画像の取り込み	43
4. 本ソフトウェアのアンインストール	46
4.1 本ソフトウェアのアンインストール手順	46
4.1.1 本ソフトウェアのアンインストール	46
4.1.2 本ソフトウェアに同梱された DVD を使用できない場合	46
4.2 アンインストールに関する注意	48

5. インストール後のトラブルシューティング	49
5.1 アクティベーションに関する問題の解決手段	49
5.1.1 リペア機能	50
5.1.2 リカバリー機能	51
5.2 OSの異常起動後に行われるOS自動復旧	53
5.3 ユーザー権限の変更、ユーザーの追加および削除	54
5.4 PCの入れ替え、OSの再インストール時の推奨手順	55
6. 安全にご利用いただくための注意事項	56

本マニュアルの著作権は、オリンパス株式会社に帰属します。本マニュアルの内容の正確さや信頼性には多大な注意が払われております。しかし、オリンパス株式会社は、商品性、特定目的に対する適合性を含め、本マニュアルに関連するその他いかなる事柄を保証するものではありません。本マニュアルに記載されているソフトウェアの仕様は、将来購入者に予告なく変更することがあります。オリンパス株式会社は、本マニュアルの購入、使用、内容に起因する不注意、特に偶然に発生した損失や逸失利益等に責任を負いません。オリンパス株式会社の文書による明確な承諾を得ずに本マニュアルの内容の一部、あるいは全部を無断で電子・機械装置によって複写したり、書き写したり、情報記憶システムを作って複写・複製・転載することは禁じられています。

商標について

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、本インストールマニュアルに記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

About the software licenses

This product is licensed under the MPEG-4 visual patent portfolio license for the personal and non-commercial use of a consumer for (I) encoding video in compliance with the MPEG-4 visual standard ("MPEG-4 video") and/or (II) decoding MPEG-4 video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

© オリンパス株式会社

All Rights reserved

PRECiV1.1_JP_01

1. はじめに

本ソフトウェアの取扱説明書は、本書（インストールマニュアル）、オンラインヘルプ、ユーザーマニュアルから構成されています。本ソフトウェアを初めてご使用になるユーザーは、ユーザーマニュアルで製品の概要を理解してください。その後、細かな疑問についてはオンラインヘルプを参照することをお勧めします。

本インストールマニュアルでは、本ソフトウェアのインストール方法を説明します。本ソフトウェアと組み合わせてご使用になるデジタルカメラのインストール方法については、各デジタルカメラの取扱説明書をご参照ください。

本ソフトウェアには下記の4種類のグレードがあります。

- Capture
 - Core
 - Pro
 - Desktop
- 本ソフトウェアは別途、ソリューション(有償)を追加できます。

本インストールマニュアルは[Pro]を使用する場合について説明しています。他のグレードやソリューションをインストールする場合、記載されている画面の一部がインストール時に表示されませんが、本ソフトウェアのインストール手順については同じです。

注意：

本ソフトウェアのインストールにはライセンスキーが必要となります。ライセンス証明書（「ライセンスキーの重要性」(7ページ)を参照）にライセンスキーが記載されていますので、捨てずに保管してください。

注意：

USBカメラ以外を接続する場合は、本ソフトウェアをインストールする前にPCにカメラを接続してください。USBカメラを接続する場合は、本ソフトウェアをインストールした後にPCにカメラを接続してください。カメラの接続の詳細については、使用するカメラのマニュアルを参照してください。

注意：

本ソフトウェアをインストールする前に起動中のソフトウェアをすべて終了してください。

注意：

OSのユーザーアカウントの登録が「コンピューターの管理者」でないとインストールできません。もし、管理者でない場合は、「コンピューターの管理者」に問い合わせてください。

（ユーザーアカウントの登録については、ご使用のPCの取扱説明書をご参照ください。）

廃棄について

本製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例または規則に従ってください。ご不明な点は、ご購入先のオリンパスの販売店へお問い合わせください。

推奨動作環境

本ソフトウェアをインストールして実行するには、以下のシステムが必要です。

使用するカメラの種類によっては、より高度なシステムが必要になる場合もあります。本ソフトウェアをインストールする前に、使用するカメラの取扱説明書もご確認ください。

No.	項目	動作環境
1	CPU	Intel® Core™ i7、Intel® Xeon® または同等以上品
2	RAM	8GB以上
3	ハードディスク容量	インストール時に2.4GB以上の空き容量があること 画像およびデータを保存するための最小容量は50GB
4	最適化されたモニター解像度	1920x1080(Full HD)* ¹
5	グラフィックカード	2GB RAMを搭載した64 bit グラフィックカード 特定の機能によっては高性能なグラフィックカードが必要です。 Live HDR (CUDA 9.1と互換性がある)
6	ドライブ	DVDドライブ (ダブルレイヤーDVD対応)
7	PC入力デバイス	2ボタンマウス (推奨: 3ボタンマウス、ホイール付) キーボード
8	OS	Microsoft® Windows® 10 Pro (64 bit) (Version20H2以降) Microsoft® Windows® 10 Pro for Workstations (64 bit) (Version20H2以降) Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64 bit) (Version20H2以降)
9	OS言語	日本語、英語、ドイツ語、中国語、ロシア語、フランス語、韓国語、スペイン語、チェコ語、ポーランド語
10	オフィス製品	Microsoft® Office 365 (Semi annual channel) Microsoft® Office 2019
11	.NET Framework	.NET Framework 4.6.2以降 (4.6.2がPCにインストールされていない場合、本ソフトウェアのセットアップによってインストールされる。)
12	Webブラウザ	Microsoft® Edge、Google Chrome™
13	USB	DP23/DP28用USB3.1ポート DP22/DP27/SC50/UC90用USB3.0ポート 顕微鏡ハードウェア (顕微鏡フレーム、ステージ、光源) 用USB2.0ポート
14	COM port	顕微鏡ハードウェア (顕微鏡フレーム、ステージ、光源) 用RS232Cポート

*¹ 4Kモニターなどの大きなサイズのモニターでソフトウェアを表示すると小さく表示される場合があります。その場合はデスクトップ上で右クリックして[ディスプレイ設定]から表示スケールを変更してください。

OLYMPUS製のDPシリーズのカメラの専用コントローラーを使用する場合、コントローラーの取扱説明書に記載された動作環境に従ってください。

ご使用にあたって

1. 本ソフトウェアの起動中にPCがスリープ状態になると、不具合が発生する場合があります。必ず、PCがスリープ状態にならないように設定してください。
2. 予期せぬことにより画像データが破壊されることがありますので、データのバックアップを定期的にお取りください。
3. カメラのカメラケーブル（USB含め）はソフトウェアの起動中に抜き差ししないでください。カメラの故障、アプリの誤動作、データの喪失につながります。
4. 本ソフトウェアを同時に複数起動することはできません。
5. 異なるグレードの本ソフトウェア（例、CoreとPro）を同一のPCに重複してインストールすることはできません。
6. 本ソフトウェアをインストールする前に、制御対象の各デバイスのインストールマニュアルを読んでください。また、顕微鏡などの接続したデバイスの操作方法に関する情報については、該当するデバイスの取扱説明書をご覧ください。
7. インストール時に作成されたフォルダーおよびファイルは、絶対に削除・名前の変更を行わないでください。削除・名前の変更を行うと、本ソフトウェアが起動しなくなる場合があります。また、インストール先フォルダーとしてデスクトップを指定しないでください。
8. ハードディスクドライブ（HDD）の空き容量が少なくなると、データの処理が極端に遅くなったり、エラーが発生したりする場合があります。不要なデータファイルはこまめに消去してください。
9. 記録したデータの消滅（破壊）については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
10. 本ソフトウェアのレポート機能を使用するためには、Microsoft® Office 365 またはMicrosoft® Office 2019のいずれかをインストールする必要があります。
11. ユーザーアカウント制御のレベルが高い場合、PC 起動時に「CodeMeter Runtime Server」の変更許可を確認するメッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示された場合は、[はい]を選択してください。ユーザーアカウント制御のレベルを最低にすることで、このメッセージを表示させないように設定することができます。
12. インストール時にCode meterというソフトウェアがインストールされます。このCode meterは本ソフトウェアのライセンス管理をしているため、不用意にアンインストールや、フォルダーおよびファイルの削除・名前の変更を行わないでください。本ソフトウェアが起動しなくなる場合があります。
13. 本ソフトウェアを使用するためには、ライセンスのアクティベーションが必要です。このため、使用するPCをインターネットに接続することを推奨します。
14. Windows® に設定できるシステムの保護機能(復元ポイントの作成)は、Code meter で管理している本ソフトウェアのライセンス管理に影響する場合があります。復元機能によりシステムを復元後、ライセンスの認証に失敗した場合は、「本ソフトウェアのディアクティベーション」(24ページ)を参照して、ライセンスを再アクティベートしてください。それでも、ライセンスの認証に失敗するときは、オリンパスの販売店へご連絡ください。

2. 本ソフトウェアのインストール

本章では本ソフトウェアのインストール手順について説明します。

2.1 インストーラーの起動

インストール時には、下記のものをご用意ください。

- DVD-ROM*
- 本ソフトウェアのライセンス証明書 (P.7を参照)
- ソリューションのライセンス証明書
(ソリューションをご使用になる場合のみ)
- USBメモリー等の記憶媒体
(本ソフトウェアをインストールするPCがインターネットに接続できない場合のみ)

* Webサイトからインストールする場合

Webサイトからダウンロードしてインストールすることも可能です。

1. 下記URLにアクセスして、インストーラー圧縮ファイル[PRECiV_VerXXX.zip]をダウンロードします。
<https://www.olympus-ims.com/ja/service-and-support/downloads/>
2. ZIPファイルを解凍して、解凍先フォルダー直下にあるsetup.exeをダブルクリックします。

1. Windows® を起動します。(コンピューターの管理者のアカウントでログオンしてください。)
2. DVD-ROMをDVDドライブに挿入します。
3. [setup.exeの実行] をクリックします。



4. [ユーザーアカウント制御] 画面が表示されます。[はい] をクリックします。



- Microsoft® .Net Frameworkのインストール後、Windows® の再起動を求められる場合があります。その場合、Windows® 再起動後、[エクスプローラー] を起動し、DVDドライブのアイコンをダブルクリックしてください。

「本ソフトウェアのアクティベーション」に進みます。

2.2 本ソフトウェアのアクティベーション

2.2.1 ソフトウェアをアクティベートする目的

これからインストールする、または既にインストールした本ソフトウェアを今後ずっと使用できるようにソフトウェアのロックを解除する処理を、ソフトウェアアクティベーションと言います。

通常、本ソフトウェアのインストール開始時に、ライセンスをアクティベートしますが、インストール完了後にアクティベートすることもできます。本ソフトウェアをアクティベートすると、オリンパスのライセンス有効化サーバーに登録された本ソフトウェアのライセンスを入手できます。

本ソフトウェアのインストール後、ライセンスをアクティベートしないまま30日を過ぎると本ソフトウェアを利用できなくなります。本ソフトウェアのインストール後30日以内にライセンスをアクティベートしてください。

本ソフトウェアのインストール後30日を過ぎてライセンスをアクティベートする場合、本ソフトウェアを起動し、[ヘルプ] > [製品の有効化] コマンドを実行すると、ライセンスをアクティベートできます。

2.2.2 アクティベートする方法

アクティベートする方法はインターネット接続の有無と、使用するPCによって異なります。アクティベートする方法は3種類あります。いずれの方法でアクティベートしても、クライアントPCとライセンス有効化サーバー間で交換されるデータは基本的に同じです。データには個人情報は一切含まれません。

1. インターネットベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.8)

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続している場合、アクティベーションはインターネット経由で自動的に行われます。


この方法を推奨します。

2. ファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.9)

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続していない場合、アクティベーションはインターネットに接続している別のPCを介して行われます。

3. コードベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.14)

アクティベーションは、文字コードの転送と入力により行います。



ソフトウェアをアクティベートする際に交換されるデータ

インターネットベースでアクティベートする方法では、要求ファイル (RAFファイル) が、自動的にインターネット経由でオリンパスのライセンス有効化サーバーに送られます。サーバーが正規のライセンスと確認できた場合、自動的にプロセスファイル (PAFファイル) が送り返されます。


ファイルベースでアクティベートする方法でも要求ファイルが転送されます。しかしこの方法では、ファイルがライセンス有効化サーバーへの手動アップロードおよびダウンロードにより転送されます。

コードベースでアクティベートする方法では、文字コードが交換されます。

ライセンスキーの重要性

ソフトウェアをインストールする際には、ライセンスキーの入力が必須です。

ライセンスキーは本ソフトウェアと同梱されたライセンス証明書に記載されています。

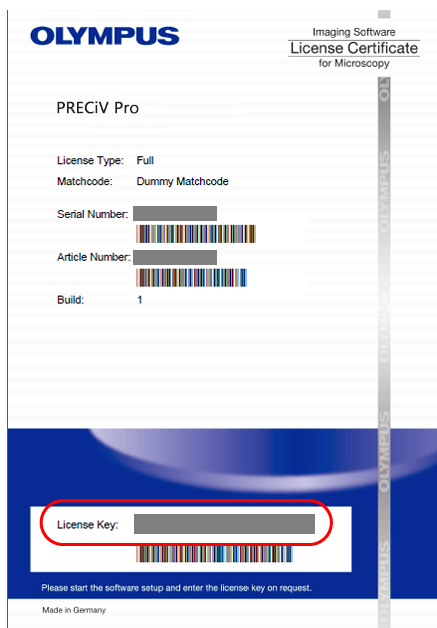

上記のように、ライセンス証明書の赤色で囲んだ部分に、本ソフトウェアのインストールに必要なライセンスキーが記載されています。

アクティベートすると、ライセンス有効化サーバーがライセンスの有効性を確認します。ライセンスが有効であった場合、ライセンス有効化サーバーはプロセスファイルを送り返します。インターネットに接続したPCであれば、この処理は自動的に行われ、通常数秒で完了します。

1つのソフトウェアには、対応するライセンスキーが1つだけ設定されています。ソリューションを購入した場合、別途ソリューション用のライセンス証明書およびライセンスキーが与えられます。インストールの際には、これらのライセンスキーも入力する必要があります。


2.2.3 いくつかのソフトウェアをアクティベートするか

本ソフトウェアはインストールしただけでは自動的にアクティベートされません。インストールの際にアクティベートしなかった場合は、インストール後30日以内に行う必要があります。アクティベートしなかった場合、その期間を過ぎると本ソフトウェアが使用できなくなります。この期間中は、アクティベートを促すメッセージがアクティベートするまで毎日表示されます。


[ヘルプ] > [製品の有効化] コマンドを実行して、本ソフトウェアのライセンスをアクティベートすることができ
ます。このコマンドは、ライセンスをアクティベートしていない場合にのみ使用できます。

2.2.4 インターネットベースでの本ソフトウェアのアクティベーション


1. 以下の[処理の選択]画面が表示される場合があります。[イメージングソフトウェアのインストールまたは
メンテナンス]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

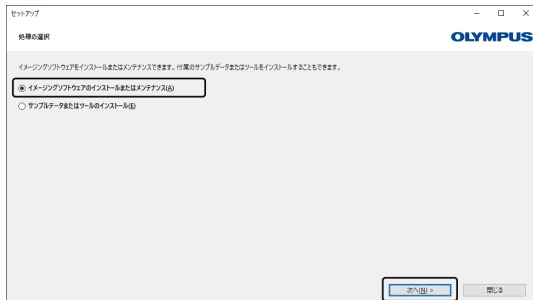


2. [ライセンスキーの入力] 画面が表示されたら、ライセンス証明書に記載されたライセンスキーを入力しま
す。ライセンスキーが複数ある場合 (ソリューション用など) はすべて入力してください。

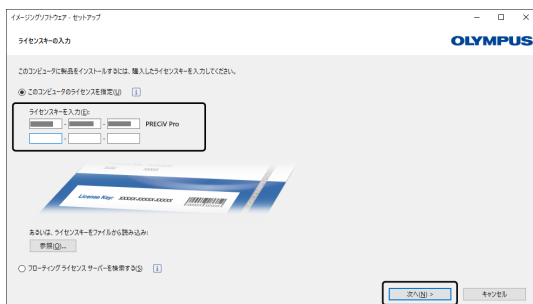

3. [次へ] ボタンをクリックします。
4. 表示された [ライセンスの有効化] 画面で、あらかじめ設定された[今すぐ有効化(推奨)] を変更せず、[次
へ] をクリックします。




5. [有効化サーバーへの接続] 画面で[サーバーへの接続] ボタンをクリックします。



- PCがライセンス有効化サーバーに接続し、データの交換が行われます。この処理はバックグラウンドで行われます。この処理には数秒かかります。この処理は中断しないようにしてください。
- 何らかの理由で処理が中断した場合は、ご購入先のオリンパスの販売店へご連絡ください。

6. 本ソフトウェアのアクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。本ソフトウェアのインストールを続けるには [次へ] ボタンをクリックします。



- 以降の操作については、「インストール」をご参照ください。


2.2.5 ファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続できない場合、インターネットに接続されたほかのPCを介してアクティベートできます。


そのためには1台目のPCに本ソフトウェアをインストールし、2台目のPC (インターネット接続あり) を使ってオリンパスのライセンス有効化サーバーとデータ交換をします。2台のPC間でファイルの受け渡しができる必要があります。

ライセンス証明書をお手元にご用意ください。

1. 以下の [処理の選択] 画面が表示される場合があります。[イメージングソフトウェアのインストールまたはメンテナンス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

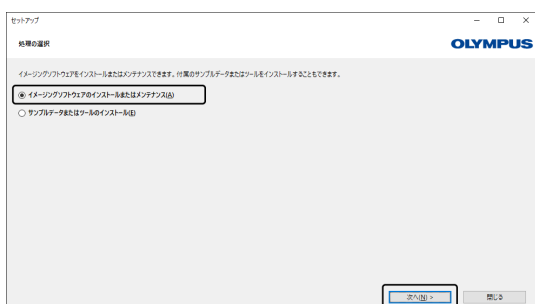

2. [ライセンスキーの入力] 画面が表示されたら、ライセンス証明書に記載されたライセンスキーを入力します。ライセンスキーが複数ある場合 (ソリューション用など) はすべて入力してください。

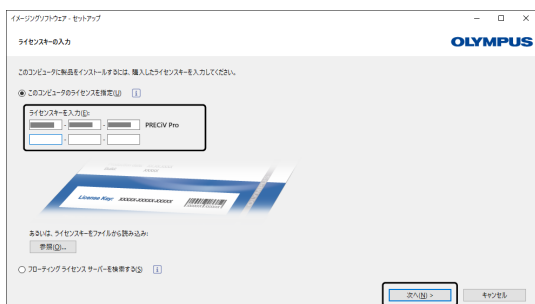

3. [次へ] ボタンをクリックします。
4. 表示された [ライセンスの有効化] 画面で、あらかじめ設定された [今すぐ有効化(推奨)] を変更せず、[次へ] をクリックします。
5. [有効化ファイルの交換] 画面で [要求ファイルの保存] ボタンをクリックします。



○ [有効化ファイルの交換] 画面は閉じないでください。この後の操作で使用します。

6. 要求ファイルを保存するフォルダーを開きます。保存するフォルダーは、USBなどの記憶媒体か、インターネット接続されている2台目のPCからアクセスできるフォルダーにします。
[ファイル名]に要求ファイル名を入力します。ファイル名は半角英数字を使用し、任意の名前を設定してください。

例) "PRECIV"

[ファイルの種類] が (*raf) ファイル(request activation file)であることを確認し、[保存] ボタンをクリックします。



7. 2台目のPCに移り、Webブラウザを起動し、下記URLを入力します。

<http://www.olympus-sis.com/file-activation/>


○ 以下のサイトが表示されます。サイトの言語は、必要に応じて変更できます。

8. [参照...] ボタンをクリックします。



- 手順8～16が完了するまで、Webブラウザを開じないでください。
- 手順8～16が完了するまで、Webブラウザから[進む]、[戻る]、[更新]を実施しないでください。

9. [開く] 画面で要求ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。



10. [ライセンスの有効化] 画面で[アップロード] ボタンをクリックします。




- サイトが更新されます。この処理に数秒かかります。

11. [プロセスファイルのダウンロード] ボタンをクリックします。




12. [名前を付けて保存] ボタンをクリックします。



13. ダウンロードしたプロセスファイルを保存するフォルダーを開きます。保存するフォルダーは、USBメモリなどの記憶媒体か、本ソフトウェアをインストールしたPCからアクセスできるフォルダーにします。
[ファイル名] にプロセスファイル名を入力します。デフォルトで“license.paf”というファイル名が付いています。ファイル名は半角英数字を使用し、任意の名前を設定してください。

例) “PRECiV”

[保存] ボタンをクリックします。



- ダウンロードしたファイルにはPAF (processed activation file) という拡張子が付いています。

14. [ダウンロードが完了しました] というメッセージを確認し、メッセージを閉じます。



15. プロセスファイルのダウンロード完了後、ユーザー登録を行うことができます。ユーザー登録を行うと、今後、電子メールで製品情報を受け取ることができます。[ユーザー登録] ボタンをクリックするとユーザー登録ページへ移動しますので、必要事項を記入してください。




16. プロセスファイルが保存できたことを確認し、Webブラウザを閉じます。

17. 本ソフトウェアをインストールしたPCに移ります。

18. 表示されている [有効化ファイルの交換] 画面上で、[処理されたファイルの読み込み] ボタンをクリックします。




19. ライセンス有効化サーバーからダウンロードしたプロセスファイルが保存されているフォルダーを選択し、[開く] ボタンをクリックします。



20. ダウンロードしたファイルのロードが完了したら、[有効化ファイルの交換] 画面上で、[次へ] ボタンをクリックします。



21. 本ソフトウェアのアクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。本ソフトウェアのインストールを続けるには [次へ] ボタンをクリックします。



- 以降の操作については、「インストール」をご参照ください。


2.2.6 コードベースでの本ソフトウェアのアクティベーション

本ソフトウェアをインストールするPCがインターネットに接続しておらず、またインターネットに接続されたほかのPCとの間でファイルの受け渡しもできない場合には、文字コードの転送と入力によりアクティベートできません。


注記:

- コードベースでアクティベートする場合は、アクティベートしている間、作業を中止することができません。
- コードベースでアクティベートした後に別のライセンスをアクティベートする場合、インターネットベースまたはファイルベースでアクティベートできません。
- コードベースでアクティベートした場合、ディアクティベートするときもコードベースになります。

1. 以下の [処理の選択] 画面が表示される場合があります。[イメージングソフトウェアのインストールまたはメンテナンス] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

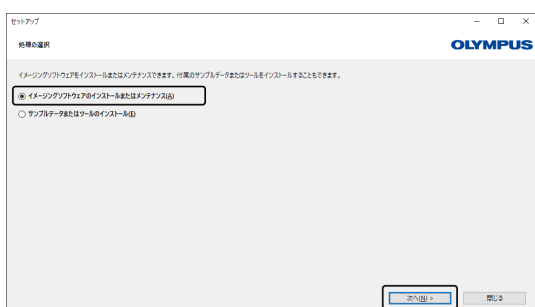

2. [ライセンスキーの入力] 画面が表示されたら、ライセンス証明書に記載されたライセンスキーを入力します。ライセンスキーが複数ある場合 (ソリューション用など) はすべて入力してください。



3. 表示された [ライセンスの有効化] 画面で、あらかじめ設定された [今すぐ有効化(推奨)] を変更せず、[次へ] をクリックします。


4. [このオプションは避けてください: 手動による有効化は、このPCでファイル交換が不可能である場合にのみ行います] にチェックを付けます。



5. [次へ] ボタンをクリックします。

- 以下の画面が表示されます。

[はい] をクリックして画面を閉じます。

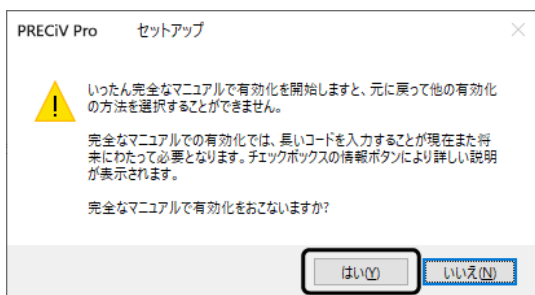

6. 表示された[ライセンスの手動有効化]画面で、コードAを確認します。



7. 文字コードの転送を行うPCに移り、Webブラウザを起動し、下記URLを入力します。

<http://www.olympus-sis.com/code-activation/>

8. 接続したサイトでコードAを入力後、[送信] を選択します。



注記:

コードの誤入力にご注意ください。

【特に間違いやすい例】

- I (大文字のアイ) と l (小文字のエル) または 1 (数字)
- 0 (数字) と O (大文字のオー)
- “-” (ハイフン) も忘れずに入力してください。

9. 表示された画面でコードBを確認します。




10. 本ソフトウェアをインストールしたPCに移り、[ライセンスの手動有効化] 画面で[コードB] ボタンをクリックします。




- [コードBの入力] 画面が表示されます。

11. コードBを入力後、[OK] ボタンをクリックします。




12. ライセンスが複数ある場合は、すべてのライセンスに対してコードBを入力するまで、手順7.~11.を繰り返します。

13. [ライセンスの手動有効化] 画面で [次へ] ボタンをクリックします。

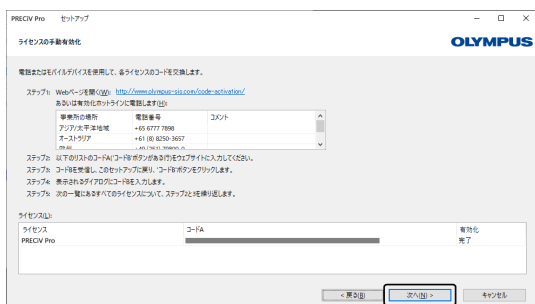

14. 本ソフトウェアのアクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。本ソフトウェアのインストールを続けるには [次へ] ボタンをクリックします。



○ 以降の操作については、「インストール」をご参照ください。

2.3 インストール

このセクションでは、Windows® 10でのインストール手順について説明しています。


2.3.1 本ソフトウェアのインストール

インストールする前に


使用するカメラによって、PCとカメラを接続するタイミングが異なります。

- OLYMPUS製USBカメラを使用する場合
PCとカメラの接続は不要です。
- OLYMPUS製USBカメラ以外を使用する場合
PCとカメラを接続します。
- 他社製USBカメラを使用する場合
PCとカメラの接続は不要です。

1. 表示されている契約文書に同意いただける場合、
[はい、ライセンス契約の全条項に同意します。]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。

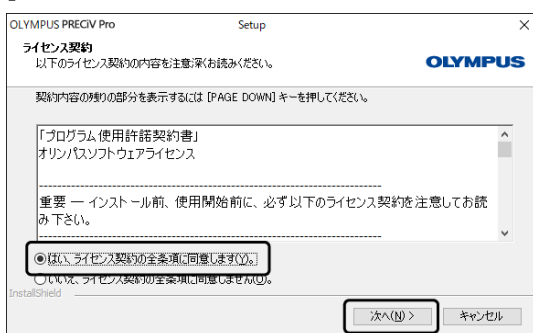


2. 言語を選択し、[次へ]をクリックします。

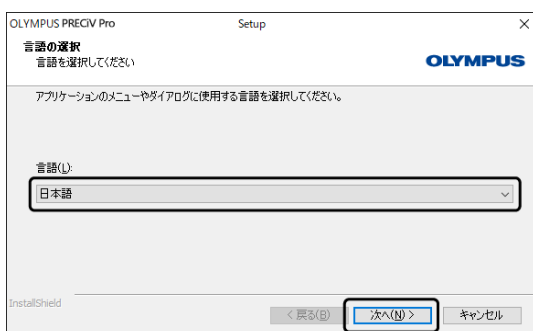


3. [インストール先の選択]画面が表示されます。インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックしてインストールする場所を指定します。[次へ]をクリックします。

注記:


インストール先に選択したフォルダーの名前にドット"."が含まれていると、一部の機能に不具合が発生する場合があります。フォルダーの名前にドット"."が含まれていないフォルダーを選択してください。

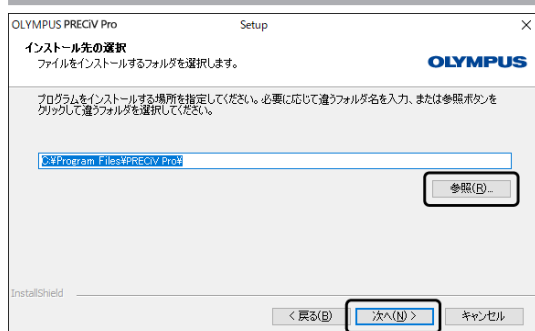

4. [追加タスクの選択]画面が表示されます。項目にチェックが付いていることを確認し、[次へ]をクリックします。

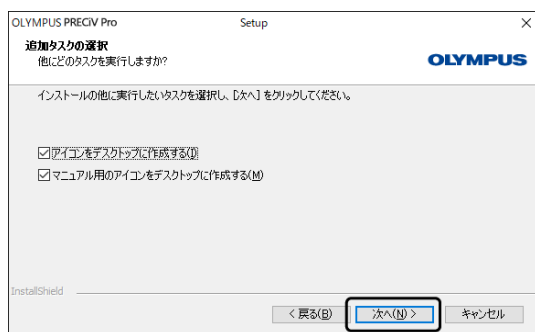

5. [ファイルコピーの開始]画面が表示されます。[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。

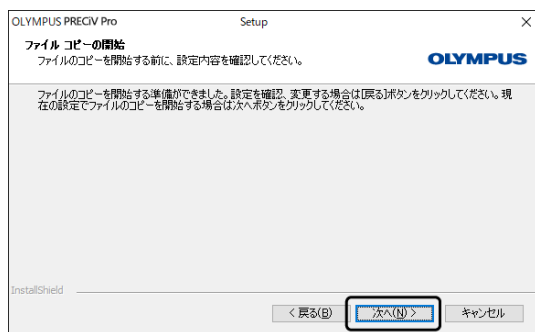


6. ご使用のPC にMicrosoft® Officeがインストールされていない場合、以下の画面が表示されます。[OK] をクリックするとインストールが再開されます。この場合、本ソフトウェアのレポート機能を使用することができません。レポート機能を使用する場合は、本ソフトウェアのインストール完了後、Microsoft® Office365 (Semi annual channel) または Microsoft Office 2019をインストールし、以下の画面に表示されるフォルダーに入っているWordReportDiagnostics.exeを実行してください。




7. インストール中に以下の画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。



8. インストール中に [使用中のファイル] 画面が表示されたら、[アプリケーションを閉じない。(再起動が必要になります。)] にチェックを付け、[OK] をクリックします。

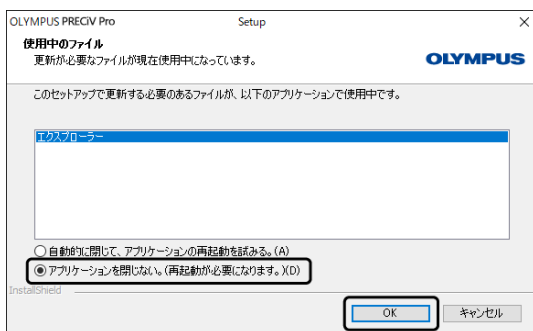

9. 以下の画面が表示されたら、[終了] をクリックします。これで本ソフトウェアのインストールは終了です。

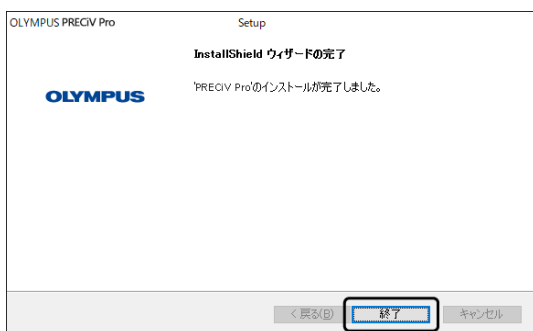

- インストール後、サンプルデータやツールをインストールすることができるメッセージが表示されます。必要な場合は、メッセージに従って操作してください。
- デスクトップに保存されたライセンス情報のファイルは印刷し、さらにこのファイルを現在のコンピュータ以外の場所に保存することを強くお勧めします。
- PCの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、PCを再起動してください。

2.3.2 カメラの接続とドライバのインストール

ドライバーのインストールは、本ソフトウェアをインストールしたあとに行ってください。

使用するカメラによって、ドライバーのインストール方法が異なります。

- OLYMPUS製USBカメラを使用する場合
インストールは不要です (本ソフトウェアのインストール時にドライバーがインストールされます)。
- OLYMPUS製USBカメラ以外を使用する場合
インストールは不要です (本ソフトウェアのインストール後にドライバーが自動でインストールされます)。
- 他社製USBカメラを使用する場合
PCとカメラを接続してドライバーをインストールします (本ソフトウェアのインストール時にデスクトップに作成されたショートカットファイルをダブルクリックします)。
カメラの接続の詳細については、使用するカメラのマニュアルを参照してください。

インストールが正常に完了したら、

「本ソフトウェアの開始と設定」(38ページ)へ進みます。

2.4 本ソフトウェアのアップデート / アップグレード / ソリューション追加

本ソフトウェアのアップデート版を購入すると、古いバージョンを新しいバージョンにアップデートできます。アップデート前のバージョンによらず、新しいバージョンにアップデートできます。

本ソフトウェアを最初にインストールする際は、本ソフトウェアのライセンスキーに加え、使用する各ソリューションのライセンスキーも入力する必要がありますが、本ソフトウェアのアップデートでは入力するライセンスキーは1つだけです。このライセンスキーは本ソフトウェアをアップデートすると同時にすべてのソリューションをアップデートします。

アップデートライセンスキーは、オリンパスの販売店から入手してください。このライセンスキーはアップデート処理でしか利用できません。また、アップデート後に必要になることはありません。

本ソフトウェアには、無償のアップデートがある場合があります。その際はライセンスキーは必要ありません。

2.4.1 アップデートのインストール

アップデートのインストール手順は、本ソフトウェアの初回のインストール手順とほぼ同じです（「本ソフトウェアのインストール」(4ページ)章を参照）。以下を準備してください。

- アップデートするバージョンの本ソフトウェア（DVD-ROMまたはダウンロードのいずれか）
 - アップデートライセンスキーが記載された証明書
1. 最初に、PCに現在インストールされている本ソフトウェアのバージョンを確認します。本ソフトウェアを開き、[ヘルプ] > [バージョン情報] コマンドを実行します。
現在使用している本ソフトウェアのバージョンが表示されます。
 2. 本ソフトウェアと現在実行中の他のソフトウェアを閉じます。
 3. アップデート版の本ソフトウェアのプログラムが保存されているフォルダーを開き、setup.exeファイルをダブルクリックします。
インストールプログラムが開始されます。
[処理の選択] ダイアログボックスが表示されます。
 4. [イメージングソフトウェアのインストールまたはメンテナンス] オプションを選択します。
[ライセンスキーの入力] ダイアログボックスが表示されます。
 5. アップデートライセンスキーを入力し、本ソフトウェアをアクティベートします。アクティベートについては、「本ソフトウェアのアクティベーション」(6ページ)を参照してください。
 6. 本ソフトウェアのアクティベーションが正常に終了したら、引き続き本ソフトウェアのインストールを行います。
インストールウィザードにより、本ソフトウェアのインストールが実行されます。インストールウィザードの指示に従い、必要な情報を入力します。[次へ] ボタンをクリックします。
 7. インストールの最後に [終了] ボタンをクリックします。
 8. 本ソフトウェアを開き、アップデートがインストールされたことを確認します。[ヘルプ] > [バージョン情報] コマンドを実行します。
アップデートしたバージョンが表示されます。

2.4.2 ソリューションの追加

ソリューションの追加手順は、本ソフトウェアの初回のインストール手順とほぼ同じです（「本ソフトウェアのインストール」(4ページ)章を参照）。以下を準備してください。

- ソリューションを追加するバージョンの本ソフトウェア（DVD-ROMまたはダウンロードのいずれか）
 - 追加するソリューションのライセンスキーが記載された証明書
1. 本ソフトウェアのプログラムが保存されているフォルダーを開き、setup.exeファイルをダブルクリックします。
インストールプログラムが開始されます。
[処理の選択] ダイアログボックスが表示されます。
 2. [イメージングソフトウェアのインストールまたはメンテナンス] オプションを選択します。
[ライセンスキーの入力] ダイアログボックスが表示されます。
 3. ソリューションのライセンスキーを入力し、本ソフトウェアをアクティベートします。アクティベートについては、「本ソフトウェアのアクティベーション」(6ページ)を参照してください。
 4. 本ソフトウェアのアクティベーションが正常に終了したらソリューションの追加は終了です。[キャンセル] ボタンをクリックします。
 5. [終了] ボタンをクリックします。

2.4.3 デジタルチャートのインストール

マテリアルソリューション[チャート比較]を使うためには、PRECiVがインストールされたPCに少なくとも1つの工業規格準拠デジタルチャートがインストールされている必要があります。加えて、PRECiVのセットアップ時に対応するデジタルチャートソリューションのライセンスがアクティブ化されている必要があります。

注記:

[チャート比較]のデジタルチャートは管理者権限でログインしていないとインストールできません。ユーザー権限が限定ユーザーの場合は、管理者権限を割り当ててください。

工業規格準拠デジタルチャートのインストール方法は下記の方法に従ってください。

1. PRECiVをインストールした際に、対応するデジタルチャートのライセンスをアクティブ化したか確認してください。
2. アプリケーションを起動していたら終了してください。
3. ディスクドライブに購入したデジタルチャートDVDを挿入してください。
4. InstallChartComparisonPlate.exe ファイルをクリックします。このファイルはDVDのルートディレクトリの中にあります。
5. ダイアログボックス内のライセンス文を読み、[次へ]ボタンをクリックします。
6. [チャート比較]プレート用のデジタルチャートがインストールされます。ダイアログボックス内にステータスが表示されます。
7. インストールプログラムが終わったらダイアログボックスを閉じます。
8. ソフトウェアを起動します。
9. [マテリアルソリューション]ツールウィンドウエリアに切り替えます。[チャート比較]ボタンが表示されます。

この方法で工業規格準拠デジタルチャートのインストールが完了しました。工業規格を用いたチャート比較が実行できます。

複数の工業規格準拠デジタルチャートを購入された場合は、対応するDVDを使って上記の方法に従ってデジタルチャートのインストールを実施してください。

2.5 本ソフトウェアのディアクティベーション

使用中のPCが廃棄処分になるなどの理由で、ほかのPCで同じ本ソフトウェアのライセンスを使用する場合は、本ソフトウェアをディアクティベートする必要があります。本ソフトウェアのライセンスをディアクティベートする際も、必ずオリンパスのライセンス有効化サーバーで行います。本ソフトウェアのステータスが、このサーバー上で「ディアクティベート」となっているか確認することが重要です。本ソフトウェアをディアクティベーションしなければ、このライセンスをほかのPCで再びアクティブにすることができません。

PCの廃棄、ハードドライブの再フォーマット、またはほかの方法で使用できないようにする前に、本ソフトウェアをディアクティベートしてください。本ソフトウェアは、後からいつでも再アクティベートできますので、新しく使用するPCがまだ利用できなくても問題ありません。

アクティベーションと同様、ディアクティベーションの実施方法は、インターネット接続の有無と、使用するPCによって異なり、アクティベーションと同じ方法で行います。どの方法でディアクティベートしても、クライアントPCとライセンス有効化サーバー間で交換されるデータは基本的に同じです。データには個人情報は一切含まれません。

1. インターネットベースでのディアクティベーション (P.25)

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続できる場合、ディアクティベーションは自動的にインターネット経由で行われます。

2. ファイルベースでのディアクティベーション (P.26)

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続できない場合、ディアクティベーションはインターネットに接続されたほかのPCを介して行われます。

ディアクティベートする場合は、追加の手順があります。ディアクティベートが完了したことが記された確認ファイルを、オリンパスのライセンス有効化サーバーにアップロードする必要があります。この追加ファイルをアップロードしてはじめて、本ソフトウェアのステータスがライセンス有効化サーバー上で「ディアクティベート」となります。

3. コードベースでのディアクティベーション (P.31)

文字コードの転送と入力により本ソフトウェアをアクティベートした場合、ディアクティベートするときもコードベースで行う必要があります。



本ソフトウェアをディアクティベートする際に交換されるデータ


「インターネットベースでのディアクティベーション」では、要求ファイル (RAFファイル) とプロセスファイル (PAFファイル) が、インターネット経由でオリンパスのライセンス有効化サーバーとPCの間で自動的に交換されます。

「ファイルベースでのディアクティベーション」では、同じファイルが交換されます。しかしこの方法では、ファイルはライセンス有効化サーバーへの手動アップロードおよびダウンロードにより交換されます。ファイルベースでディアクティベートする場合は、ディアクティベートする最後で、確認ファイル (CAFファイル) を保存しアップロードする必要があります。


「コードベースでのディアクティベーション」では、文字コードが交換されます。

2.5.1 インターネットベースでのディアクティベーション

- ライセンスをインターネットベースまたはファイルベースでアクティベートした場合、ディアクティベーションはインターネットベースまたはファイルベースでのみ実施できます。
1. DVDドライブに、アンインストールする本ソフトウェアのDVD-ROMをセットします。
 2. 以下の[処理の選択]画面が表示されたら、[このコンピュータのライセンスの無効化]を選択します。

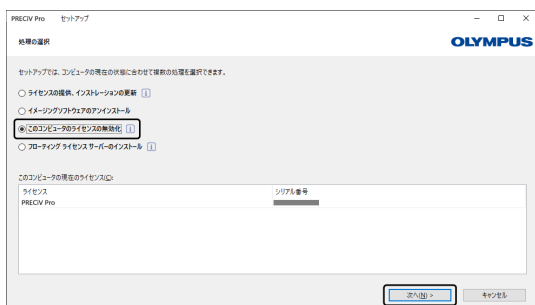


3. [次へ] ボタンをクリックします。
4. [ライセンスの選択]画面が表示されます。ディアクティベートするライセンスを選択します。

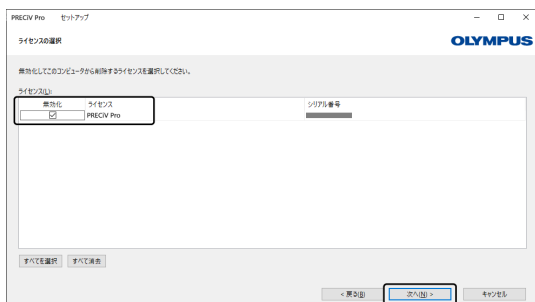

5. [次へ] ボタンをクリックします。

6. [ライセンスの有効化] 画面で [無効化する] ボタンをクリックします。

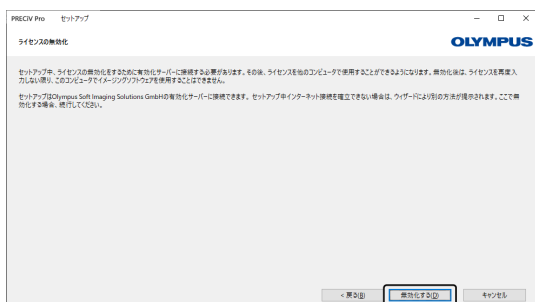

- PCはライセンス有効化サーバーへ接続し、ディアクティベートする本ソフトウェアのライセンスを検索します。この処理には数秒かかります。この処理は中断しないようにしてください。

7. ディアクティベーションが完了すると、[開放されたライセンス] 画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。[閉じる] ボタンをクリックします。



- ディアクティベーション完了後、下記フォルダーにLicense Keys.lkfというファイルが作成されます。
C:¥ProgramData¥Olympus¥OSIS
このファイルは、次回、本ソフトウェアのインストール時に必要です。
[ライセンスキーの入力] 画面にて [参照(O)…] からLicense Keys.lkfを読み込むと、ライセンスキーを読み込むことができます。

2.5.2 ファイルベースでの本ソフトウェアのディアクティベーション

本ソフトウェアを実行するPCをインターネットに接続できない場合、インターネットに接続された他のPCを介してディアクティベートできます。

そのためには2台目のPC (インターネット接続あり) を使ってオリンパスの有効化サーバーとデータ交換をします。2台のPC間でファイルの受け渡しができる必要があります。

注記:

ライセンスをインターネットベースまたはファイルベースでアクティベートした場合、ディアクティベートはインターネットベースまたはファイルベースでのみ実施できます。

- ファイルベースで本ソフトウェアをディアクティベートする場合は「インターネットベースでのディアクティベーション」(P.25)の手順6.までを実施し、以降の手順を実施してください。

1. [無効化ファイルの交換] 画面で [要求ファイルの保存] ボタンをクリックします。




- [無効化ファイルの交換] 画面は閉じないでください。この後の操作で使用します。

2. 要求ファイルを保存するフォルダーを開きます。保存するフォルダーは、USBメモリーか、インターネット接続されている2台目のPCからアクセスできるフォルダーにします。

[ファイル名] に要求ファイル名を入力します。ファイル名は半角英数字を使用し、任意の名前を設定してください。

例) "PRECiV"

[ファイルの種類] が (*raf) ファイルであることを確認し、[保存] ボタンをクリックします。



3. 2台目のPCに移り、Webブラウザを起動し、下記URLを入力します。

<http://www.olympus-sis.com/file-deactivation/>


- 以下のサイトが表示されます。

4. [ライセンスの無効化] 画面が表示されたら、[参照...] ボタンをクリックします。



- 手順4~6が完了するまで、Webブラウザから[進む]、[戻る]、[更新]を実施しないでください。

5. [開く] 画面で要求ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。



6. [ライセンスの無効化] 画面で [アップロード] ボタンをクリックします。




- サイトが更新されます。この処理に数秒かかります。

7. [プロセスファイルのダウンロード] ボタンをクリックします。



8. [名前を付けて保存] ボタンをクリックします。




9. ダウンロードしたプロセスファイルを保存するフォルダーを開きます。保存するフォルダーは、USBメモリーか、本ソフトウェアをインストールしたPCからアクセスできるフォルダーにします。

[ファイル名] にプロセスファイル名を入力します。デフォルトで“license.paf”というファイル名が付いています。ファイル名は半角英数字を使用し、任意の名前を設定してください。

例) “PRECiV”

[保存] ボタンをクリックします。




10. 本ソフトウェアをインストールしたPCに移ります。

11. [無効化ファイルの交換] 画面で、[処理されたファイルの読み込み] ボタンをクリックします。



12. [処理されたファイルの読み込み] 画面で、プロセスファイル(拡張子が.paf) を選択し、[開く] ボタンをクリックします。




13. [無効化ファイルの交換] 画面で、[確認ファイルの保存] ボタンをクリックします。



14. [確認ファイルの保存] 画面で、[ファイル名] に確認ファイル名を入力します。ファイル名は半角英数字を使用し、任意の名前を設定してください。

例) “PRECIV”

[ファイルの種類] が (*.caf) ファイルであることを確認し、[保存] ボタンをクリックします。




15. 2台目のPCに移り、[ライセンスの無効化] 画面で[参照...] ボタンをクリックします。



- 手順15~17が完了するまで、Webブラウザーから[進む]、[戻る]、[更新]を実施しないでください。

16. [開く] 画面で確認ファイル(拡張子が.caf)を選択し、[開く] ボタンをクリックします。



17. [ライセンスの無効化] 画面で [確認ファイルのアップロード] ボタンをクリックします。




- サイトが更新されます。この処理に数秒かかります。

18. しばらくすると、以下の画面が表示されます。



19. 本ソフトウェアをインストールしたPCに移り、[無効化ファイルの交換] 画面で、[次へ] ボタンをクリックします。

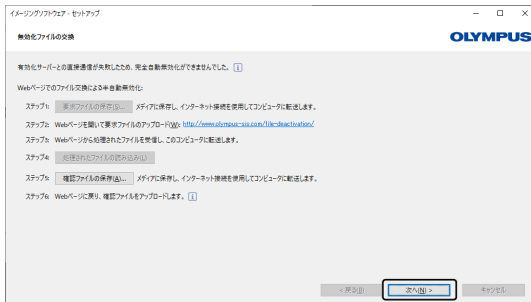

○ ダウンロードしたファイルのロードが完了すると、[次へ] ボタンを選べるようになります。

20. 本ソフトウェアのディアクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。[閉じる] ボタンをクリックします。



2.5.3 コードベースでの本ソフトウェアのディアクティベーション


本ソフトウェアをインストールしたPCがインターネットに接続しておらず、インターネットに接続されたほかのPCとの間でファイルの受け渡しもできない場合には、文字コードの転送と入力によってディアクティベートできます。

注記:

コードベースでアクティベートした場合、ディアクティベートはコードベースでのみ実施できます。

- コードベースで本ソフトウェアをディアクティベートする場合は「インターネットベースでのディアクティベーション」(P.25)の手順6.までを実施し、以降の手順を実施してください。

1. 表示された [ライセンスの手動無効化] 画面で、コードAを確認します。

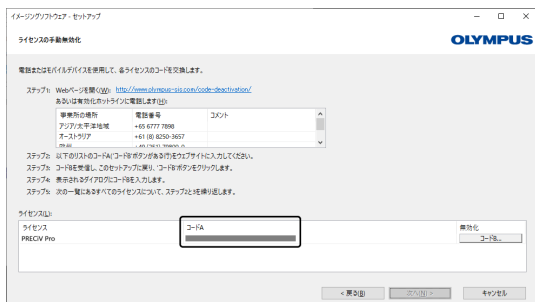

2. 文字コードの転送を行うPCに移り、Webブラウザを起動し、下記URLを入力します。

<http://www.olympus-sis.com/code-deactivation/>

- 以下のサイトが表示されます。

3. 接続したサイトでコードAを入力後、[送信] を選択します。

注記:

コードの誤入力にご注意ください。

【特に間違いやすい例】


- I (大文字のアイ) と l (小文字のエル) または 1 (数字)
- 0 (数字) と O (大文字のオー)
- “-” (ハイフン) も忘れずに入力してください。



4. 以下の画面でコードBを確認します。



5. 本ソフトウェアをインストールしたPCに移り、[ライセンスの手動無効化] 画面で [コードB] ボタンをクリックします。

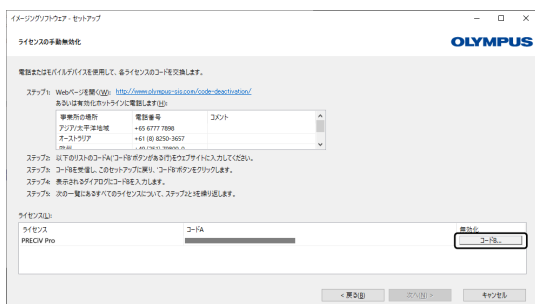

6. [コードBの入力] 画面でコードBを入力後、[OK] ボタンをクリックします。

注記:


コードの誤入力にご注意ください。

【特に間違いやすい例】


- I (大文字のアイ) と l (小文字のエール) または 1 (数字)
- 0 (数字) と O (大文字のオー)



7. ライセンスが複数ある場合は、すべてのライセンスに対してコードBを入力するまで、手順1~6を繰り返します。
8. [ライセンスの手動無効化] 画面でディアクティベーションが完了したことを確認後、[次へ] ボタンをクリックします。

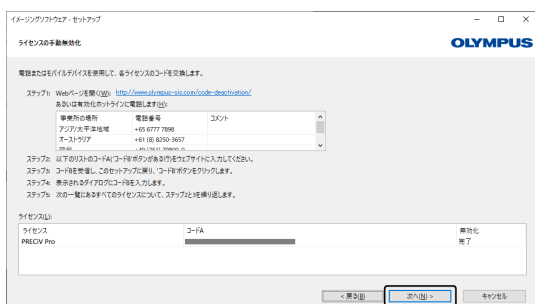

9. 本ソフトウェアのディアクティベーションが完了すると、以下の画面が表示されます。ライセンスについての最新情報を含むファイル (Olympusライセンス情報.html) がデスクトップに保存されますので、このファイルを印刷します。また、このファイルを別のPCに保存して、この情報をいつでも参照できるようにしておきます。[閉じる] ボタンをクリックします。

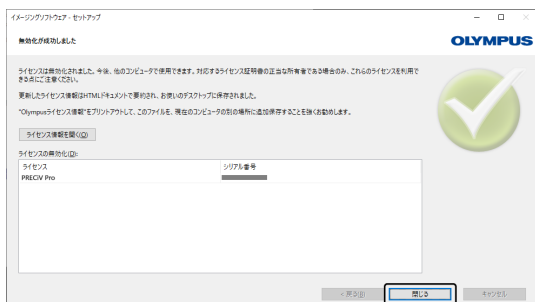

2.6 サービスのアップデート

オリンパスは、本ソフトウェアに対するサービスアップデートを無料でダウンロードできる [サービスアップデート] Web ページを多言語で提供しています。サービスアップデートは、インストールされている既存の本ソフトウェアを拡張したり、最適化したりするものです。

たとえば新しいデバイスをサポートする機能拡張や、既知の問題に対するバグ修正などの改善が含まれていません。サービスアップデートの対象範囲は、ソフトウェアリリースほど大きくありません。

2.6.1 サービスアップデートを表示してダウンロードする

本ソフトウェアに関連するサービスアップデートは、オリンパスの [サービスアップデート] Web ページで確認できます。各サービスアップデートについて、その内容についての詳細な情報を含む説明が記載されています。サービスアップデートをインストールするには、まず適切なファイルをダウンロードする必要があります。サービスアップデートのファイル拡張子は EXE です。EXE ファイルをダブルクリックすることにより、インストールを開始できます。サービスアップデートが自動的にインストールされることはありません。サービスアップデートをインストールする前に、本ソフトウェアを終了する必要があります。

2.6.2 サービスアップデートの有無を確認する

この機能は、本ソフトウェアを実行している PC がインターネットに接続できる場合に限りです。本ソフトウェアを実行している PC がインターネットにアクセスできない場合は、インターネットにアクセスできる PC で [サービスアップデート] Web ページにアクセスして、サービスアップデートの有無を確認してください。

インストール後に本ソフトウェアを初めて起動するときに、インターネット上に利用可能なサービスアップデートがあるかを自動的に確認するかどうかを指定できます。

初期設定を変更しないと、本ソフトウェアの起動時に自動的に新しいサービスアップデートの有無は確認されません。この場合、定期的にサービスアップデートの確認を手動で開始する必要があります。

本ソフトウェアを実行している PC がインターネットにアクセスできる場合、インストール後に本ソフトウェアを初めて起動するときに、新しいサービスアップデートの有無を自動的に確認する頻度 (たとえば毎日または毎月 1 回) を指定できます。これらの設定は、プログラムオプションで後からいつでも変更できます。

アップデートの確認を開始すると、新しいサービスアップデートが利用可能な場合は、サービスアップデートに関する情報およびオリンパスの [サービスアップデート] Web ページへのリンクを含むダイアログボックスが表示されます。新しいサービスアップデートをインストールすると、以降のアップデート確認でこのアップデートは表示されなくなります。

2.6.3 既にインストール済みのサービスアップデートを表示する

サービスアップデートはユーザーに依存しません。つまり、サービスアップデートをインストールすると、そのプログラムは本ソフトウェアの他のすべてのユーザーによっても使用されます。サービスアップデートのインストールには管理者権限が必要です。

既にインストール済みのサービスアップデートは、本ソフトウェアのシステム情報で確認できます。

2.6.4 サービスアップデートのインストール (インターネットにアクセスできる場合)

サービスアップデートは下記の手順でインストールします。この手順は、以下の前提条件が満たされている場合に有効です。

- 本ソフトウェアでサービスアップデートの自動チェックが無効になっている。
- 本ソフトウェアに対する新しいサービスアップデートが公開されている。

- 本ソフトウェアに対する管理者権限を持っている。
 - EXE ファイルをインターネットからダウンロードできる。
1. 本ソフトウェアを起動します。
 2. [ヘルプ] > [サービスアップデートの確認...] コマンドを実行します。
これにより、本ソフトウェアに対して利用可能なサービスアップデートの確認が手動で開始されます。
 3. [オンラインで確認] ボタンをクリックして、オリンパスの [サービスアップデート] Web ページで、本ソフトウェアに対して利用可能なサービスアップデートの有無を確認します。
利用可能なサービスアップデートがある場合は、[利用可能なサービスアップデート] ダイアログボックスが表示されます。
 4. このダイアログボックスで <https://serviceupdates.olympus-sis.com> リンクをクリックして、オリンパスの [サービスアップデート] Web ページにアクセスします。
Web ページが Web ブラウザーに表示されます。
 5. 本ソフトウェアおよび製品バージョンが正しく選択され、また PC で実行されている OS も選択されていることを確認します。
本ソフトウェアによりこのデータが オリンパスの [サービスアップデート] Web ページに転送されるため、通常、この情報は正しく選択されているはずですが。
 6. 各サービスアップデートの右側に表示される [詳細] ボタンをクリックします。
[サービスアップデートの詳細] メッセージボックスが表示されます。
 7. サービスアップデートの内容に関する情報を読み、メッセージボックスを閉じます。
 8. 本ソフトウェアを終了します。サービスアップデートのインストール中は、本ソフトウェアが起動してはいけません。
 9. Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint および Microsoft® Excel も終了します。サービスアップデートに Olympus MS-Office アドインの新しいバージョンが含まれる可能性があるためです。本ソフトウェアは、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint および Microsoft® Excel が終了されている場合にのみインストールできます。
 10. [詳細] ボタンの右側の [ダウンロード] ボタンをクリックして、サービスアップデートをダウンロードします。
ブラウザーによっては、ファイルを保存するかまたは実行するかを確認するメッセージが表示されます。この場合、ファイルを保存することを選択します。
 11. ダウンロードしたファイルを、ブラウザーのダウンロードフォルダーまたは任意のフォルダーに保存します。サービスアップデートのファイル拡張子は EXE です。
 12. EXE ファイルをダブルクリックします。または、ブラウザーに、利用可能なダウンロードについてのダイアログボックスが表示されている場合は、[実行] ボタンをクリックします。
[<サービスアップデート名> InstallShield ウィザード] が表示されます。進行状況バーにインストールのステータスが表示されます。
インストールが終了すると、インストールが完了したというメッセージが表示されます。
 13. [完了] ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。
 14. 本ソフトウェアを再度起動します。
 15. 新しいサービスアップデートが本ソフトウェアに表示されることを確認します。それには、[ヘルプ] > [バージョン情報] コマンドを実行し、[システム情報の詳細] ボタンをクリックします。ダイアログボックスのツリービューで、[サービスアップデート] を選択すると、インストールされているすべてのサービスアップデートの概要が表示されます。新たにインストールしたサービスアップデートもこのリストに表示

されます。

- さらに他のサービスアップデートをインストールするには、上記の手順を繰り返します。サービスアップデートは1つずつインストールする必要があります。一度に複数のサービスアップデートをインストールすることはできません。ただしサービスアップデートのダウンロードは、オリンパスの[サービスアップデート] Web ページで、一度に複数ダウンロードできます。

2.6.5 サービスアップデートのインストール(インターネットにアクセスできない場合)

本ソフトウェアを実行している PC がインターネットにアクセスできない場合は、上記の手順に加えて、以下の手順を実行する必要があります。

1. インターネットにアクセスできる PC で、サービスアップデートの有無を確認します。
2. ブラウザーのURL欄に<https://serviceupdates.olympus-sis.com>と入力し、オリンパスの[サービスアップデート] Web ページで、適切な本ソフトウェアの製品名および製品バージョンを選択します。また、PC で実行されているOSも選択します。
3. [結果の表示] ボタンをクリックします。該当するサービスアップデートが表示されます。内容に関する情報を表示し、サービスアップデートをダウンロードできます。
4. EXE ファイルをUSB メモリーなど記憶媒体にコピーします。この記憶媒体を、本ソフトウェアを実行している PC に挿入し、EXE ファイルを実行します。たとえば Windows のエクスプローラーでこのファイルをダブルクリックします。

3. 本ソフトウェアの開始と設定

3.1 本ソフトウェアの開始

1. 本ソフトウェアを開始するには、Windows デスクトップ上のこのアイコンをダブルクリックします。



本ソフトウェアのインストール中に [アイコンをデスクトップに作成する] チェックボックスをオフにした場合は、Windows デスクトップ上にアイコンが表示されません。この場合は、スタートボタンをクリックして本ソフトウェアを起動します。

2. 本ソフトウェアの初回起動時には、本ソフトウェアの設定およびキャリブレーションが必要です。これについて詳しくは、次のセクションで説明します。

3.2 本ソフトウェアの設定

注記:

システムを設定するには、本ソフトウェアに管理者またはパワーユーザー権限でログオンする必要があります。本ソフトウェアをインストールしたユーザーには、自動的に管理者権限が割り当てられています。

本ソフトウェアのインストール後に、システムを設定する必要があります。この設定は、顕微鏡の電動部などのデバイスを正しく制御するために必要です。


3.2.1 コード式または電動式の顕微鏡使用時の設定における前提条件

コード式または電動式の顕微鏡を使用する際は、以下の項目に注意してください。

- 本ソフトウェアを実行している PC が、顕微鏡のコントロールボックスと他の制御デバイス（たとえば、電動レボルバーなど）に接続されている。制御デバイスを PC に接続する方法の詳細については、対応する各デバイスのマニュアルを参照してください。
- 本ソフトウェアを起動する前に、コード式または電動式の顕微鏡の制御デバイスの電源が入れている。
- 顕微鏡（またはその他の電動/コード式のデバイス）と本ソフトウェアを実行している PC 間のインターフェイスが正常に設定されている。

3.2.2 使用するハードウェアの指定

本ソフトウェアの初回起動時には、[デバイスリスト] ダイアログボックスが自動的に表示されます。このダイアログボックスを閉じて、[設定メニュー] > [デバイス] > [デバイスリスト] コマンドで再度表示できます。このダイアログボックスで、使用するハードウェアを選択します。

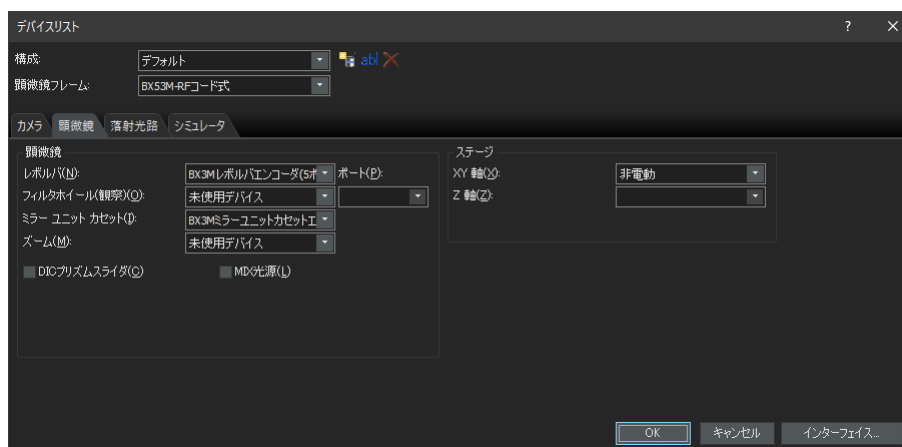


このダイアログボックスに表示される内容は、本ソフトウェアのインストール時に選択したハードウェアにより異なります。このため、[デバイスリスト] ダイアログボックスの表示が上の画面と異なる可能性があります。このダイアログボックスの詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。

3.2.3 指定したハードウェアの設定

必要な項目をすべて選択し確認後に [OK] をクリックすると、[デバイスの設定] ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスで、使用するハードウェアについてより詳細な設定を行ないます。まず、使用する対物レンズと、その対物レンズのレボルバー上の位置を指定します。本ソフトウェアで画像を取り込む際、ここで指定した対物レンズのみを選択できます。また、電動のレボルバーの場合は、ここで指定したもののみ制御できます。本ソフトウェアでは、画像のキャリブレーションを正しく行なうために、画像の取り込み時に使用される対物レンズの情報が必要です。

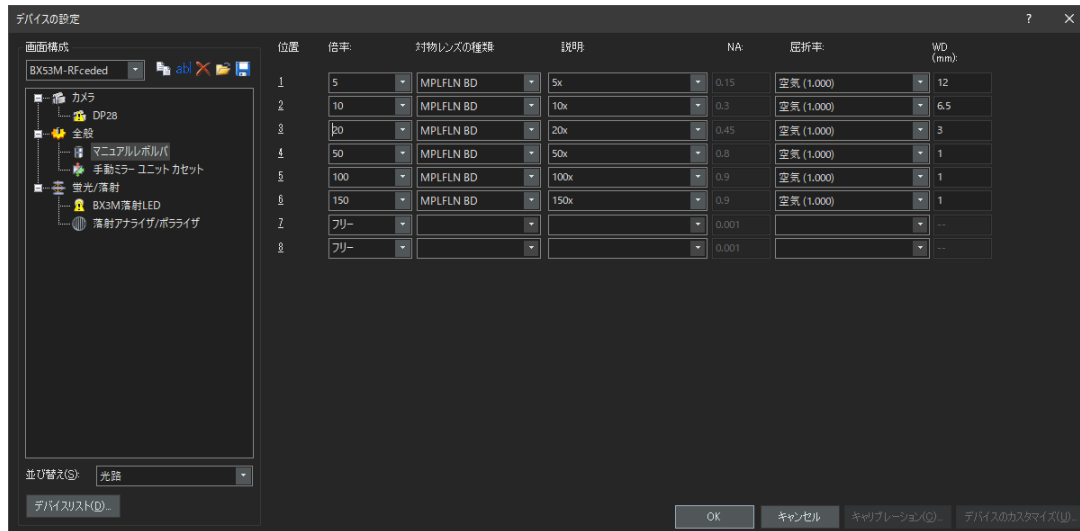


このダイアログボックスのすべての設定について、詳細はオンラインヘルプを参照してください。

3.2.4 システムのキャリブレーション

本ソフトウェアでは、キャリブレーションウィザードを使用して複数のキャリブレーションプロセスを実行します。システムを最適に使用するには、すべてのキャリブレーションプロセスを実行する必要があります。

[デバイスの設定] ダイアログボックスの [キャリブレーション...] ボタンをクリックして、キャリブレーションウィザードを開始します。システムのキャリブレーションを後で行なう場合は、[設定メニュー] > [デバイス] > [キャリブレーション...] コマンドを使用します。



利用可能なキャリブレーションプロセスは、本ソフトウェアのインストール時に選択したハードウェアにより異なります。このため、[キャリブレーション] ダイアログボックスの表示が上の画面と異なる可能性があります。

3.2.5 システム復元ポイントを利用する

システム復元ポイント(SRPファイル)を作成すると、PCにインストールされている本ソフトウェアを、システム復元ポイント作成時の状態に戻すことが可能になります。これにより、構成およびキャリブレーションに対する不要な変更を元に戻すことができます。

注意：

- 復元の際の本ソフトウェアのグレードおよびバージョンは、システム復元ポイントを作成した時点と同一である必要があります。本ソフトウェアをアップグレードやバージョンアップした場合は、システム復元ポイントを作成し直してください。
 - ユーザー固有のパラメーターは復元されません。(システム復元ポイントには、[アクセス権限]で[プライベート]が選択されているパラメーターは保存されません。)
 - デバイスリストやデバイス設定を変更した場合、システム復元ポイントを作成し直してください。また、復元の際は、システム復元ポイントを作成したときと同じハードウェア(顕微鏡、カメラ、対物レンズ、フィルターホイールなど)を接続してください。異なるハードウェアを接続すると、本ソフトウェアの起動時、または[デバイスリスト]ダイアログボックスの表示時に、ハードウェアが存在しないという警告メッセージが表示されることがあります。この場合、[デバイスリスト]ダイアログボックスおよび[デバイスの設定]ダイアログボックスの設定を更新してください。
-

3.2.5.1 システム復元ポイントに保存される情報

- ハードウェア設定 (観察手法、デバイスリスト、デバイスの設定)
- キャリブレーションデータ
- ユーザー非依存パラメーター。これは、システム復元ポイント保存時に [アクセス権限] で [パブリック] が選択されているすべてのパラメーターです。たとえば、カメラ設定など、さまざまなパラメーターがあります。

注意：

ユーザー固有のパラメーター (システム復元ポイント保存時に [アクセス権限] で [プライベート] が選択されているパラメーター) はシステム復元ポイントに保存されません。

ユーザー固有のパラメーターは、必要に応じて各自でバックアップするようにしてください。これらはデフォルトで各ユーザーディレクトリに保存されています。たとえば、「C:¥Users¥<user name>¥AppData¥Local¥Olympus¥OSIS¥PRECIV」にあります。

注意：

システム復元ポイントで復元できるのは、本ソフトウェア関連のデータのみです。システム復元ポイントを作成後に本ソフトウェアのアップデートを実施した場合、[設定] > [システム復元ポイント] > [システム復元ポイントを元に戻す...] コマンドを実行しても、復元ポイント作成時のバージョンにはなりません。

3.2.5.2 システム復元ポイントを作成する

1. [設定] > [システム復元ポイント] > [システム復元ポイントの作成...] コマンドを実行します。
この操作により本ソフトウェアが再起動されるというメッセージが表示されます。
2. [OK] ボタンをクリックします。
[システム復元ポイントを作成する] ダイアログボックスが開きます。
3. システム復元ポイント (SRP ファイル) の保存先を指定して、[保存] ボタンをクリックします。
 - SRP ファイルは、本ソフトウェアがインストールされている PC に保存しないでください。保存した場合、PC が予期せず使用不能になると、システム復元ポイントも失われます。本ソフトウェアは自動的に終了し、再起動します。

3.2.5.3 システム復元ポイントを使用して復元する

1. [取り込み] > [デバイス] > [システム復元ポイントを元に戻す...] コマンドを実行します。
この操作により本ソフトウェアが再起動されるというメッセージが表示されます。
2. [OK] ボタンをクリックします。
[システム復元ポイントを元に戻す] ダイアログボックスが開きます。
3. システム復元ポイント (SRP ファイル) の保存場所を参照して、ファイルを選択します。
4. ユーザー権限設定を復元する場合は [Restore use rights settings] にチェックを入れます。ただし、ユーザー権限設定を復元する場合は、復元の前後でコンピュータ名およびユーザー名は同一である必要があります。
5. [開く] ボタンをクリックします。
本ソフトウェアは自動的に終了します。
システム復元ポイントに保存された設定で、本ソフトウェアが再起動します。

3.3 初の画像の取り込み

本ソフトウェアの設定とキャリブレーションを終えたら、画像を取り込むことができます。以下の手順を実行してください。

1. トップエリアで、画像の取り込みに使用する対物レンズを選択します。画像を適切にキャリブレーションするには、使用する対物レンズを選択する必要があります。



電動の顕微鏡をご使用の場合は、選択した対物レンズが自動的に光路に入ります。

手動の顕微鏡をご使用の場合は、手動でレボルバーを回転させて対物レンズを光路に入れます。

参考:


手動の顕微鏡をご使用の場合、画像を取り込むたびに [画像キャリブレーション] ダイアログボックスを表示すると便利です。この機能を有効にするには、[取り込み設定] ダイアログボックスで [取り込みの後、倍率を確認する] にチェックを付けます。

[画像キャリブレーション] ダイアログボックスで、使用する対物レンズの倍率を確認したり変更したりできます。これにより、画像を正しくキャリブレーションできます。この機能の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。


2. ライブが開始されていない場合、右下にある下記の [ライブの開始] ボタンをクリックします。ライブ画像がドキュメントエリアに表示されます。




3. 落斜照明あるいは透過照明が点灯していない場合は、点灯します。それには、[観察タブ] > [観察の設定] > [照明] グループにある照明ボタンをクリックします。(詳細はオンラインヘルプを参照してください。)




4. 観察したい標本位置がライブ画像に表示されるように、ステージハンドルがある顕微鏡ではステージハンドルを回してステージを移動します。図は一例です。



BX53M




GX53




MX63


5. 粗動あるいは微動ハンドルを回して、標本にピントを合わせます。



BX53M



GX53



MX63


6. 色再現の状態を確認します。

必要に応じて、ホワイトバランスを実行します。それには、[観察タブ] > [画像の設定] > [色調整]グループにある [ROIのホワイトバランス] ボタンをクリックします。(詳細はオンラインヘルプを参照してください。)



7. 露出時間を確認します。

[観察タブ] > [画像の設定] > [露出時間] グループで露出時間を設定することができます。自動で決定することも、手動で入力することもできます。

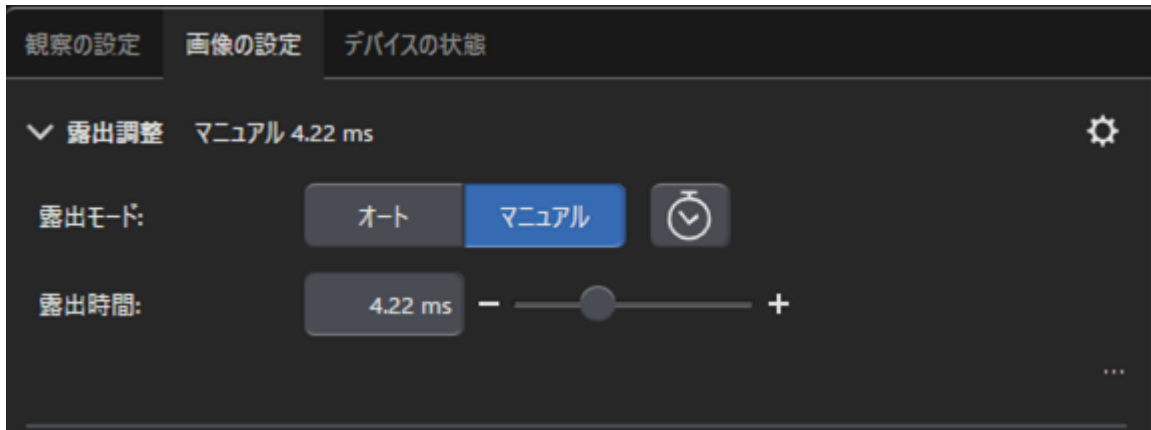

8. [観察タブ] > [画像の設定] > [解像度] グループで解像度を選択します。



9. [スナップショット] ボタンをクリックします。



取り込まれた画像がドキュメントグループに表示されます。

必要に応じて画像を保存してください。

4. 本ソフトウェアのアンインストール

4.1 本ソフトウェアのアンインストール手順

4.1.1 本ソフトウェアのアンインストール

注記:

本ソフトウェアをアンインストールするには、PCに管理者としてログオンしてください。

1. 本ソフトウェアでディアクティベートします (「本ソフトウェアのディアクティベーション」(24ページ)を参照)。
2. 左下の[スタート] ボタンをクリックし、[Windows システムツール] > [コントロールパネル] > [プログラム] > [プログラムのアンインストール] コマンドを実行します。

4.1.2 本ソフトウェアに同梱された DVD を使用できない場合

お使いのOSの機能を使用して、本ソフトウェアをアンインストールできます。たとえば Windows 10 の場合は、左下の [スタート] ボタンをクリックし、[Windows システムツール] > [コントロールパネル] > [プログラム] > [プログラムのアンインストール] コマンドを実行します。この場合、事前に本ソフトウェアをディアクティベートしておく必要があります (「本ソフトウェアのディアクティベーション」(24ページ)参照)。OSの機能を使用したアンインストール手順では、ディアクティベートできません。

注記:

本ソフトウェアをアンインストールするには、PCに管理者としてログオンしてください。

1. PRECIV ソフトウェアプログラムが保存されているフォルダーを開き、setup.exe ファイルをダブルクリックします。
[処理の選択] ダイアログボックスが表示されます。
2. [イメージングソフトウェアのインストールまたはメンテナンス] オプションを選択します。[次へ] ボタンをクリックします。
3. [イメージングソフトウェアの保持] オプションを選択します。アンインストールするソフトウェアを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。
4. [イメージングソフトウェアのアンインストール] オプションを選択します。[次へ] ボタンをクリックします。
[ライセンスの無効化 (随意)] ダイアログボックスが表示されます。
5. [ライセンスの無効化 (推奨)] オプションを選択します。[次へ] ボタンをクリックします。

注記:

ライセンスをディアクティベートせずに本ソフトウェアをアンインストールすることもできますが、他のPCに本ソフトウェアをインストールしたときに、アクティベートできなくなりますので注意してください。

6. ディアクティベートします (「本ソフトウェアのディアクティベーション」(24ページ)を参照)。

アンインストールは、ディアクティベートしたあとに始まります。

ディアクティベーションが完了すると、メッセージボックスが表示されます。

7. 確認して、[完了] ボタンをクリックします。


4.2 アンインストールに関する注意

アンインストール中に、何らかの原因で、Code meterがアンインストールされない場合、手動でアンインストールする必要があります。Code meterのアンインストールは、Windows [コントロールパネル]の[プログラムと機能]を利用して、アンインストールしてください。

5. インストール後のトラブルシューティング

5.1 アクティベーションに関する問題の解決手段

本ソフトウェアのアクティベーションに関する問題が発生して本ソフトウェアを起動できなくなった場合、以下のフローチャートに従って、問題の解決手段を実施してください。

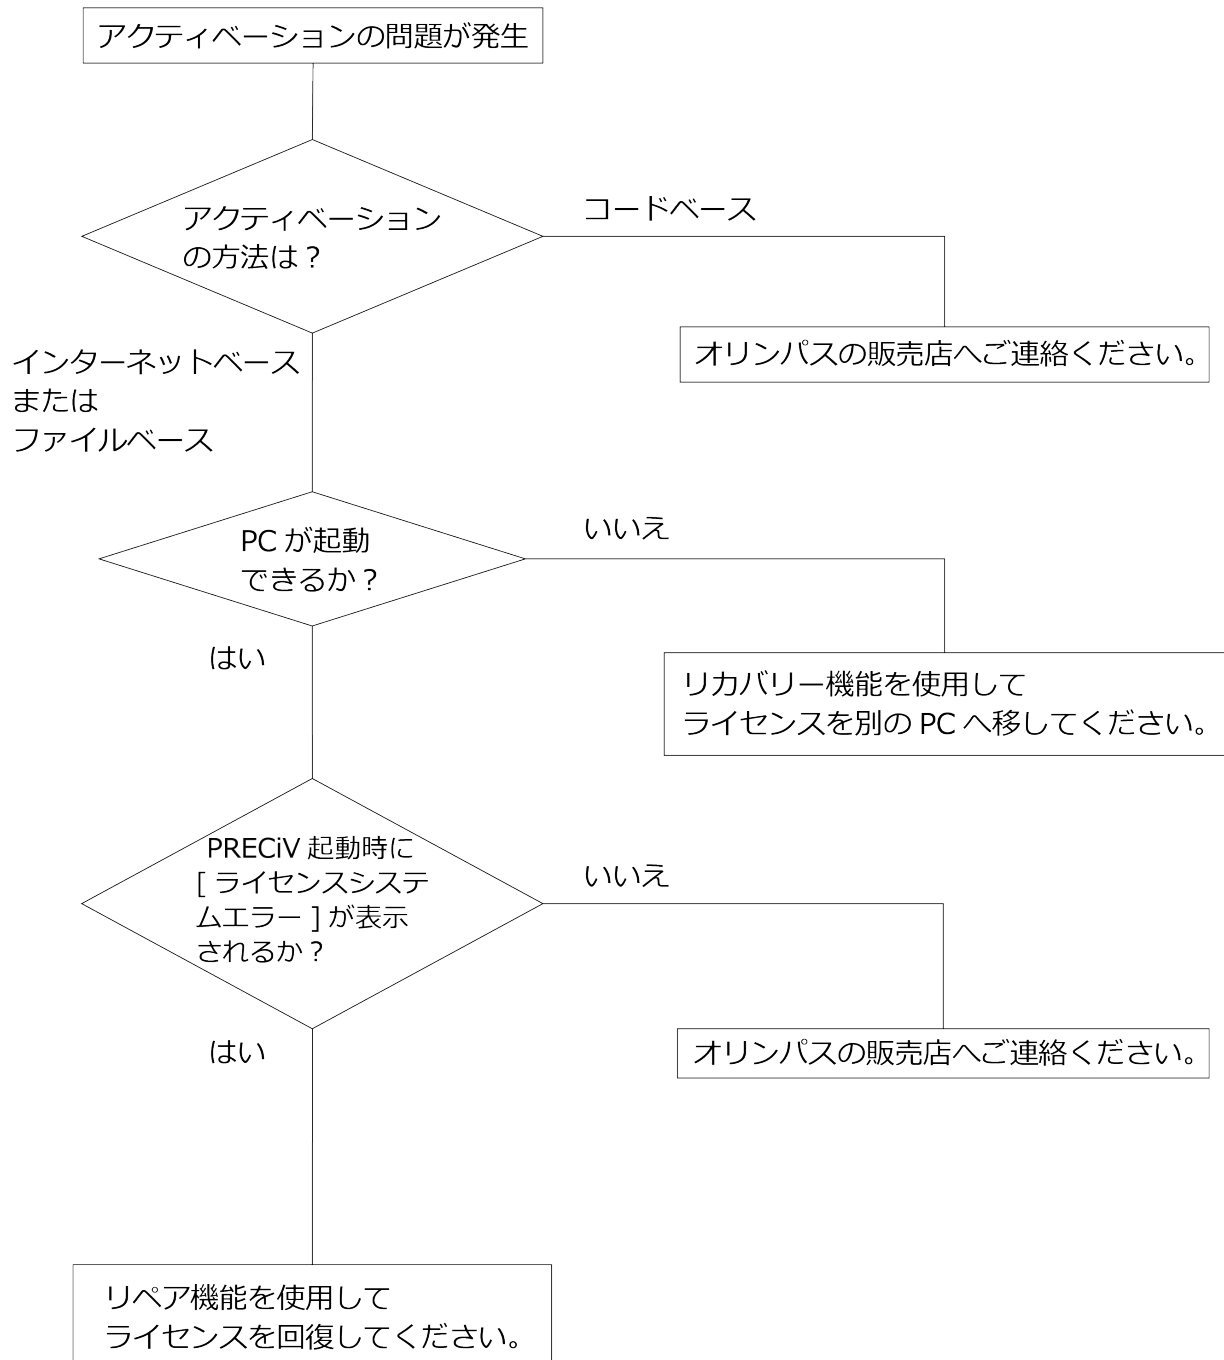


5.1.1 リペア機能

本ソフトウェアの起動時に[ライセンスシステムエラー]が表示される場合は、画面のナビゲーションに従って操作を実施することで、ライセンスを回復させることができます。


この方法は、インターネットベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.8) またはファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.9) によってアクティベートしている場合に利用できます。

コードベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.14) によってアクティベートしている場合は、この方法を利用できません。この場合はオリンパスの販売店へご連絡ください。


1. [ライセンスシステムエラー]の[ローカルライセンスシステムの修理]画面で、[修理]ボタンをクリックします。

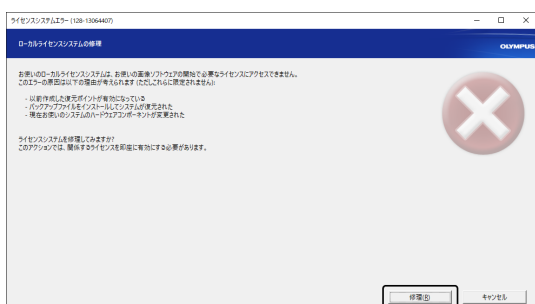


2. [有効化サーバーへの接続]画面で、[サーバーへの接続]ボタンをクリックします。

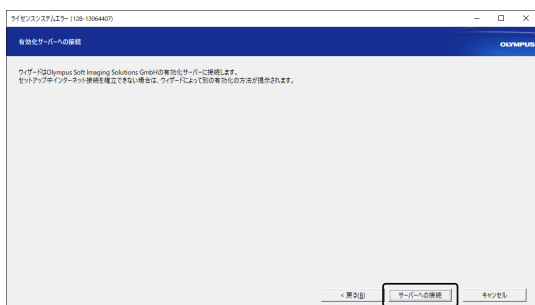

3. ファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.9) によってアクティベートしている場合は、[有効化ファイルの交換]画面が表示されます。ファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.9) の手順5以降と同じ操作によりアクティベートします。

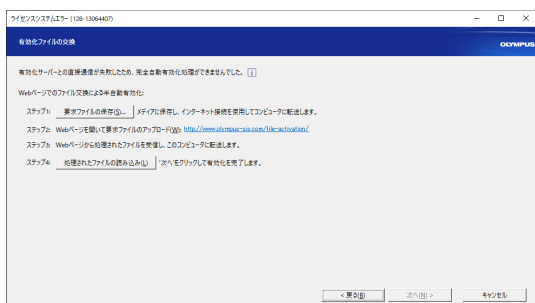

4. [有効化が成功しました] 画面が表示されたら、[次へ] ボタンをクリックします。



これでライセンスが回復します。

5.1.2 リカバリー機能


本ソフトウェアで使用しているPCが、HDDの破損などにより起動できなくなった場合は、本ソフトウェアをアクティベートした際に発行されたサービスコードを使って、本ソフトウェアのライセンスを別のPCへ移して使用することができます。

この方法を利用するためには、本ソフトウェアをアクティベートした際にPCのデスクトップ上に作成された「Olympusライセンス情報.html」ファイルに記載されているサービスコードが必要です。

この方法は、インターネットベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.8) またはファイルベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.9) によってアクティベートした場合に利用できます。

コードベースでの本ソフトウェアのアクティベーション (P.14) によってアクティベートした場合は、この方法を利用できません。この場合はオリンパスの販売店へご連絡ください。

1. 「Olympusライセンス情報.html」ファイルを開き、サービスコードを確認します。

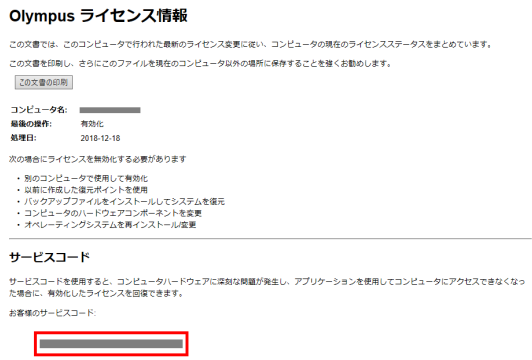

2. Webブラウザを起動し、下記URLを入力して、オリンパスのサービスWebサイトを開きます。

<http://www.olympus-sis.com/license-service/>

手順1で確認したサービスコードを入力して、[続行]をクリックします。

OLYMPUS Your Vision, Our Future
OLYMPUS SOFTWARE SOLUTIONS GmbH

ライセンスリカバリー

English Deutsch Français Italiano 日本語 中文 pycиHb

ライセンスリカバリーページは、コンピュータで有効化されたライセンスにアクセスして有効化できない場合、このライセンスを回復できます。有効化されたライセンスにアクセスして有効化できない場合のみ、ライセンスを回復する必要があります。有効化されていないライセンスは、ライセンスを回復せずに、別のコンピュータで有効化できます。

別のコンピュータでアクセス可能なライセンスを使用する場合は、まずライセンスを無効にしてから、別のコンピュータで有効化してください。この手順は、イメージングソフトウェアセットアップを実行することで可能です。

ライセンスリカバリーには、ライセンスを回復するパーソナルサービスコードが必要です。パーソナルサービスコードは、「Olympusライセンス情報」にあります。このURLは常に、最新の有効化された情報に更新されています。

サービスコードは4桁で、次の形式です: 1234-1234-1234-1234

「Olympusライセンス情報」ファイルまたはプリントアウトをなくした場合は、Olympusカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

Web ページ: www.olympus-sis.com/support/
電子メールアドレス: license-center@olympus-sis.com
電話番号: +49 (253) 79800-6444
FAX: +49 (253) 79800-6450

パーソナルサービスコード:

[続行]

3. お客様の個人情報とメールアドレスを入力し、[リクエストの送信]ボタンをクリックします。

ライセンス回復キーが、入力したメールアドレスに送信されます。

OLYMPUS Your Vision, Our Future
OLYMPUS SOFTWARE SOLUTIONS GmbH

ライセンスリカバリー

詳細を入力し、有効な電子メールアドレスを入力してください。Olympusカスタマーサポートセンターがお客様のリクエストを確認し、ライセンスリカバリーキーを送信します。これにより、別のライセンスを再度有効化できます。

名前*

姓*

メールアドレス*

電子メールアドレスを再入力してください。

会社

住所

ライセンスを回復することが必要な場合に関するお問い合わせ先を教えてください。

コンピュータまたはハードディスクが壊れたため、回復が必要となった。

一部のハードウェアコンポーネントが交換、追加、または削除された。

移動機能が使用された(保護ツール、Microsoft Windows保護機能、または遠隔ポイントの有効化など)。

オペレーティングシステムが再インストールまたは変更された。

その他の理由:

問題をリクエストしている有効化されたライセンスにアクセスできないことを確認しました。*

個人情報や他の重要な情報を誤って送信しました。*

*必須フィールド

[リクエストの送信]

4. 新たに本ソフトウェアを使用するPCで、インストールを実施します。この時、アクティベートする際は、手順3で入手したライセンス回復キーを使用してください。それ以外の操作は、「本ソフトウェアのアクティベーション (P.6)」に従って実施してください。

5.2 OSの異常起動後に行われるOS自動復旧

「起動時修復」による復旧はライセンスおよびオリンパスソフトウェアに影響を与えません。「このPCをリセットする」オプションを使用すると、ライセンスとオリンパスソフトウェアが失われます。

5.3 ユーザー権限の変更、ユーザーの追加および削除

PCの管理者がPRECiVの管理者権限を持ったユーザーをOSのユーザーアカウントから削除すると、PRECiVの管理者ユーザーが不在となり、特定の機能が使用できなくなります。OSのユーザーアカウントを削除する際は、PRECiVの管理者権限も確認し、管理者権限を別のユーザーに移すなど、管理者ユーザーが必ず存在するようにしてください。

また、ドメイン名称を変更した場合もPRECiVの管理者ユーザーが不在になります。ローカル管理者を作成し、ローカル管理者にPRECiVの管理者権限を付与することを推奨します。

5.4 PCの入れ替え、OSの再インストール時の推奨手順

以下の場合、ここに記載の推奨手順を参考に、本ソフトウェアを再インストールしてください。

- 使用しているPCが古くなって、新しいPCへ切り替える場合
- OSを再インストールする場合

推奨手順

1. 本ソフトウェアのシステム復元ポイントを作成 (P.41) して、PCとは別の記録媒体 (USBメモリーなど) に保存しておきます。
2. 本ソフトウェアをアンインストールします。(このとき、ライセンスをディアクティベートします。)
3. 画像データをPCとは別の記録媒体 (USBメモリーなど) に保存しておきます。
4. OSの再インストールが必要な場合は、OSを再インストールします。
5. 本ソフトウェアを再インストールします。(P.4)
6. システム復元ポイントを復元します。(P42)

6. 安全にご利用いただくための注意事項

1) ドキュメント

本ソフトウェアで一度に開けるドキュメント（撮影画像など）の最大枚数は150枚です。

2) メモリーの使用量が多い場合、エラーメッセージが表示されます。その際は本ソフトウェアを再起動してください。

3) バージョンやライセンス情報の確認

バージョンは [ヘルプ] > [About] コマンドを実行して、表示された画面で確認できます。



ライセンス情報はデスクトップに保存された [Olympusライセンス情報.html] ファイルをダブルクリックして確認できます。表示された画面に下記の赤枠で囲まれたところはライセンス情報です。

サービスコードを参照すると、コンピュータハードウェアに深刻な問題が発生し、アプリケーションを使用してコンピュータにアクセスできなくなった場合に、有効化したライセンスを回復できます。

お客様のサービスコード

S47Q-X3BV-F75E-TQ78

サービスコードの使用法

1. サービスコードをサービス Web サイト (www.olympus-sis.com/license-service) に入力し、次の手順に従います。お客様を識別するために個人データを入力し、電子メールアドレスを登録する必要があります。
2. サービスコードのキーと有効化コードを印刷します。
3. 印刷されたアプリケーションをインストールするコンピュータで、イメージングソフトウェアのセットアップを開始します。
4. サービスコードのキーと有効化コードを入力し、有効なライセンスキーを入力する場合は、有効化コードを入力します。
5. セットアップの有効化およびインストール手順に従います。

Olympus カスタマーサポートセンターにお問い合わせが必要な場合があります。

Web ページ: www.olympus-sis.com/support
電子メールアドレス: license-center@olympus-sis.com
電話番号: +49 (0)51 78000-6444
Fax: +49 (0)51 78000-6450

ライセンスが正常に有効化されました

別のコンピュータでアプリケーションを使用する場合は、まずライセンスを無効化する必要があります。このためには、再度セットアップを開始するか、アプリケーション内で [ヘルプ] > [ライセンス無効化] を選択します。

現在、次のライセンスがコンピュータで有効です。

製品名	多言語版番号
Internal License Industrial 2020	FFPR27R6E7
Internal Sneak Preview License 2020	KGYEXBU97A8

4) セキュリティソフトウェアのインストール

Windowsの新たな脆弱性問題からお客様のPCを守るため、アンチウイルスソフトウェア、ファイアウォールのご使用をお勧めします。ただし、ウイルスソフトウェアによるウイルススキャン中に、本ソフトウェアで画像の取り込みを行うと、取り込みが遅くなる場合があります。

5) 一定期間のログファイル保存

異常が発生したときに、原因をさかのぼれるよう、ログファイルは30日間から90日間保存することをお勧めします。

ログファイルの保存期間は [ツール] > [オプション] > [環境] > [サポート情報] から設定できます。詳細はオンラインヘルプを参照してください。

6) ユーザーの使い分けおよびログインユーザーのパスワード

複数のユーザーで使う場合は、ユーザーを分けて本ソフトウェアをご利用することをお勧めします。PRECiVのユーザーはWindowsのユーザーの中から追加できます。ユーザーの追加方法はオンラインヘルプを参照ください。また、安全にご利用していただくため、Windowsのログインユーザーのパスワードを定期的に変更し、安全なパスワードの設定を推奨します。パスワードは数字、英大小文字および記号の組み合わせで最低8文字をお勧めします。パスワードの変更方法はWindowsのヘルプを参照ください。

7) システム復元ポイントの作成と復元

以下の場合、システム復元ポイントの作成をお勧めいたします。システム復元ポイントの作成と復元は3.2.5章をご参照ください。

- 本ソフトウェアインストール後、デバイスの構成設定が完了したとき
- デバイスの追加、変更を行ったとき
- システムの動作が不安定な場合（事前にシステム復元ポイントを保存していなかった場合のみ）

8) ハードディスクに重要なデータを保存する場合はお客様の責任で保護してください。下記の作業を推奨します。

- ハードウェアの2重化
- 盗難防止
- 定期的なバックアップ

9) ライセンス情報、システム復元ポイントなどの重要な情報を他の環境に移す場合は、パスワードをかけられる記録媒体(USBメモリーなど)の使用を推奨します。

10) このインストールマニュアルやオンラインヘルプに記載していない事象などが発生する場合、オリンパスまでお問合せください。お問合せの際にログファイルの提出をお願いすることがあります。その際にIPアドレスなどのお客様の情報が含まれる可能性がありますが、異常の解析以外の目的では使用しません。

OLYMPUS

www.olympus.co.jp

オリンパス株式会社

支店・営業所所在地

東京	〒163-0914	東京都新宿区西新宿2-3-1	新宿モノリス	☎03 (6901) 4040
札幌	〒060-0034	札幌市中央区北四条東1-2-3	札幌フコク生命ビル	☎011 (222) 2553
静岡	〒420-0851	静岡市葵区黒金町11-7	大樹生命静岡駅前ビル	☎054 (255) 6245
新潟	〒950-0087	新潟市中央区東大通2-4-4	日生不動産東大通ビル	☎025 (245) 7338
松本	〒390-0815	松本市深志1-2-11	松本昭和ビル	☎0263 (36) 5332
金沢	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	コンフィデンス金沢	☎076 (222) 3438
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦2-2-2	名古屋丸紅ビル	☎052 (201) 9698
大阪	〒532-0003	大阪市淀川区宮原1-6-1	新大阪ブリックビル	☎06 (6399) 8004
松山	〒790-0003	松山市三番町7-1-21	ジブラルタ生命松山ビル	☎089 (931) 2650
広島	〒730-0004	広島市中区東白島町14-15	N T Tクレド白島ビル	☎082 (228) 1922
福岡	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通3-6-11	福岡フコク生命ビル	☎092 (711) 1883



Olympus Customer Information Center

お客様相談センター

☎0120-58-0414 FAX 03 (6901) 4251

※携帯・PHSからもご利用になれます。

受付時間 平日8:45~17:30

取扱販売店名

住所	
店名	
担当者	